# wau

CATALOGUE

# SKØNHEDSAPPARATER 7

AI NEW 9
**AKARI** 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
**Oversigt over massagelinjer** 196

# TILBEHØR 197

RENGA 199

# WAU

# HUDPLEJE 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

**PETIT RA**

**HUDPLEJE 273**

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

**KOSTTILSKUD 307**

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403




# APPARATER




# AI NEW - MASSAGEAPPARATER TIL HUDEN OMKRING ØJNENE

Pleje af øjenomgivelserne

Udglatter rynker

Reducerer hævelser og mørke rande

**PROBLEMOMRÅDER:** mørke rande under øjnene, mimiske rynker, de første aldringstegn, hævelser, trist hud, poser under øjnene og rynker i øjenkrogene - „smilerynker".

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** 94 g.

**FUNKTIONER:**

EMS - elektrisk strøm til muskelstimulation, som trænger dybt ned i hudlagene og når muskellaget. Ved at stimulere muskelsammentrækninger fremmer EMS opstramning af huden, giver en løftende effekt, øger produktionen af kollagen og elastin samt hudens fasthed og elasticitet og reducerer hævelser.

RF - radiofrekvensenergi, som opvarmer det dybe hudlag (dermis) til ca. 40-55 °C, stimulerer kollagenproduktionen og øger hudens elasticitet. I nogle tilfælde kan varmen også fremskynde fedtcellernes stofskifte (f.eks. ved dobbelthagen). Ved apparater til hjemmebrug er temperaturen på hudoverfladen normalt 38-45 °C af hensyn til sikker brug.

Rødt LED lys - fremmer blodcirkulationen, virker antiinflammatorisk, lindrer hævelser, smerter, letter pigmentering, er velegnet til alle hudtyper. Rødt LED-lys trænger dybere ind i huden end andre. Det virker på fibroblaster (celler, der syntetiserer kollagen), og fremmer derved hudforyngelse og bekæmper ældningstegn.

**EGENSKABER:**
1. Har en ladebase, som gør det nemt at opbevare og oplade apparatet.
2. Betjenes med 1 knap og aktiveres med et langt tryk, så apparatet ikke tænder under transport.
3. 2 tilstande: EMS + rødt LED-lys; RF + rødt LED lys.
4. Indikator: rød - RF, blå - EMS.
5. Behandlingsfladen er placeret i en særlig vinkel, som er tilpasset området omkring øjnene.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tænd apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde.
2. Enheden har 2 driftstilstande: "RF + rødt LED lys" og "EMS + rødt LED lys" tilstand. Valget af tilstand udføres ved at trykke på kontakten til. Den røde indikator er RF + rødt LED-lys. Blå - EMS-tilstand + rødt LED-lys.
3. Sluk apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde.
4. Apparatet har automatisk slukning (efter 10 minutters uafbrudt brug).

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

RF MODE + RØDT LED lys
1. Tryk og hold tænd-knappen nede for at tænde enheden, og vælg derefter RF + rød LED-lystilstand (rød indikator).
2. Påfør den ledende massagegel, læg apparatets behandlingsflade mod huden, og begynd massagen ved langsomt at følge massagelinjerne langs øjenhuleknoglen fra den indre øjenkrog udad og i stråler fra den ydre øjenkrog. Skift øje hvert 2. minut. Bemærk: radiobølgerne fra apparatet opvarmer hudens dermis. Hold apparatets behandlingsflade i bevægelse under brug. Bliv ikke på samme hudområde, da det kan give forbrændinger. Apparatet har et særligt lydsignal, som minder dig om at flytte det hvert 10. sekund.

EMS MODE + RØDT LED lys
1. Tryk og hold tænd-knappen nede for at tænde enheden, og vælg derefter EMS + rødt LED-lys (blå indikator).
2. Påfør den ledende massagegel, læg apparatets behandlingsflade mod huden, og begynd massagen ved langsomt at følge massagelinjerne langs øjenhuleknoglen eller øjenbrynsbuen fra den indre øjenkrog udad. Skift øje hvert 2. minut.

**BEHANDLINGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | UGE 1 | UGE 2 | UGE 3 | UGE 4 | DEREFTER |
|---|---|---|---|---|---|
| **HÆVELSER / MØRKE RANDER UNDER ØJNENE** | Aften, før sengetid. EMS: 5-7 min (3-3.5 min pr. øje). RF: 5-7 min (3-3.5 min pr. øje). Hver anden dag. | Aften, før sengetid. EMS: 5-7 min (3-3.5 min pr. øje). RF: 5-7 min (3-3.5 min pr. øje). Hver anden dag. | 1 uges pause (mindst 5 dage). | Gentag. | 2 ugers forløb. 1 uges pause. Gentag forløbet på 2 uger. Fortsæt denne cyklus. |
| **TØR / SLAP HUD** | Morgen. RF: 7 min (3.5 min pr. øje). EMS: 2-3 min (1.5 min pr. øje). Hver 3. dag. | Morgen. RF: 7 min (3.5 min pr. øje), hver 3. dag. EMS: 2-3 min (1.5 min pr. øje), højst 3 gange om ugen. | Morgen. RF: 7 min (3.5 min pr. øje), dagligt. EMS: 2-3 min (1.5 min pr. øje). Tilstandene kan bruges hver for sig. Højst 3 gange om ugen. | 1 uges pause. | Gentag forløbet på 4 uger over 2 måneder. Hold 1 måneds pause. Gentag forløbet på 4 uger over 2 måneder. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Hvis du har medicinske kontraindikationer, skal du rådføre dig med en hudlæge før brug.
2. Brug ikke apparatet, hvis du er lysfølsom.
3. Brug ikke apparatet ved revner eller åbne sår i huden, hudsygdomme eller svær akne, solskoldning, hudinfektioner osv.
4. Brug ikke apparatet på øvre eller nedre øjenlåg, øjeæblet eller øjets slimhinder.
5. Brug ikke apparatet på modermærker, vorter, indgroede hår eller irriteret hud.
6. Del ikke apparatet med andre, da det kan medføre bakteriel krydssmitte og farlige infektioner.

**ADVARSLER:**
1. Gør ikke ladekablet vådt. Nedsænk ikke apparatet i vand.
2. Oplad ikke apparatet steder, hvor det kan blive vådt, f.eks. på badeværelset, i brusebadet eller nær en swimmingpool.
3. Kast ikke apparatet i ild.
4. Apparatet må kun oplades med det medfølgende ladekabel.
5. Stop brugen af apparatet, hvis tilbehøret eller ladekablet er beskadiget, for at undgå skader.
6. Hvis ladekablet er beskadiget, skal det udskiftes med et originalt kabel for at undgå farlige situationer.
7. Oplad apparatet helt mindst én gang hver 2. måned for at forlænge batteriets levetid.
8. Dette apparat er ikke beregnet til børn under 12 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller utilstrækkelig erfaring og viden. Disse personer må kun bruge apparatet under opsyn.
9. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Forsøg ikke selv at skille det ad eller reparere det, da det kan medføre alvorlige øjen- eller hudskader samt elektrisk stød og død.

10. Brug kun apparatet til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med denne vejledning.
11. Det anbefales at oplade, bruge og opbevare apparatet ved en temperatur på 5-35 °C.
12. Brug ikke apparatet, hvis du har fået kosmetiske behandlinger inden for de sidste 2 uger (f.eks. kemisk eller mekanisk peeling, laserresurfacing, fraktioneret laserbehandling, mesoterapi, fillerbehandlinger eller andre ansigtsformende behandlinger).

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massageapparat, (2) ladeholder, (3) USB-C-ladekabel, (4) opbevaringspose, (5) klud, (6) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 2 h

**DRIFTSTID:** 40 min

**SMART TIMER:** 10 min

**RF-FREKVENS:** 1MHz

**EMS-FREKVENS:** 20 KHz

**EMS-STRØM:** 166 mA

**RØDT LED lys BØLGELÆNGDE:** 630 nm

**BØLGEFORM:** bifasisk symmetrisk rektangulær bølgeform

**VANDBESTANDIGHED:** IPX4




# AKARI - MASSAGEAPPARAT TIL ØJENPLEJE

Løfter øjenkonturen

Reducerer rynker

Reducerer hævelse

Lysner mørke rander

**PROBLEMOMRÅDER:** mimiske rynker („smilerynker"), folder omkring øjnene, tab af elasticitet og slap hud på øjenlågene, mørke rande, morgenhævelser, poser under øjnene, muskelspændinger og trætte øjne efter længere tids skærmarbejde.

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast, zinklegering (elektroder).

**VÆGT:** 137 g (apparat), 82 g (ladebase).

**FUNKTIONER:**

RF-løft (40-43 °C) - trænger ned i de dybe hudlag og opvarmer vævet skånsomt til 40-43 °C, så eksisterende kollagenfibre straks trækker sig sammen, og fibroblasterne begynder aktivt at danne nyt kollagen og elastin. Huden omkring øjnene bliver dermed straks strammere og tættere, og regelmæssig brug udglatter mimiske rynker.

EMS (ELEKTROMYOSTIMULATION) - EMS påvirker området omkring øjnene med svage impulser (7.52-8.56 mA), som får øjets ringmuskel til rytmisk at trække sig sammen og slappe af. Det styrker øjenlågets muskulatur, løfter de ydre øjenkroge og giver huden omkring øjnene spændstighed og elasticitet tilbage.

Fototerapi (LED) er en metode, hvor lysbølger med forskellige bølgelængder trænger ned til en bestemt dybde i huden og optages af cellerne, hvilket sætter naturlige regenereringsprocesser i gang.

Det røde spektrum (620-630 nm) sætter gang i hudens foryngelse og regenerering og giver øjenpartiet friskhed og en naturlig glød.

Gult spektrum (587-592 nm) beroliger følsom hud, aktiverer lymfedrænage og fremmer udskillelsen af stillestående væske. Som et resultat aftager hævelsen, mørke rande under øjnene lyser, og hudens tekstur udjævnes.

Køletilstand (15 ± 5 ° C) - forårsager øjeblikkelig indsnævring af overfladekar og porer, hvilket giver en hurtig lymfedrænage og forfriskende effekt. Kulde lindrer morgenhævelser, hævelser og "poser" under øjnene og beroliger også huden.

VIBRATION (11000 rpm) - giver en blid mikromassage, som lindrer kramper og spændinger i øjets ringmuskel efter computerarbejde eller læsning. Behandlingen aktiverer blodcirkulationen og lymfedrænagen og øger hudens gennemtrængelighed for hudplejeprodukter.

**EGENSKABER:**
1. 3 EMS-intensitetsniveauer gør det muligt at vælge et individuelt plejeprogram ud fra hudens følsomhed.
2. Hukommelsesfunktion: apparatet gemmer automatisk det senest valgte EMS-intensitetsniveau og den seneste tilstand.
3. 3 forudindstillede tilstande, hvor forskellige påvirkninger supplerer og forstærker hinanden for en mærkbar effekt.
4. Den smarte timer styrer behandlingstiden præcist og slukker automatisk apparatet for at forhindre overbelastning og overophedning af huden.
5. 5 teknologier: RF-løft, EMS-stimulation, køling, vibrationsmassage og LED-lys (rødt og gult) er samlet i ét kompakt apparat til alle problemer omkring øjnene.
6. Ladebasen giver både elegant lodret opbevaring på toiletbordet og bekvem trådløs opladning.
7. Enkel og intuitiv betjening: kun 2 knapper, som ligger behageligt under fingeren.
8. Sømløse elektroder: en helt glat overflade giver hygiejnisk og skånsom glidning uden at skade huden.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tænd/sluk: tryk på tænd/sluk-knappen i 1.5 sekunder (tænding bekræftes med et kort bip). Som standard starter apparatet i tilstand 1.
2. Skift af tilstand: tryk kort på tænd/sluk-knappen for at vælge i rækkefølge:
Mode 1: RF + EMS + Rødt LED-lys Tilstand 2: EMS + Vibration (LED'er slukket) Tilstand 3: EMS + Køling + Gult LED-lys
3. Justering af EMS-intensitet: tryk kort på knappen til
intensitetsstyring for at vælge niveau:
Svag (niveau 1) - knappens højre segment lyser. Middel (niveau 2) - knappens højre og nederste segment lyser. Stærk (niveau 3) - knappens venstre, højre og nederste segment lyser.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Følsomhedstest (obligatorisk før første brug):
Påfør ledende gel på indersiden af underarmen, og læg det slukkede apparats behandlingsflade mod den.
2. Tænd apparatet, og gennemfør en fuld behandling på 10 minutter i tilstand 1. Stop testen ved en stærk brændende fornemmelse. Vurdér huden efter 6 timer. Hvis der ikke er rødme eller kløe, er apparatet egnet til dig. Udfør behandlingen: rens ansigtet og området omkring øjnene. Tag eventuelle kontaktlinser ud før behandlingen.
3. Påføring af gel: påfør rigeligt særlig ledende kontaktgel eller vandbaseret fugtserum omkring øjnene. Produktet må ikke indeholde olier og syrer (AHA, BHA, PHA, retinol eller høje koncentrationer af C-vitamin).



4. Udførelse af massage: tænd massageapparatet, vælg en tilstand, og begynd at føre det jævnt langs massagelinjerne:
• Øvre øjenlåg: fra den indre øjenkrog mod den ydre, udelukkende langs øjenhuleknoglen under øjenbrynet.
• Nedre øjenlåg: jævnt fra den indre øjenkrog udad langs øjenhuleknoglen.
• Tindinger: blid cirkelmassage. Vigtigt: hold apparatet i bevægelse under hele behandlingen. Hold det ikke på ét område, da det kan medføre overophedning og forbrændinger! Overskrid ikke grænsen på 10 minutter pr. behandling.
5. Afslutning: påfør din sædvanlige øjencreme. Rengør apparatet med en fugtig, fnugfri klud.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED |
|---|---|---|---|
| MORGENHÆVELSER / ØDEM / MØRKE RANDE | MORGEN | Tilstand 3: EMS + Køling + Gult LED-lys (plejer hævelser og udstråling). Varighed: 3 minutter. | 3-4 gange om ugen |
| MIMISKE RYNKER / FOLDER / TAB AF FASTHED I ØJENLÅGENE | AFTEN | Tilstand 1: "RF + EMS + rødt LED-lys" (anti-ældningsløft) Varighed: op til 10 minutter | 3-4 gange om ugen |
| MUSKELSPÆNDINGER OG TRÆTTE ØJNE | Om aftenen eller efter behov | Tilstand 2: "EMS + Vibration" (Afslapning og lymfedrænage) Varighed: op til 10 minutter | Efter behov, typisk 3-4 gange om ugen. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Må ikke bruges direkte på øjeæblet, det bevægelige øvre eller nedre øjenlåg eller slimhinderne i mund, næse eller kønsorganer.
2. Hjertesygdom, pacemaker eller andre implanterede elektroniske medicinske apparater.
3. Metalimplantater, stifter eller guldtråde direkte i behandlingsområdet.
4. Nylig øjenoperation eller medicinske æstetiske behandlinger omkring øjnene.
5. Sår, hudafskrabninger, revner, eksem, dermatitis, svær akne, forbrændinger (også solskoldning) eller infektioner i behandlingsområdet.
6. Allergi over for metaller eller elektrisk påvirkning samt nedsat temperatur- og berøringssans i huden.
7. Sygdomme i skjoldbruskkirtlen (apparatet må ikke bruges direkte på skjoldbruskkirtlen) eller hormonmedicin til behandling heraf.
8. Graviditet (brug kun efter samråd med en læge).
9. Amning, menstruation, couperose (telangiektasier) - brug med forsigtighed.

10. Personer under 12 år (brug er kun tilladt under opsyn af voksne).
11. Brug ikke apparatet, hvis huden er i aktiv heling efter kosmetiske behandlinger (peeling, laserresurfacing, mesoterapi eller fillere inden for de sidste to uger).
12. Hvis du har tandimplantater, bøjle eller metalproteser i ansigtet, skal du være opmærksom på, hvordan du har det. Stop behandlingen ved ubehag eller metalsmag i munden.

**FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSREGLER:**
1. Fugtbeskyttelse: hold ladekabel, base og kontakter helt tørre. Nedsænk dem ikke i vand, og oplad ikke apparatet i fugtige omgivelser (badeværelse). Apparatet har fugtbeskyttelsesklasse IPX22 (beskyttelse mod lodrette dråber), men det er strengt forbudt at vaske det under vandhanen.
2. Elsikkerhed: massageapparatet må ikke bruges under opladning. Basen må ikke være tilsluttet strømmen uafbrudt i mere end 24 timer under opladning.
3. Skånsom rengøring: rengør kun apparatet, når det er slukket. Brug ikke metalsvampe, slibemidler eller aggressive eller brandfarlige væsker (alkohol, benzin, fortynder, acetone).
4. Det er forbudt at tørre apparatet med en hårtørrer med varm luft.
5. Opbevaring: opbevar tørt og køligt ved stuetemperatur, væk fra sollys. Ved længere opbevaring uden brug skal apparatet oplades mindst én gang hver 3. måned for at undgå nedbrydning af batteriet.
6. Kast ikke apparatet i ild, og undgå fald og slag.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) AKARI-massageapparat, (2) ladebase, (3) Type-C-ladekabel, (4) opbevaringspose, (5) brugsanvisning, (6) klud.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** apparat - 155×26×28 mm, opladningsbase - 62×55×59 mm

**STRØMKILDE:** litiumpolymerbatteri

**BATTERIKAPACITET:** 1000 mAh

**NOMINEL DRIFTSSPÆNDING:** 3,7 V

**NOMINEL FORSYNINGSSPÆNDING:** 5 V

**EFFEKT:** 11 W

**SMART TIMER:** RF + EMS + Rødt LED-lys - 10 minutter EMS + Vibration - 10 minutter EMS + Køling + Gult LED-lys - 3 minutter

**OPLADNINGSTID:** ≤ 3 h

**MAKSIMAL DRIFTSTID (FULD OPLADNING):** ≥ 40 min

**EMS-INTENSITET:**
Niveau 1 - 7.52 mA Niveau 2 - 7.92 mA Niveau 3 - 8.56 mA

**LYSINTENSITET:**
Rødt LED-lys - 24,22 mW/cm2 Gult LED-lys - 14,47 mW/cm2

**VIBRATIONSHASTIGHED:** 11000 omdrejninger pr. minut

**KØLETEMPERATUR:** 15+/-5 °C

**VANDBESTANDIGHED:** IPX22



# ATAMA - MASSAGEAPPARAT TIL HÅRVÆKST OG HOVEDBUNDSPLEJE

Styrker hårrødderne

Hårvækst

Hårtæthed

Forbedrer hårkvaliteten

Modvirker inflammation

**PROBLEMOMRÅDER:** hårtab, tyndt hår, tørt og skrøbeligt hår samt hovedbundssygdomme.

**MATERIALER: plast.**

**VÆGT:** 213,5 g.

**FUNKTIONER:**

EMS - elektrostimulation med lavfrekvente strømme, som trænger dybt ind i vævet, får musklerne til at trække sig sammen og blodkarrene til at udvide sig, forbedrer blod- og lymfecirkulationen og stimulerer stofskifteprocesser og hovedbundens iltforsyning. Det renser porerne, vækker „sovende" hårsække, sætter vækst af nye hår i gang og forbedrer hårkvaliteten. EMS kan også normalisere talgkirtlernes funktion, så håret fedter mindre, og kløen mindskes.

Vibration - hovedet har mange nerveender, og stimulering med vibrationsmassage reducerer stress. Vibration fremmer også blodcirkulation og stofskifteprocesser, så cellerne får flere næringsstoffer og mere ilt, hårsækkene bliver mere aktive, og hårvæksten accelererer.

Fototerapi (rødt og blåt LED-lys) - LED'er producerer den ønskede bølgelængde, som trænger dybt ind i huden og udløser energiprocesser inde i cellerne. For eksempel genaktiverer rødt LED-lys (630 og 650 nm) folliklerne, som går ind i fasen af slutningen af aktiv hårvækst. Blåt LED-lys (460 nm), der virker på epidermis-niveau, dræber bakterier, reducerer betændelse og stopper dannelsen af acne i hovedbunden.

**EGENSKABER:**
1. Massageapparat formet som en kam med et behageligt håndtag. Det gør det komfortabelt at massere sig selv i længere tid.
2. ATAMA har vandbestandighedsklasse IPX6 og er nem at vedligeholde efter brug - skyl apparatet under rindende vand efter brug.

3. Særlige massagetænder af silikone: bløde og fleksible, roterer 360 grader og giver en behagelig massage, selv når apparatet er slukket.
4. 3 tilstande med individuel indstilling: EMS (elektromyostimulation), LED (fototerapi), vibration. Du kan kombinere tilstandene efter ønske, slukke hver af dem helt og vælge den ønskede strømstyrke, lysintensitet og vibrationstype.
5. Overskuelig betjening: hver tilstand har sin egen knap på apparatets håndtag. Du kan skifte tilstand under massagen uden at afbryde den.
6. Den 2 mest effektive lysfototerapi præsenteret i LED-tilstand. Rød LED-lystilstand er repræsenteret af rødt LED-lys med en bølgelængde på 630 nm (dioder er placeret langs omkredsen af kammen) og lavniveau laserlys med en bølgelængde på 650 nm (dioder er placeret i midten af massageoverfladen). Bølgelængderne af dette hul forhindrer hårtab. Blå LED-lystilstand med en bølgelængde på 460 nm (dioder er kun placeret langs omkredsen af kammen, dioder i midten af massageapparatet lyser ikke blåt) bruges til at behandle overfladiske tilstande i hovedbunden.

## BETJENINGSVEJLEDNING:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.
2. Indstilling af tilstande
• Tænd/sluk-knap (på kontrol/EMS) Tryk og hold nede (1,2 sekunder) tænder for enheden (når den er tændt, udsender 1 lydsignal) og EMS-tilstand (niveau 1), med 1 pære på indikatoren. Et kort tryk aktiverer det 2. niveau af EMS-tilstanden, mens 2-lamper vil lyse på indikatoren, det næste korte tryk er det 3. niveau af EMS-tilstand, mens 3-lamper vil lyse på indikatoren. Gentagen tryk vil helt slukke for EMS-tilstand, tre pærer på indikatoren vil flimre på samme tid. Ved langvarig tryk (1,2 sekunder) vil den fungerende enhed udsende 2 lydsignaler og slukke.
Bølgeknap (vibrationsstyring) Det første korte tryk aktiverer konstant vibration. Det andet aktiverer pulserende vibration. Det tredje slukker vibration. Skift af tilstand ledsages af et kort lydsignal.
Solknap (lysstyring) Det første korte tryk inkluderer en laserterapitilstand (rødt LED-lys). Efter det andet tryk skifter farven til blå. Det tredje tryk slukker for LED-tilstanden. Skift af tilstande ledsages af et kort lydsignal.
3. Efter 10 minutters uafbrudt brug slukker apparatet automatisk uden at gå i standby.

## SÅDAN BRUGES APPARATET:

### MASSAGE AF ISSEN:

1. Bevæg apparatet i cirkler med uret på issen.
2. Massage af ét område bør vare 1-2 minutter.

### MASSAGE AF ANDRE OMRÅDER AF HOVEDET:

1. Bevæg apparatet i hårets vækstretning fra ansigtet mod baghovedet, som når du reder håret.
2. Du kan også bevæge apparatet i spiraler eller zigzag.
3. Alle bevægelser i ét område gentages 3-5 gange.
4. Den anbefalede samlede massagevarighed er 10-15 minutter.



## BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| FEDTET HOVEDBUND | Morgen, efter vask, i fugtigt hår | EMS: niveau 1 - 5 min; niveau 2 - 3 min; niveau 3 (maks.) - 2 min. Brug alle tre niveauer i rækkefølge, øg gradvist. LED: blåt LED-lys - 5 min; rødt LED lys - 2 min. Brug tilstandene i denne rækkefølge, ikke samtidigt. | Uge 1-2: 3 gange om ugen. Uge 3: 5 gange om ugen. Uge 4: pause. | 2 måneder. Hold 1 måneds pause, og gentag derefter forløbet på 2 måneder. Samlet minimumsprogram: 6 måneder. To forløb om året. |

| HUDTYPE / PROBLEM | DE FØRSTE 10 DAGE | DE NÆSTE 10 DAGE | DE NÆSTE 2-3 MÅNEDER | DEN NÆSTE MÅNED | DEREFTER |
|---|---|---|---|---|---|
| HÅRTAB / UDTYNDING | Vibration: 10 min efter påføring af et nærende serum (valgfrit). LED rød LED lys: 5 min. Brug i denne rækkefølge, ikke samtidigt. Daglig. | Vibration: 10 min efter påføring af et nærende serum (valgfrit). LED rød LED lys: 5 min. Brug i denne rækkefølge, ikke samtidigt. Hver anden dag. | Vibration: 10 min efter påføring af et nærende serum (valgfrit). EMS, lavt og mellemniveau: 2-5 min. LED rød LED lys: 7 min. Brug i denne rækkefølge, ikke samtidigt. 3-4 gange om ugen. | Pause. | Gentag 10-10-3-programmet i 5-6 måneder. Hold 1 måneds pause. Vedligeholdelse: 1 måneds brug efterfulgt af 3 måneders pause. |

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| SKÆL / AFSKALNING (uden hovedbundssygdom) | Når som helst på dagen, efter vask, i fugtigt hår | LED: blåt LED-lys - 3 min; rødt LED lys - 7 min. Vibration: 3 min. Brug i denne rækkefølge, ikke samtidigt. SEPARAT, uafhængigt af hårvask: EMS, medium niveau - 3-4 min. | LED: dagligt. Vibration: 3 gange om ugen. EMS: 2 gange om ugen. | LED + vibration: 4 uger og derefter 1 uges pause. Gentag over 1 måned. Yderligere gentagelse er ikke nødvendig, da forløbet fortsættes, indtil problemet er løst. EMS: 4 uger og derefter 1 uges pause. Gentag over 1 måned. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
Brug med forsigtighed:
• personer påvirket af alkohol samt under menstruation og amning;
• ved telangiektasier;
• ved midlertidige tandfyldninger eller under tandbehandling;
• allergi over for metal;
• ved forhøjet temperatur og højt blodtryk;
• efter plastikkirurgi i hovedbunden samt ved hudbetændelse og kløe.

**ADVARSLER:**
1. Brug ikke apparatet nær metalproteser (øjeæble, indre øre, knogle- og ledområder).
2. Brug ikke apparatet på områder med vene- eller arteriesygdomme eller ved tromboflebitis eller problemer med blodets størkning.
3. Undgå mekaniske påvirkninger.
4. Brug kun apparatet i overensstemmelse med brugervejledningen.
5. Det er forbudt at skille produktet ad, servicere eller opgradere det.
6. Opbevar apparatet på et tørt og rent sted.
7. Opbevar ikke apparatet ved høje/lave omgivelsestemperaturer eller nær åben ild.
8. Tag stikket ud af stikkontakten efter endt opladning.
9. Hold apparatet utilgængeligt for børn.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massageapparat, (2) opbevaringspose, (3) klud,
4. USB-C-ladekabel, 5) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** 2 h

**SMART TIMER:** 10 min

**MODES:**
1. EMS - niveau 1 31 mA, niveau 2 43 mA, niveau 3 78 mA
2. Fototerapi - rødt LED-lys (bølgelængde 630 nm), laserlys (bølgelængde 650 nm), blåt LED-lys (bølgelængde 460 nm)
3. Vibration - 6500 omdrejninger pr. minut

**EMS-FREKVENS:** 9,51 kHz

**BØLGEFORM:** bifasisk symmetrisk bølgeform

**VANDBESTANDIGHED:** IPX6



# ELAX 2.0 - AFSLAPPENDE MASSAGEMASKE TIL ØJNENE

Lindrer trætte øjne

Reducerer hovedpine

Hjælper ved søvnløshed

Afslapning

**PROBLEMOMRÅDER:** generel træthed og trætte øjne, hovedpine, migræne, indsovningsbesvær og langvarigt computerarbejde.

**MATERIALER: modal, lycra.**

**VÆGT:** 111 g.

**FUNKTIONER:**
Varme - forbedrer blodcirkulationen og lindrer spændinger i øjnene. Vibration - afslapper effektivt musklerne omkring øjnene, hjælper med at genoprette normal til- og afstrømning af lymfe og reducerer generel træthed og øjenbelastning. KOLDT KOMPRES - reducerer hævelser omkring øjne og kindben ved at trække blodkarrene sammen. Kulde reducerer blodgennemstrømningen og fremmer afløbet af overskydende væske. 3D-masken trykker ikke på øjne og øjenvipper, slutter tæt til ansigtet og blokerer lys, så den kan bruges som sovemaske.

**EGENSKABER:**
1. 4 anvendelser (varme, vibration, varme + vibration, indlæg til koldt kompres).
2. Masken er let og trykker ikke på øjnene under brug.
3. 3 varmeniveauer til valg af en behagelig temperatur og 3 vibrationsniveauer til den optimale massagestyrke.
4. Masken har en anatomisk 3D-form med fordybninger til øjne, næse og næseryg for maksimal komfort.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tilslut betjeningspanelet til masken. Bemærk: ladeindikatoren lyser hvidt, når forbindelsen mellem masken og betjeningspanelet er svag.
2. Tænd massageapparatet ved at holde vibrationskontakten eller temperaturknappen inde i 2 sekunder. Batteriniveauets lysindikator tænder.
3. Vibration og varme fungerer uafhængigt af hinanden. Vælg den ønskede tilstand.
4. Vibrationstilstanden har 3 vibrationsniveauer. Massageapparatet starter med lav vibration og giver 1 lydsignal. Ved niveauskift betyder 2 lydsignaler vibrationsniveau 2 og 3 signaler niveau 3.

5. Varmetilstanden har 3 temperaturniveauer. Massageapparatet starter ved lav varme og giver 1 bip. Ved niveauskift betyder 2 lydsignaler middel varme og 3 lydsignaler maksimal varme.
6. Massageapparatet har en smart timer og slukker efter 15 minutters brug. Vibration og varme fungerer uafhængigt af hinanden, og deres timere kører separat. Timeren starter ikke forfra, når vibrationsniveauet eller temperaturen ændres.
7. Sluk apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen for vibration eller varme inde i 2 sekunder.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Tilslut betjeningspanelet til masken.
2. Sæt masken over øjnene, og tænd den.
3. Aktivér vibration/varme eller begge dele samtidigt.
4. Justér temperatur- og varmeniveauet.
5. Nyd en massage i 15 minutter.
6. Hvis du vil bruge et koldt kompres, skal indlægget først lægges i køleskabet i 10 minutter. Læg det i masken uden at tænde apparatet.

**BRUGSHYPPIGHED:**
Daglig brug er tilladt.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Personer, der ikke kan mærke varmepåvirkning på huden, har forhøjet kropstemperatur eller er forkølede, bør rådføre sig med en læge før brug.
2. Det anbefales ikke at bruge apparatet:
ved trombose, alvorligt aneurisme, akut venøst aneurisme, alle former for dermatitis eller hudinfektioner, da brug kan forværre tilstanden;
personer, som ikke kan udtrykke deres vilje eller bruge produktet selv;
• børn under 14 år.
3. Stop brugen ved opkastning, kramper eller andre fysiske reaktioner.

**ADVARSLER:**
1. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og spædbørn.
2. Produktet er beregnet til personer over 12 år.
3. Hold betjeningspanelet, ladekablet og ladestikket tørre.
4. Sprøjt ikke kemiske væsker som parfume og deodorant på maskens overflade.
5. Undgå at bøje, trække i eller binde øjenmasken og ladekablet, da det kan give skader.
6. Personer med øjensygdomme eller allergier og personer med kraftige reaktioner på varme kompresser bør rådføre sig med en læge før brug.




**PAKKENS INDHOLD:** (1) maske, (2) indlæg til koldt kompres, (3) USB-Type C-ladekabel, (4) opbevaringspose, (5) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**
**OPLADNINGSTID: 1 time**

**DRIFTSTID:** 75 minutter ved høj temperatur 60 minutter ved middeltemperatur 45 minutter ved lav temperatur

**SMART TIMER:** 15 min
**VIBRATIONSHASTIGHED:** Lavt niveau - 3000 omdrejninger pr. minut • Mellemniveau - 4000 omdrejninger pr. minut • Højt niveau - 5000 omdrejninger pr. minut

**TEMPERATURTILSTANDE:** • Lav temperatur - 40-45 °C • Mellemtemperatur - 45-50 °C • Høj temperatur - 50-55 °C

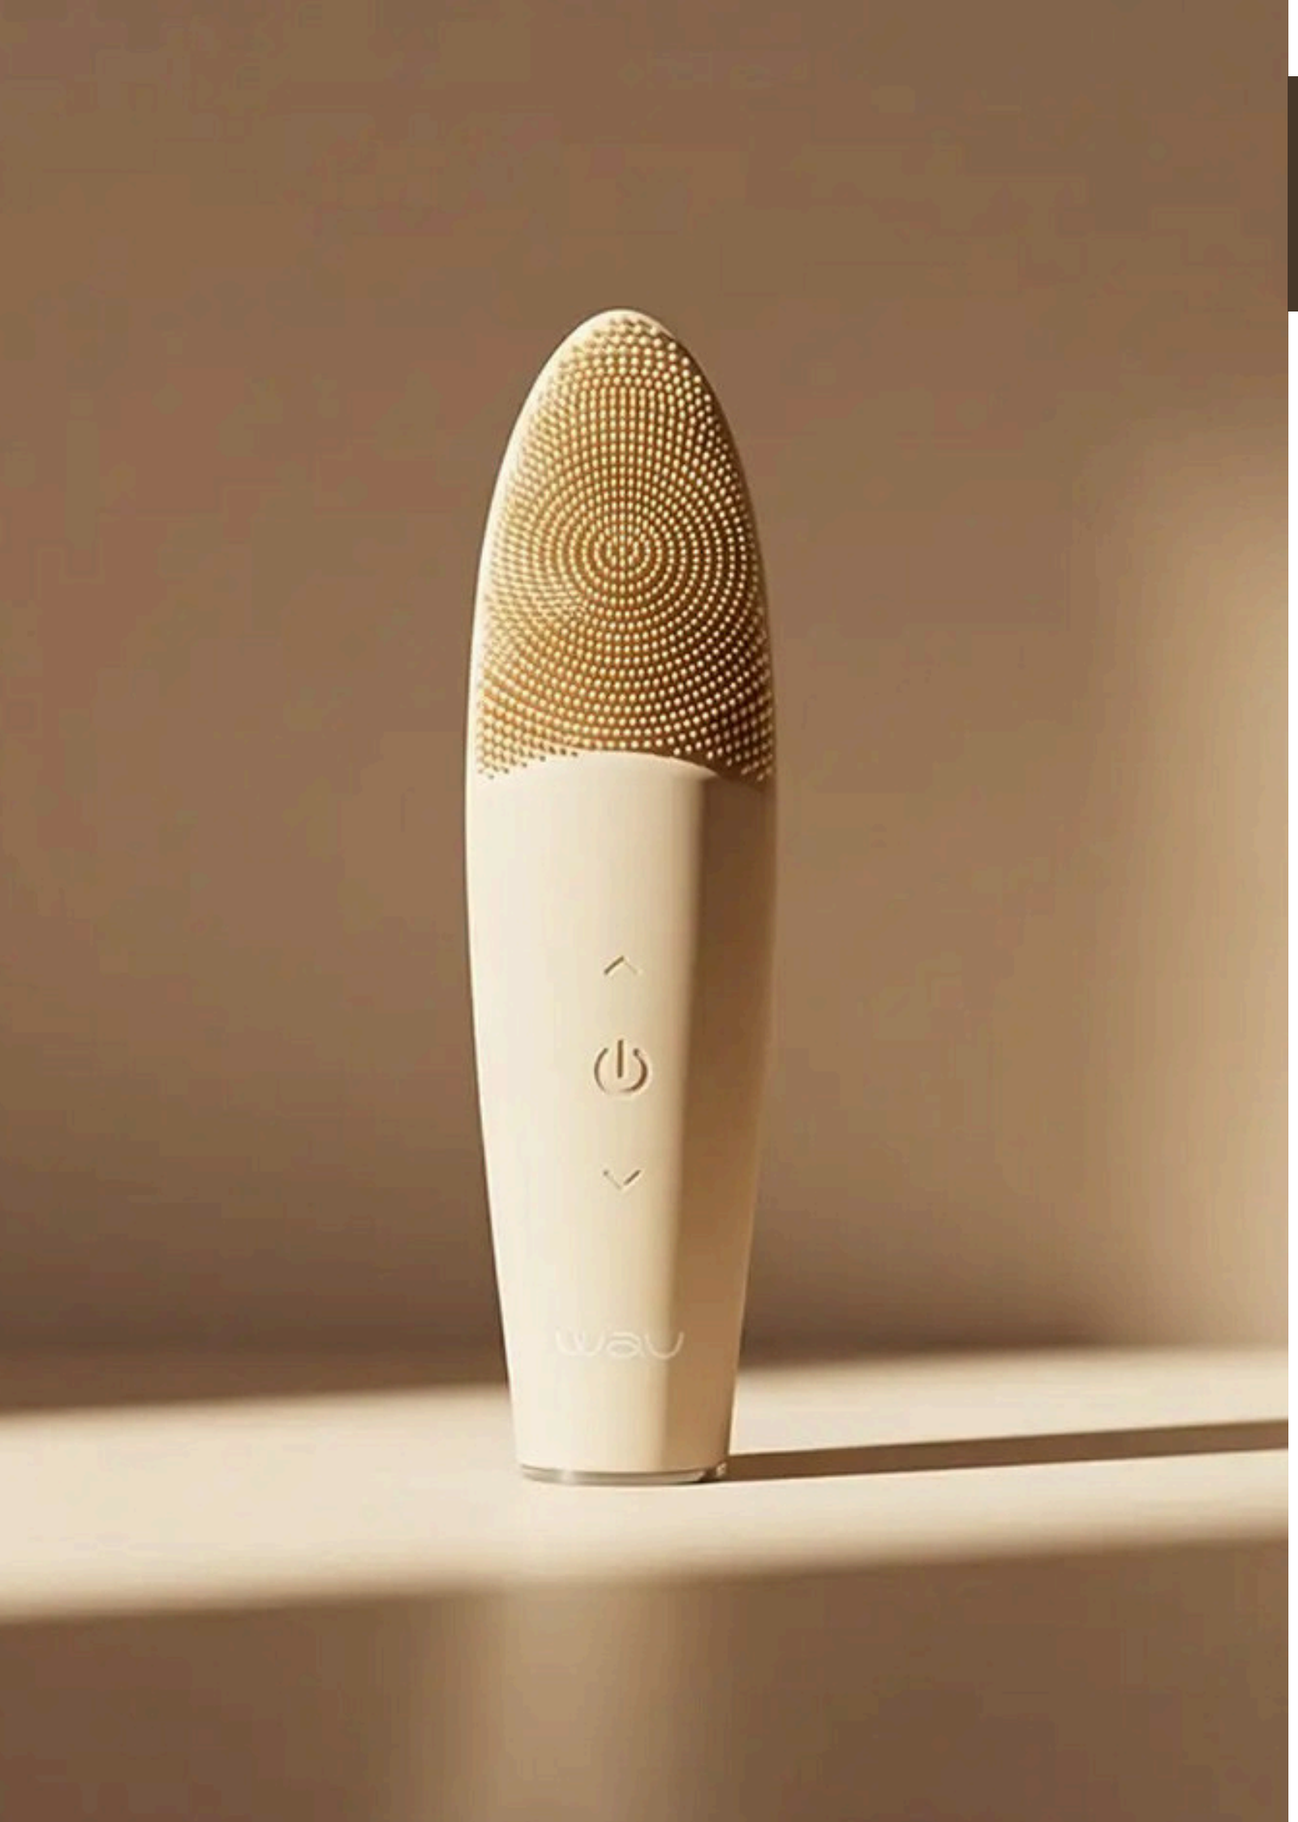

# EMI - SILIKONEBØRSTE TIL ANSIGTSRENSNING OG MASSAGE

Renser huden

Løftende effekt

Reducerer hævelser

Forbedrer hudens udseende

**PROBLEMOMRÅDER:** tilstoppede og udvidede porer, høj talgproduktion og hævelser.

**MATERIALER: silikone.**

**VÆGT:** 97 g.

**FUNKTIONER:**
Massageapparatet arbejder med højfrekvente (soniske) vibrationer, hvis styrke kan justeres individuelt. Lydbølgen (højfrekvent vibration) får børstehårene til at svinge hurtigt og udføre fejende bevægelser. På den måde renser børsten ansigtshuden, og den samlede effekt udjævner hudtonen og renser porerne.

Vibration og siden med riller giver blid massage, genopretter blodcirkulationen og udglatter fine rynker.

Varmetilstanden åbner porerne og renser huden i dybden. Varmen aktiverer desuden blodcirkulationen, fremskynder hudens stofskifteprocesser og fremmer optagelsen af gavnlige kosmetiske ingredienser.

**EGENSKABER:**
1. Apparatets unikke form som et fingerled og det elastiske, bøjelige hoved gør det muligt at rense alle ansigtsområder grundigt, effektivt og ubesværet for snavs og makeup.
2. Børsten er fremstillet af fødevaregodkendt silikone og renser skånsomt, også på meget følsom hud.
3. Den magnetiske induktionsladebase med sugekop gør det nemt at placere massagebørsten på spejlet eller væggen i badeværelset og forenkler opbevaring og opladning.
4. 8 justerbare vibrationsniveauer.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tænd apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde.
2. Børsten har 2 tilstande: konstant vibration med varme og bølgevibration. Ved første tænding starter konstant vibration med varme automatisk.

3. Konstant vibration med varme har 8 vibrationsniveauer. Justér niveauet med knapperne til at øge/sænke hastigheden.
4. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at skifte til bølgevibration.
5. Et nyt tryk på tænd/sluk-knappen slukker apparatet.
6. Børsten har hukommelsesfunktion: når den tændes igen, starter den i den senest anvendte tilstand.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

TIL GRUNDLÆGGENDE RENSNING
1. Fugt ansigtet med vand.
2. Kom renseprodukt på børsten.
3. Tænd apparatet i tilstanden med konstant vibration og varme.
4. Dan skum med børsten ved at holde den mod håndleddet.
5. Læg børstehovedet mod ansigtet, og massér for at rense huden. Bevæg dig nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen i panden) langs massagelinjerne.
6. Skyl rester af kosmetik af ansigtet og børsten med vand, når du er færdig.

TIL DYB RENGØRING AF T-ZONEN
1. Fugt ansigtet med vand.
2. Kom renseprodukt på børsten.
3. Tænd apparatet i bølgevibrationstilstand.
4. Dan skum med børsten ved at holde den mod håndleddet.
5. Læg børstehovedet mod ansigtet, og massér T-zonen. Bevæg dig nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen i panden) langs massagelinjerne.
6. Skyl rester af kosmetik af ansigtet og børsten med vand, når du er færdig.

TIL MASSAGE
1. Påfør dit kosmetiske produkt, f.eks. creme/serum/gel, i ansigtet (det skal være fugtgivende).
2. Tænd apparatet, og vælg en behagelig tilstand.
3. Massér ansigtet med børstens bagside, og bevæg dig nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen i panden) langs massagelinjerne.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| **AKNE / BETÆNDELSE** | Helst om morgenen | Bølgevibration: 5 min. Brug ikke opvarmning. | Dagligt | Løbende |
| **TØR HUD / TAB AF SPÆNDSTIGHED** | Morgen | Kontinuerlig vibration med opvarmning: 3-5 min, kun på kinder og hage. Bølgevibration: 3-5 min. Begge tilstande kan bruges under samme behandling, men kontinuerlig vibration med opvarmning må kun bruges hver anden dag. Brug ikke begge tilstande hver dag. | Kontinuerlig vibration med opvarmning: hver anden dag. Bølgevibration: dagligt. | Løbende |



| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| **HUDORME (uden inflammation)** | Når som helst på dagen | Kontinuerlig vibration med varme: 5-7 min. T-zone: pande, næse og hage. | Dagligt | Løbende |
| **VARMEMASSAGE (uden inflammation)** | Når som helst på dagen | Kontinuerlig vibration med varme: 5-7 min. | 2-3 gange om ugen | Løbende |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Brug ikke apparatet ved kraftige hævelser i huden, umiddelbart efter operation, ved solskoldning eller hudskader.
2. Apparatet anbefales ikke til personer med kraftig betændelse eller hævelse omkring øjnene.
3. Brug ikke apparatet med et letopløseligt renseprodukt, silikonebaserede cremer, produkter med korn (scrub) eller peelingprodukter.
4. Det anbefales, at børsten kun bruges af én person.

**ADVARSLER:**
1. Tag ur, briller, kunstige øjenvipper og kontaktlinser af før brug.
2. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
3. Brug ikke apparatet for længe på samme hudområde.
4. Hold apparatet væk fra høje temperaturer.
5. Nedsænk ikke apparatet helt i vand.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) børste, (2) ladebase, (3) DC-USB-ladekabel, (4) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 5 h

**DRIFTSTID:** 60 min

**SMART TIMER:** 5 min

**OPVARMNINGSTEMPERATUR:** 55 ± 5 °C

**VIBRATION:** 7500 omdrejninger pr. minut

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7




# HAZUMI LIGHT - MASSAGEPISTOL

Lindrer muskelspændinger

Forbedrer cirkulationen

Forbedrer muskeltonus

Anticellulitevirkning

**PROBLEMOMRÅDER:** smerter, spændinger og muskeltræthed efter hård fysisk aktivitet.

**MATERIALER:** ABS-plast, gummi.

**VÆGT:** 230 g.

**FUNKTIONER:**
Massagepistolen skaber slagvibrationer - hurtige, korte impulser, hvis frekvens og styrke afhænger af den valgte hastighed. Vibrationsbølgen trænger ved slagkraftens påvirkning flere centimeter ned i kroppens bløde væv. Impulserne „afspænder" musklerne, presser lymfevæske og venøst blod ud af betændte muskler, løsner sammenvoksninger, lindrer smerter, reducerer spændinger, øger bevægeligheden i den pågældende kropsdel og strækker musklerne skånsomt. Muskler og bindevæv restituerer derfor hurtigere.

**EGENSKABER:**
1. HAZUMI Light er et let minimassageapparat med mere kompakte mål end HAZUMI, hvilket gør massagen endnu mere behagelig.
2. 4 udskiftelige hoveder medfølger til behandling af alle muskelgrupper.
3. 5 intensitetsniveauer gør det muligt at vælge den mest behagelige slaghastighed og tilpasse den til forskellige muskelgrupper og hoveder.
4. Den smarte timer (10 minutter) gør, at du kan slappe af under massagen; apparatet slukker automatisk, når behandlingstiden er gået.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Sørg for, at apparatet er opladet.
2. Sæt det ønskede massagehoved i apparatet.
3. Start apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde.
4. Når massagepistolen tændes, indstilles intensitetsniveau 1 automatisk.
5. Tryk kort på knappen for at skifte intensitetsniveau. Apparatet har i alt 5 hastigheder. Ved den første lyser 1 indikator; for hver efterfølgende stigning tændes endnu en indikator, og ved hastighed 5 lyser alle 5 indikatorer.

6. Sluk massageapparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Montér 1 af de 4 hoveder afhængigt af, hvilket kropsområde du vil behandle.
• Det runde hoved anbefales til massage af store muskelgrupper, lår, lægge, balder og mave.
• Det U-formede hoved bruges til massage af skuldre, underarme og rygsøjle.
• Det kegleformede hoved (kugle) er beregnet til dyb massage af sener, fodsåler, håndflader, hænder og triggerpunkter.
Det flade hoved bruges til massage af hele kroppen samt afslapning og restitution af blødt væv og følsomme muskelgrupper.
2. Vælg 1 af de 5 intensitetsniveauer ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen.
Niveau 1: denne hastighed hjælper med at varme musklerne op i starten af massagen og bruges til at aktivere dem.
• Niveau 2. Intensitet, hvor behandlingen af dybe og svært tilgængelige muskler og fascier begynder (musklernes bindevævshinde, som muliggør bevægelse).
• Niveau 3. Vibration ved denne frekvens øger muskeltonus, bevægelighed og muskelvævets smidighed. Spændte og fastlåste muskler genvinder evnen til at trække sig sammen, være spændstige og fungere korrekt.
• Niveau 4. Denne påvirkning lindrer spændinger og smerter i muskler og fascier, afslapper, normaliserer blodcirkulationen og ilter vævet.
• Niveau 5. Intensiteten på 3000 omdrejninger i minuttet giver mulighed for akupressur, afhjælper svær muskelspænding og spasmer. Massageterapeuter anbefaler ikke at bruge enheden ved maksimale hastigheder. Et højt eksponeringsniveau er velegnet til brugere med udviklede muskler - professionelle vægtløftere, bodybuildere og styrkeløftere.
3. Læg massagepistolen mod kroppen. Placér den, så hovedet berører huden let over musklen.
4. Tilpas det tryk og den kraft, du lægger apparatet mod kroppen med. Det anbefales ikke at presse massageapparatet mod kroppen, især ikke vedvarende og kraftigt.
5. Før langsomt hovedet op og ned langs kroppen/musklen; du kan blive lidt længere ved ømme punkter.
6. Behandlingstiden på ét område afhænger af den ønskede effekt. 15-60 sekunder er tilstrækkeligt til at løsne spændinger og aktivere musklerne; ved en lokal muskelspænding bør du blive på punktet i 30 sekunder.
7. Den samlede massagetid er 10 minutter, hvorefter apparatet stopper automatisk.

**BRUGSHYPPIGHED:**
Daglig brug er tilladt.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**



**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Massagepistolen må ikke bruges på halsens forside og sider (risiko for at beskadige halspulsårerne).
2. Massageapparatet må ikke bruges i ansigtet, på hovedet eller ved hjertet.
3. Massageapparatet anbefales ikke ved betændelsestilstande, knoglebrud eller forstrækninger af muskler og ledbånd.

**ADVARSLER:**
1. Brug ikke apparatet i fugtige omgivelser.
2. Brug ikke produktet i badekar eller brusebad.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massagepistol, (2) U-formet hoved, (3) rundt hoved,
4. kegleformet hoved, 5) fladt hoved, 6) USB-C-ladekabel,
7. snor, 8) opbevaringspose, 9) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**
**OPLADNINGSTID:** 2 timer DRIFTSTID: afhænger af trykket og det anvendte niveau
• Niveau 1 op til 4 timer
Niveau 5 op til 2.5 timer Smart timer: 10 minutter
**VIBRATIONSHASTIGHED:**
• Niveau 1 - 1800 omdrejninger pr. minut
Niveau 2 - 2100 omdrejninger pr. minut
• Niveau 3 - 2400 omdrejninger pr. minut
Niveau 4 - 2700 omdrejninger pr. minut
• Niveau 5 - 3000 omdrejninger pr. minut



# HIGE - KOMPAKT ELEKTRISK BARBERMASKINE

Skægpleje | Tæt barbering | Fjerner uønsket hår

**PROBLEMOMRÅDER:** kraftig hårvækst i ansigtet.

**MATERIALER: metal.**

**VÆGT:** 140 g.

**FUNKTIONER:**
HIGE er en rotationsbarbermaskine med 2 skærehoveder. Hovedet er en skive med huller, hvorunder bladene roterer. De drejer i cirkler og drives af en elmotor. Ved barbering kommer hårene ind i hullerne, hvor bladene under gitrene med høj hastighed fra 2600 til 2900 vibrationer pr. minut skærer skægstubbene helt af. Denne type barbermaskine anses for den mest effektive, men kan irritere følsom hud.

**EGENSKABER:**
1. Kompakt - den elektriske barbermaskine vejer kun 140 g og har optimale mål på 66x52x28 mm.
2. Barbermaskinen behøver ikke være tilsluttet stikkontakten. HIGE er batteridrevet. På én opladning kan den bruges trådløst i op til 55 minutter.
3. Fugtbeskyttelsesklasse IPX7 gør, at HIGE kan bruges til både tør og våd barbering.
4. HIGE har 2 fleksible skærehoveder. De følger ansigtets konturer under bevægelse, retter bladene i den rigtige vinkel og hjælper med at barbere svært tilgængelige steder mere effektivt.
5. Et lille display gør betjeningen af barbermaskinen nem og behagelig:
Displayet viser brugstid, batteriniveau, driftstilstand og låsestatus.
6. Låsefunktion. Du kan være sikker på, at barbermaskinen ikke tænder i bagagen/tasken/lommen.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tænd barbermaskinen med et kort tryk på tænd/sluk-knappen. Efter trykket lyser alle indikatorer på displayet skiftevis nedefra og op. Efter 0.2 sekunder slukkes alle indikatorer samtidigt, og displayet viser kun den resterende driftstid ved det aktuelle batteriniveau. Eksempel: 58 minutter tilbage.
2. Apparatet har 2 driftstilstande: lav og høj hastighed. Hold tænd/sluk-knappen inde i 1 sekund for at skifte tilstand. Når du skifter fra lav til høj hastighed,

vises hastighedsindikatoren på displayet (nederst til venstre). Når du skifter fra høj til lav hastighed, slukker indikatoren. Apparatet har hukommelsesfunktion: ved tænding arbejder det med den hastighed, du afsluttede sidste brug med.
3. Et kort tryk på tænd/sluk-knappen under brug sætter apparatet på pause. Displayet viser da apparatets driftstid i den aktuelle brugssession. Eksempel: brugt i 15 sekunder.
4. Slukning Hold tænd/sluk-knappen inde i mere end 1 sekund for at slukke apparatet.
5. Beskyttelse mod utilsigtet start: barbermaskinen har en transportlås, som forhindrer, at den tænder i bagagen, hvis der ved et uheld trykkes på tænd/sluk-knappen. For at aktivere denne funktion skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen på den slukkede enhed nede i 3 sekunder. Displayet vil skiftevis vise tallene 1-2-3, og låseikonet (i nederste højre hjørne af displayet) vil blinke 3 gange, hvorefter enheden slukker og går i låsetilstand. For at fjerne låsen skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. På displayet vil tallene 3-2-1 skiftevis blive vist, og låseikonet (i nederste højre hjørne af displayet) vil blinke 3 gange, hvorefter låsen fjernes, og enheden vil begynde at arbejde med den hastighed, der blev gemt ved sidste brug. Når låsen er aktiveret, er det muligt at oplade enheden, efter at den er færdig, fjernes låsen.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Tænd apparatet med et kort tryk på tænd/sluk-knappen.
2. Før det hen over ansigtets hårbevoksede områder med langsomme cirkelbevægelser og moderat tryk (tør barbering anses for mere effektiv).
3. På svært tilgængelige steder, f.eks. kæbe, hals og dekolleté, anbefales det at bevæge apparatet mod hårenes vækstretning.
4. Sluk og rengør apparatet efter behandlingen.
5. Let hudirritation ved de første anvendelser anses for normalt.

**BRUGSHYPPIGHED:**
Det anbefales at bruge barbermaskinen regelmæssigt (mindst 3 gange om ugen) i 3 uger, så huden hurtigst muligt vænner sig til apparatet.

**BRUGSVARIGHED:**
Et sæt blade kan bruges i 2 år, men for at bevare barberingskvaliteten anbefaler vi udskiftning hver 6. måned.

**KONTRAINDIKATIONER:**
Brug ikke den elektriske barbermaskine på beskadiget eller irriteret hud eller områder med åbne sår.

**ADVARSLER:**
1. Forkert brug kan beskadige skærehovedet. Pres ikke barbermaskinen for hårdt mod huden. Denne barbermaskine er kun beregnet til barbering af ansigtet. Brug den ikke til hovedhår eller andre kropsdele.



2. Kontrollér skærehovedet for skader før brug:
Hvis det er beskadiget, må apparatet ikke bruges.
3. Skil ikke kabinettet ad for at udskifte batteriet. Du må ikke selv ændre eller reparere produktet.
4. Træk ikke i ladekablet, når det tilsluttes eller afbrydes fra adapteren. Vikl ikke ladekablet rundt om produktet, da det kan beskadige kablet.
5. Efterlad ikke apparatet uden opsyn i længere tid. Den maksimale opladningstid må ikke overstige 24 timer. Hold produktet væk fra vandkilder under opladning for at undgå skader.
6. Produktet indeholder et batteri; kast ikke apparatet i ild, og oplad, brug eller opbevar det ikke ved høje temperaturer. Oplad, brug og opbevar barbermaskinen ved temperaturer mellem 5°C og 35°C.
7. Stik ikke fremmedlegemer ind i produktet.
8. Barbermaskinen er beregnet til personlig brug af én person.
9. Hvis du rejser med barbermaskinen, skal du sikre, at låsefunktionen er aktiveret under transport.
10. Personer uden fuld retlig handleevne skal bruge produktet under opsyn.

**PAKKENS INDHOLD:** 1) elektrisk barbermaskine, 2) USB-C-ladekabel, 3) vejledning,
4. olieflaske til smøring af bladene, 5) rengøringsbørste,
6. opbevaringsetui af læder.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 66 min

**DRIFTSTID:** 60 min

**SMART TIMER:** nej

**KLINGERNES ROTATIONSHASTIGHED:** Lav - 2600 ± 200 omdrejninger pr. minut • Høj - 2900 ± 200 omdrejninger pr. minut

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7



# HIGE PRO - 6-I-1-TRIMMER

Pleje af hår og skæg derhjemme

Fjerner uønsket hår i ansigtet og på kroppen

**PROBLEMOMRÅDER:** tilpasning af hårlængde, uønsket hår.

**MATERIALER:** metal, rustfrit stål, plast.

**VÆGT:** 200 g.

**FUNKTIONER:**
HIGE Pro er et alsidigt apparat til personlig pleje. Med de 6 medfølgende hoveder klarer det nemt alle former for barbering og klipning. Håret klippes ikke af ét blad alene, men ved samspil mellem et fast (nederste) og et bevægeligt (øverste) blad. Det nederste blad står stille og ligger tæt mod huden. Dets tænder fører og „griber" hårene og holder dem oprejst. Det øverste blad er forbundet med rotationsmotorens excenter. Det bevæger sig hurtigt fra side til side hen over det nederste blad. Det øverste blads skarpe kant klipper dermed håret ved at presse det mod det nederste blads skarpe kant.

**EGENSKABER:**
1. 6 hoveder til forskellige former for barbering.
2. 4 afstandskamme til justering af klippelængden.
3. Praktisk holder til selve apparatet og alle de vigtigste hoveder.
4. Professionelle blade med en rotationshastighed på 7000 omdrejninger pr. minut.
5. Fugtbeskyttelsesklasse IPX6 (apparatet kan bruges på våd hud).
6. Barbermaskinen behøver ikke være tilsluttet stikkontakten. HIGE Pro er batteridrevet. Batteritiden er 200 minutter, så det kan bruges længe uden konstant opladning.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke apparatet. Ved tænding bevæger linjen på displayet sig jævnt og lyser derefter konstant.
2. Udskiftning af hoveder
• Apparatet har magnetisk fastgørelse af metalhovederne. Hold hovedet hen til fastgørelsesstedet på kabinettet, så magneterne fastgør det. Træk hovedet opad for at fjerne det fra kabinettet.

• Afstandskammene sættes oven på standardhovedet for at justere hårlængden ved klipning. Hægt kammen på metalhovedets øverste del, og tryk derefter på kammens nederste del, til den klikker på plads og ligger tæt mod metalhovedet. Træk tappen nederst på kammen opad for at fjerne den. Bemærk: kontrollér, at apparatet er slukket, før du skifter hoved. Hold hænderne på kabinettet væk fra tænd/sluk-knappen under udskiftningen, så apparatet ikke tændes ved et uheld.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
Apparatet leveres med 6 hoveder til forskellige behov:
1. Hårklipning (2 hoveder er velegnede):
standardhovedet til hårklipning og hovedet til barbering af kropshår) Fastgør afstandskammen på apparatet. Hvis du bruger trimmeren første gang, skal du starte med den længste kam (12 mm). Tænd apparatet, og læg hovedets flade del mod huden. Før langsomt hovedet hen over håret. Gentag bevægelser i forskellige retninger efter behov. Bemærk: hvis der samler sig hår på kammen under klipning, skal du slukke apparatet og rense hovedet.
2. Trimning af skæg/overskæg Placér hovedet ved kanten af skæg-/overskægslinjen, og sænk det forsigtigt mod huden. Trim de ønskede områder i ansigtet og på halsen med bevægelser i forskellige retninger. Bemærk: fjern afstandskammen, når du former skæggets/overskæggets kanter, nakkehår osv. Du kan også bruge det særlige hoved til skæg- og overskægskanter for at skabe en præcis linje.
3. Barbering med foliehovedet Shaver Hold apparatet, så hovedet berører ansigtet let i en vinkel på 45 grader. Barbér med korte berøringer. Stræk huden med den frie hånd. Det rejser hårene og gør barberingen lettere. Bemærk: hovedet er udviklet til enkelte områder omkring skæg/overskæg. Det er ikke beregnet til en fuld barbering.
4. Trimning af næse- og ørehår Montér hovedet, og før det forsigtigt ind i øret eller næseboret. Før apparatet forsigtigt ind og ud af øret eller næseborene. Drej hovedet under trimningen. Bemærk: før ikke hovedet for dybt ind i øret eller næseboret (højst 6 mm).
5. Barbering med mønsterhovedet Dette hoved bruges til at klippe linjer og mønstre. Montér det, placér det ved mønstrets planlagte begyndelse, tænd barbermaskinen, og begynd at forme mønstret. Tryk ikke for hårdt på hovedet. Bemærk: brug en forberedt skabelon for de bedste resultater.

**BRUGSHYPPIGHED:**
Daglig brug er tilladt.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**



**ADVARSLER:**
1. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under opladning.
2. Hold ladekablet væk fra varmekilder.
3. Lad ikke vand trænge ind i ladekablet.
4. Sæt ikke stikket i, og træk det ikke ud med våde hænder.
5. Brug ikke et beskadiget ladekabel.
6. Oplad, brug og opbevar apparatet ved temperaturer mellem 15 °C og 35 °C.
7. Sluk altid apparatet ved rengøring.
8. Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) trimmer, (2) standardhoved til hårklipning,
3. hoved til kropsbarbering, 4) foliehoved til tæt barbering,
5. hoved til skæg og overskæg, 6) hoved til næse- og ørehår,
7) mønsterhoved, 8) 4 afstandskamme (3/6/9/12 mm), 9) USB-C-ladekabel, 10) olieflaske, 11) rengøringsbørste, 12) holder, 13) kam.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 2 h

**DRIFTSTID:** 200 min

**SMART TIMER:** nej

**KLINGERNES ROTATIONSHASTIGHED:** 7000 omdrejninger pr. minut

**VANDBESTANDIGHED:** IPX6



# KARU - MULTISTYLER TIL HÅR

Hurtig tørring

Effektiv styling

Modvirker krus

**PROBLEMOMRÅDER:** vådt hår, formløs frisure efter lufttørring samt meget kruset og elektrisk hår.

**MATERIALER:** aluminiumslegering, plast.

**VÆGT:** 318 g.

**FUNKTIONER:**

3 luftstrømshastigheder og 4 temperaturniveauer gør det muligt at vælge en behagelig tørring. Koldluftstilstanden hjælper med nemt at fiksere frisuren.

Med FIRE HOVEDER til skånsom tørring, glatning, volumen og krøller kan du skabe professionel styling derhjemme hver dag.

COANDA-effekten gør det nemt at skabe unikke frisurer uden at skade håret eller udføre unødige bevægelser; hårlokken trækkes selv hen mod styleren.
Ioniseringsfunktionen tilfører luften negative ioner, som fjerner statisk elektricitet.

**EGENSKABER:**
1. KARU-stylerens effekt er 1200 watt. En styler med denne effekt kan betragtes som professionel. Det giver mulighed for at tørre håret med en kraftigere luftstrøm og hurtigere opvarmning.
2. Den børsteløse motor (BLDC) reducerer støj og vibrationer.
3. Coanda-effekten er et aerodynamisk fænomen, som skaber hvirvelstrømme, der tiltrækker og vikler håret om hovedet. KARU-styleren bruger en unik egenudviklet teknologi til at genskabe Coanda-effekten. Hovedets dele overlapper eller krydser ikke hinanden, så hårlokken fordeles jævnt langs hovedet, hele håret varmebehandles ensartet, og krøllen formes og holder sin form længe.
4. Du behøver kun 1 hoved til styling på begge sider af hovedet. Både krøllehovedet og glattehovedet har en indbygget kontakt til luftstrømmens retning. Du skal ikke skifte hoved, men blot ændre luftretningen ved at dreje hovedets øverste spids i den ønskede retning.

5. Temperaturstyring. KARU-stylerens varmeelement har en NTC-temperatursensor: Når temperaturen overstiger 80 °C, og luftudløb eller luftindtag er blokeret, sænkes varmen automatisk med 35%. Når temperaturen falder til mindst 73 °C, vender varmeelementet tilbage til normal drift. Teknologien beskytter håret mod overophedning og udtørring.
6. KARU-styleren har ionisering (ionerne dannes af en iongenerator). Den giver glat hår og fjerner krus og statisk elektricitet.
7. Apparatet har hukommelsesfunktion og starter i den tilstand, du afsluttede sidste brug med.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Montering/afmontering af hoved Sæt forsigtigt hovedet i rillerne i monteringsåbningen, og drej det lidt med uret, til det klikker på plads. For at fjerne hovedet skal du trække knappen bag på apparatet ned, holde den nede og tage hovedet af ved at dreje det lidt mod uret.
2. Tænding Montér det ønskede hoved på apparatet, sæt styleren i stikkontakten, og skub tænd/sluk-knappen op. Apparatet har hukommelsesfunktion og starter i den tilstand, du afsluttede sidste brug med.
3. Valg af luftstrømshastighed
Apparatet har 3 hastighedstilstande:
Lav hastighed (blå indikator): 75000 ± 5000 rpm;
Gennemsnitshastighed (lysegrøn indikator): 85000 ± 5000 rpm;
Høj hastighed (stærk grøn indikator): 105000 ± 5000 rpm. Tilstandene skiftes ved at trykke på knappen til valg af luftstrømshastighed. Som standard vil enheden begynde at fungere i lavhastighedstilstand. Rækkefølgen af skiftende tilstande for hastigheder af blæst luft: lav -> medium -> høj -> medium -> lav.
4. Temperaturvalg
Apparatet har 4 temperaturtilstande:
Høj temperatur (rød indikator): 95 °C ± 10 °C;
Middeltemperatur (gul indikator): 80 °C ± 10 °C;
Lav temperatur (grøn indikator): 60 °C ± 10 °C;
• Kold luft (indikatoren slukker): 25 °C ± 10 °C. Skift tilstand ved at trykke på temperaturknappen. Som standard starter apparatet ved lav temperatur. Rækkefølgen er: lav temperatur -> middeltemperatur -> høj temperatur -> middeltemperatur -> lav temperatur -> kold luft.
5. Sluk apparatet efter styling ved at skubbe tænd/sluk-knappen ned. Vent, til apparatet er helt afkølet, og fjern derefter hovedet og stikket fra stikkontakten.



**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
Der medfølger 4 hoveder:

Bruges til fortørring før styling; håret skal ikke tørres helt, men forblive let fugtigt til den videre styling. Påfør varmebeskyttelse for at beskytte håret, og tør det derefter normalt med luftstrømmen rettet fra rødderne mod spidserne.

RUNDBØRSTEHOVEDET bruges til volumen ved rødderne og bølger. Vikl ikke hårlokken om børsten som om et krøllejern eller curlere, da håret kan filtre. Del håret i lokker. Før børsten så tæt på rødderne som muligt, og læg en hårlok på den; hold positionen i 5-7 sekunder for at skabe volumen. For at lave bølger føres hovedet langs lokken fra rødder mod spidser. Når spidserne er ved at glide fri, drejes børsten flere gange om sin akse. Gentag, indtil du har opnået det ønskede resultat.

Det cylindriske hoved på 38 mm bruges til at skabe krøller. Luftstrømmens retning kan ændres for at vælge krøllens retning. Drej hovedets øverste spids i den ønskede retning. Del håret i lokker. Før hovedet hen til spidserne af en lok. Coanda-effekten får styleren til selv at trække håret til sig og vikle det om hovedet. Når spidserne er viklet på, føres hovedet gradvist mod rødderne uden at dreje styleren. Hold styleren i den øverste position i ca. 15 sekunder, og frigør derefter forsigtigt den krøllede lok.

Glattehovedet bruges til at udglatte kruset hår. Luftstrømmens retning kan ændres for nemmere styling. Drej hovedets øverste spids i den ønskede retning. Tør håret normalt, og placér derefter hovedet ved rødderne, så håret ligger på overfladen med luftudløb. Tilpas luftretningen. Før det langs hele håret fra rødder til spidser, som når du reder det.

**BRUGSHYPPIGHED:**
Daglig brug er tilladt.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**ADVARSLER:**
1. Husk under styling, at apparatets dele bliver varme; brug ikke brandfarlige produkter i håret, og hold apparatet på tilstrækkelig afstand af hovedbund, ansigt, ører og hals.
2. Kontrollér efter udpakning, at styleren er intakt, har alle dele som vist på illustrationen og ikke har tegn på skader. Fjern alle etiketter, mærker osv. før brug.

3. Apparatet må ikke bruges i badekar eller brusebad. Styleren må ikke komme i kontakt med vand, andre væsker, stænk eller damp.
4. Hvis apparatet bruges på badeværelset, skal stikket tages ud straks efter brug, da nærhed til vand er farlig, selv når apparatet er slukket.
5. Brug ikke apparatet med våde hænder. Udsæt det ikke for fugt, vejrpåvirkninger (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
6. Træk ikke i netledningen eller selve apparatet for at tage stikket ud. Træk eller løft ikke apparatet i ledningen. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes på et servicecenter.
7. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet elnettet. Afbryd altid strømmen før rengøring eller vedligeholdelse, og når apparatet ikke bruges.
8. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Børn fra 8 år må kun bruge dette apparat under opsyn af voksne.
9. Stop straks brugen, hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer korrekt. Kontakt et servicecenter for reparation.
10. Brug ikke styleren, hvis den er blevet tabt eller har synlige skader.
11. Brug ikke apparatet på dyr, parykker eller frisurer af syntetiske materialer.
12. Brug kun apparatet med originalt tilbehør.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) styler, (2) føntørrerhoved, (3) rundbørstehoved, (4) krøllehoved,
5. glattehoved, 6) opbevaringspose, 7) hårklemme (2 stk.),
8. vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MOTORHASTIGHED:** 105000 ± 5000 omdrejninger pr. minut

Luftmængde: 13 liter pr. sekund

**LUFTSTRØMSHASTIGHED:**
Lav hastighed: 75000 ± 5000 omdrejninger pr. minut
• Middelhastighed: 85000 ± 5000 omdrejninger pr. minut
Høj hastighed - 105000 ± 5000 omdrejninger pr. minut

**TEMPERATURTILSTANDE:** • Høj temperatur - 95 °C ± 10 °C • Mellemtemperatur - 80 °C ± 10 °C • Lav temperatur - 60 °C ± 10 °C • Kold luft - 25 °C ± 10 °C



# KINU - TRÅDLØST GLATTEJERN

Glatte hår

Styler og former håret

Skånsom behandling

Modvirker krus

Bevarer hårets sunde glans

**PROBLEMOMRÅDER:**

**RELATERET TIL BRUG:** problemer med styling uden for hjemmet, hårskader fra høj temperatur og ujævn opvarmning af pladerne, risiko for tørt og skørt hår, ulemper ved ledningsbundne apparater, manglende temperaturjustering til forskellige hårtyper, besvær med at skabe forskellige frisurer, risiko for overophedning, almindelige glattejerns store størrelse og vægt samt besværlig transport og opbevaring.

Relateret til hårtypen: porøst, kraftigt, krøllet, bølget, genstridigt og svært håndterbart hår.

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast.

**VÆGT:** 380 g (glattejern), 243 g (opladningsstation).

**FUNKTIONER:**

Glatning - de opvarmede plader blødgør keratinbindingerne i håret. Hårlokken holdes mellem pladerne og glattes; bindingerne afkøles i en ny, lige position.

Udglatning - de varme plader fører håret i den rigtige retning. Varmen gør håret mere formbart, og formen fikseres under afkøling gennem en midlertidig ændring af hydrogenbindingerne i hårets struktur.

Formning - krøller, bølger og volumen skabes ved en kombination af varme og mekanisk påvirkning (drejning, strækning og bøjning af lokken). Håret får form efter den varme plade eller redskabets bevægelse, og formen fikseres ved afkøling.

**EGENSKABER:**
1. Trådløs.
2. To opladningsmuligheder: via Type-C-kabel eller ladebase.
3. 4 temperaturtilstande.
4. Skånsomme keramiske plader.
5. Temperaturstyring.
6. Batterilås til sikker transport.
7. Hukommelse for de seneste indstillinger.
8. Udvidet udstyrspakke med meget tilbehør.
9. Digitalt display.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Oplåsning Skub låsekontakten op til „ulåst" før brug. Advarsel: apparatet kan ikke tændes, mens det er låst.
2. Tænding Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder. Det dynamiske lys tænder og viser, at apparatet er tændt.
3. Slukning Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder.
4. Af hensyn til sikkerhed og batteribesparelse slukker apparatet automatisk efter 30 minutters inaktivitet.
5. Justér temperaturen med knapperne „+" og „–". Fire varmeniveauer er tilgængelige: 150, 180, 200 og 220 grader. Vælg temperatur efter hårets type og tilstand. Det valgte niveau blinker under opvarmning. Når den indstillede temperatur er nået, holder indikatoren op med at blinke og lyser konstant.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Sørg for, at håret er rent, tørt og grundigt redt. Det anbefales ikke at bruge glattejernet på vådt eller fugtigt hår.
2. Tænding Lås glattejernet op ved at skubbe kontakten til „Unlock". Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder, indtil det dynamiske lys tænder.
3. Temperaturvalg
Vælg den passende temperatur med knapperne + / –:
150 grader til fint, beskadiget eller afbleget hår
180-200 grader til normalt hår
220 grader til tykt, kraftigt eller krøllet hår. Temperaturindikatoren blinker under opvarmning og lyser konstant, når den indstillede temperatur er nået.
4. Glatning af hår
• Del håret i små totter.
Læg hårlokken mellem de keramiske plader, og luk dem.
• Før forsigtigt glattejernet fra rødderne til spidserne.
Bliv ikke på ét sted i mere end 3 sekunder, da det kan overophede håret.
5. Krølning af hår
Tag en lille hårlok, og klem den mellem de keramiske plader.
• Drej glattejernet om sin akse for at sno lokken i den ønskede retning.
Før langsomt apparatet fra rødder til spidser, mens lokken holdes snoet i nogle sekunder.
• Frigør forsigtigt lokkerne efter krølningen, og fiksér om nødvendigt frisuren med hårspray.



6. Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder efter styling for at slukke apparatet. Tilslut om nødvendigt apparatet til ladebasen for at genoplade det.

**ADVARSLER:**
1. Læs brugsanvisningen grundigt før brug.
2. Brug ikke apparatet på vådt eller fugtigt hår eller nær vand (f.eks. på badeværelset eller ved håndvasken), da det kan give elektrisk stød.
3. Rør ikke ved de varme keramiske plader under brug - det kan give forbrændinger.
4. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
5. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller har synlige fejl på kabinet, ledning eller ladebase.
6. Hold apparat og oplader væk fra børn og kæledyr.
7. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.
8. Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Alle reparationer må kun udføres af en kvalificeret fagperson.
9. Afbryd straks strømmen til apparatet ved fejl.
10. Brug kun originalt tilbehør og opladere anbefalet af producenten.
11. Kontrollér under opladning, at kontakterne og ladebasens indre er rene og tørre.
12. Nedsænk ikke apparatet i vand, og vask det ikke under rindende vand.
13. Sluk apparatet efter brug og før rengøring

**PAKKENS INDHOLD:** 1) trådløst glattejern, 2) ladebase,
3. Type-C-ladekabel, (4) beskyttelseshætte af silikone, (5) hårelastik,
6. rengøringsklud, (7) varmebestandig måtte, 8) klemmer (2 stk.), 9) vejledning, 10) poser.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

Pladebelægning: keramik

**MÅL:** 303x38x42 mm (glattejern) 105x105x159 mm (opladningsstation)

**EFFEKT:** 47 W

**SPÆNDING:** 7,2 V

**TEMPERATURTILSTANDE:** 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

**DRIFTSTID (FULD OPLADNING):** 40 minutter

**OPLADNINGSTID:** 1,5-2 h

**VARMEPLADENS MÅL:** 25×100 mm



# KIO - EMS-MASSAGEAPPARAT TIL KROPPEN

Kropskonturering

Mod løs hud og cellulite

Bevarer fasthed og elasticitet i kroppens hud

**PROBLEMOMRÅDER:** overvægt (lokale fedtdepoter), cellulite, hævelser, slap og løs hud, strækmærker, synlige aldringstegn og pigmentering.

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** apparathus - 128 g. • apparathus med EMS-hoved - 224 g. • apparathus med RF-hoved - 221 g.

**FUNKTIONER:**
KIO-kropsmassageapparatets funktioner er fordelt på de særlige hoveder: EMS og RF&LED.

EMS ELLER ELEKTROMYOSTIMULATION er en behandling, der stimulerer muskler og nerveender med impulsstrøm med bestemte egenskaber. EMS efterligner kroppens egne elektriske impulser, som via elektroder når nerve- og muskelfibre og får dem til at trække sig sammen. Det styrker huden og øger dens elasticitet. Strømmens påvirkning af muskelvævet skaber ikke kun sammentrækninger, men forbedrer også lokal blodcirkulation og lymfedrænage. Det øger vævets næringstilførsel og fremskynder fjernelsen af stofskifteprodukter: nedbrydning af fedt og udskillelse af toksiner fra kroppen, som er den vigtigste drivkraft ved figurkorrektion og bekæmpelse af cellulite. Regelmæssig brug af EMS-massageapparatet forbedrer blod- og lymfecirkulationen og forebygger derved venøse lidelser og lindrer hævelser.

RF-LØFT er en behandling, hvor de dybe vævslag opvarmes med højfrekvent strøm. Den elektriske impuls passerer epidermis og øger temperaturen i dermis og underhudsfedtet, hvilket fører til kollagensyntese. Blodcirkulationen forbedres, og fedtcellernes stofskifte accelererer. Behandlingen forbedrer hudens egenskaber betydeligt - elasticitet, spændstighed og turgor øges, og huden strammes synligt op. Radiofrekvensimpulser kan mindske fedtvævets volumen, men RF-løftets vigtigste funktion er at stramme huden op.

Inden for rammerne af fototerapi svarer hver farve til en bestemt bølgelængde i det synlige lysspektrum. Ved at virke på huden i forskellige dybder absorberes lyset af hudreceptorer, hvilket aktiverer naturlige processer inde i cellen og forårsager en vis hudreaktion. Med den længste bølgelængde (i KIO 630 ± 20 nm), trænger rødt LED-lys ind i huden dybere end alle de typer lys, der præsenteres. Det virker på fibroblaster, som stimulerer produktionen af kollagen og derved regenerering af huden. Som et resultat af terapi med rødt LED-lys øges hudens fasthed og elasticitet, huden strammer op, og ydre tegn på hudens aldring, såsom rynker og pigmentering, aftager.

**EGENSKABER:**
1. Kompakt, ergonomisk form gør apparatet behageligt at holde.
2. Massageapparatet kombinerer 3 effektive teknologier: EMS, RF, LED.
3. Sættet indeholder 2 særlige magnetiske hoveder til tilstandene:
EMS-hoved med 4 store kugleformede metalelektroder og RF&LED-hoved med elektroder som små kugler og ringe samt LED'er.
4. Apparatets større behandlingsflade gør det muligt at påvirke forholdsvis store kropsområder på én gang.
5. Betjening med 1 knap: tænd/sluk og skift af intensitet.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Kropsmassageapparatet har 2 magnetiske hoveder: et med store kugler til EMS og et med ring og små kugler til RF&LED. Montér hovedet ved at sætte det i fordybningen på apparatets kabinet.
2. Montér hovedet, og hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder for at tænde massageapparatet. Afhængigt af det valgte hoved starter EMS eller RF&LED, og intensitetsindikatoren tænder.
3. Både EMS og RF&LED har 3 intensitetsniveauer. Tryk igen på intensitetsknappen for at skifte niveau. Lysindikatoren fyldes gradvist, når styrken øges. Efter maksimalt niveau går apparatet automatisk til laveste intensitet ved næste tryk. Bemærk, at kun RF-intensiteten ændres i RF&LED-tilstanden; LED er konstant.
4. Massageapparatet har en smart timer og slukker efter 5 minutters brug
5. Sluk apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder.
6. Hold apparatet med den ene hånd, og tag fat i massagehovedets „ører" på siderne med den anden. Træk hovedet fast mod dig for at tage det ud af kabinettet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
**GENERELLE ANBEFALINGER:**
1. Brug massageapparatet på ren hud; fjern overskydende fedt og alle urenheder fra kroppen.
2. Hvis kontaktgelen eller plejeproduktet optages i huden under massagen, skal du påføre det igen for at sikre fri bevægelse og glidning og øge effekten. Når du skifter kropsområde, skal du påføre kontaktgel på huden dér, hvor du vil arbejde.



før massagen.
3. KIO-massageapparatet har en bevægelsessensor. Sørg for at bevæge apparatet hen over huden under brug. Hvis du holder det stille samme sted i længere tid, stopper det. Når bevægelsen genoptages, begynder apparatet at arbejde igen.
4. Undgå gentagne bevægelser på samme område i lang tid, og hold ikke massageapparatet stille på ét område. Smertetærskel og hudfølsomhed varierer fra person til person: at holde apparatet stille kan medføre lette forbrændinger. Bliv ikke på samme sted i mere end 2-3 sekunder under brug.
5. Hudens følsomhed og apparatets effekt er individuelle og varierer efter person og behandlingsområde.

**EMS-TILSTAND:**
1. Påfør ledende kontaktgel eller et vandbaseret plejeprodukt med geltekstur på huden; det giver bedre strømledning og maksimale resultater.
2. Montér hovedet til den tilstand, du vil bruge.
3. Tænd apparatet, og vælg det laveste EMS-intensitetsniveau ved første anvendelse.
4. Massér taljen ved at føre apparatet langs siderne fra yderkanten mod midten i 5 minutter.
5. Massér benene ved at føre apparatet opad over lår/underben i 5 minutter.
6. Massér armene ved at føre apparatet over overarmen fra albuen mod skulderleddet i 5 minutter.
7. Massér maven ved at føre apparatet i zigzag oppefra og ned i 5 minutter, og undgå navleområdet.
8. Sørg under massagen for tilstrækkeligt tryk til, at hele elektrodefladen har kontakt med huden.
9. Sluk apparatet efter behandlingen, og fjern og rengør hovedet. Lad kontaktgelen eller plejeproduktet blive på huden, indtil det er helt optaget, og rens derefter huden.

**RF-TILSTAND:**
1. Påfør ledende kontaktgel eller et vandbaseret plejeprodukt med geltekstur på huden; det giver bedre strømledning og maksimale resultater.
2. Montér hovedet til den tilstand, du vil bruge.
3. Tænd apparatet, og vælg det laveste RF&LED-intensitetsniveau ved første anvendelse.
4. Vælg behandlingsområde, og udfør massagebevægelserne nedenfor. RF-funktionen opvarmer huden for at stimulere kollagenregenerering og underhudsfedtets stofskifte. Hvis varmen føles utilstrækkelig, skal du sænke glidehastigheden; hvis den er for høj, skal du øge hastigheden, indtil temperaturen føles behagelig.
5. Før apparatet med glidende bevægelser i hudens strukturretning i 5 minutter.
6. Glid vandret i 5 minutter.
7. Bevæg apparatet i cirkler med uret i 5 minutter.
8. Gentag cirkelbevægelserne mod uret i 5 minutter.

9. Sluk apparatet efter behandlingen, og fjern og rengør hovedet. Lad kontaktgelen eller plejeproduktet blive på huden, indtil det er helt optaget, og rens derefter huden.

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| HÆVELSE / NEDSAT LYMFESTRØM / MUSKELSVAGHED | Morgen | EMS: Mave og talje - 10-15 min; lår og balder - 15-20 min. Samlet behandling: op til 40 min. Start på laveste intensitet, og øg gradvist efter komfort og hudens tilstand. Muskelsammentrækninger skal kunne mærkes uden smerte. | Indledende forløb: 3-4 gange om ugen i 6-8 uger. Vedligeholdelse: 1-2 gange om ugen. | Indledende forløb: 6-8 uger. Hold derefter 1-2 måneders pause, så huden kan komme sig og undgå tilvænning til konstant stimulering. Vedligeholdelse: løbende. |
| OPSTRAMNING AF HUDEN / UDGLATNING AF STRÆKMÆRKER | Aften | RF & LED: Mave og talje - 10-15 min; lår og balder - 15-20 min. Samlet behandling: op til 40 min. Øg RF-intensiteten inden for behagelige grænser. Huden skal føles varm uden overophedning. | Indledende forløb: 2-3 gange om ugen i 6-8 uger. Vedligeholdelse: én gang om ugen; én gang hver 10-14. dag er også tilladt. | |
| KOMBINERET BEHANDLING | EMS om morgenen og RF & LED om aftenen eller en kombineret behandling om eftermiddagen | EMS + RF & LED. Mave og talje: EMS 10-15 min, RF & LED 10-15 min. Lår: EMS 10-15 min pr. ben, RF & LED 15-20 min pr. ben. Balder: EMS 15 min, RF & LED 15 min. Ved en kombineret behandling bruges forskellige tilstande på forskellige områder: EMS til lår/balder og RF & LED til mave/talje. | EMS: 3 gange om ugen. RF & LED: to gange om ugen. | |



**KONTRAINDIKATIONER:**

1. Apparatet må ikke bruges af:
• personer med arytmi eller andre hjertesygdomme samt personer med pacemaker.
personer med permanente metalimplantater eller piercinger i behandlingsområdet.
• allergikere samt personer med diabetes, lupus erythematosus, porfyri, kongestiv hjertesygdom, blodstørkningsforstyrrelser eller autoimmune sygdomme (f.eks. hiv eller aids).
• personer med uafklarede hudforandringer.
• personer i strålebehandling eller kemoterapi. Apparatet er egnet til strækmærker efter overvægt eller graviditet. Det bruges dog ikke til behandling af ar.
Personer, hvis hud aktuelt eller for nylig er behandlet med alfahydroxysyrer (AHA), betahydroxysyrer (BHA), lokal isotretinoin eller azelainsyre.
Personer, som har taget nogen form for Roaccutan inden for de sidste 6 måneder.
Personer, som tager lysfølsomhedsfremkaldende medicin eller anden lægeordineret medicin. Læs indlægssedlen til din medicin, før du bruger massageapparatet. Brug ikke apparatet, hvis indlægssedlen angiver, at medicinen kan give fotoallergiske eller fototoksiske reaktioner, eller at sollys skal undgås.
Personer, som tager blodfortyndende medicin, herunder høje doser aspirin. Det anbefales først at bruge massageapparatet en uge efter afsluttet behandling.
2. Brug ikke apparatet i ansigtet, på hals, bryst eller kønsorganer eller på kropsområder, som er blevet plastikkirurgisk behandlet inden for de sidste 3 måneder.
3. Brug ikke apparatet i LED-terapitilstand, hvis huden er lysfølsom eller tilbøjelig til udslæt og allergiske reaktioner.
4. Brug ikke LED-terapi ved infektioner, eksem, forbrændinger, betændte hårsække, åbne sår, blå mærker, herpes simplex, hudskader eller hæmatomer i behandlingsområdet.
5. Ret ikke apparatet mod øjnene, og se ikke ind i lyskilden.
6. Forsøg ikke at skille apparatet ad, reparere eller ændre det. Brug det ikke til andre formål end dem, der er angivet i denne brugsanvisning.

**ADVARSLER:**

1. Opbevares utilgængeligt for børn.
2. Brug apparatet forsigtigt i overensstemmelse med disse anbefalinger. Manglende overholdelse af vejledningen kan have uønskede følger.
3. Brug ikke apparatet med brandfarlige kosmetiske produkter.
4. Brug ikke apparatet omkring øjnene.
5. Kontrollér apparatet for skader før brug. Brug ikke massageapparatet, hvis det fungerer forkert, er defekt eller beskadiget.
6. Udfør en følsomhedstest 24 timer før første brug. Påfør lidt kontaktgel på indersiden af underarmen for at sikre, at hverken plejeproduktet eller massageapparatet giver en hudreaktion.

7. Hold USB-C-ladekablet og opladerstikket tørre. Brug ikke apparatet under opladning.
8. Vælg kontaktgel eller plejeprodukt med omhu; olier og syrer i kosmetikken kan beskadige apparatets belægning.
9. Rådfør dig med en læge før brug, og stop ved ubehag eller bivirkninger, hvis du har allergier, hudsygdomme, dermatitis osv.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) apparatkabinet, (2) EMS-hoved, (3) RF&LED-hoved,
4. ladekabel, 5) opbevaringspose, 6) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** 60 min

**SMART TIMER:** 5 min

**STRØM:** RF+LED: • Intensitet 1: 975 ± 50 mA • Intensitet 2: 990 ± 50 mA • Intensitet 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Intensitet 1: 30 ± 10 mA • Intensitet 2: 41 ± 10 mA • Intensitet 3: 52 ± 10 mA. FREKVENS: • RF-tilstand 2M Hz ± 0.2M Hz • EMS-tilstand (med variabel frekvenscyklus) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

**BØLGEFORM:** rektangulær bølgeform

**VANDBESTANDIGHED:** IPX6




# LED HAND MASK - FOTOTERAPIMASKE TIL HÆNDERNE

4 lysspektre

Udglatter rynker

Reducerer pigmentering

Balancerer hudens fedtindhold

Forbedrer fastheden

**PROBLEMOMRÅDER:** aldersforandringer i hændernes hud, tab af elasticitet og slap hud, aldersbetinget pigmentering og problemhud (akne, betændelse).

**MATERIALER:** silikone, ABS-plast.

**VÆGT:** 326 g.

**FUNKTIONER:**

Fototerapi (LED) er en metode, hvor lysbølger med forskellige bølgelængder trænger ned til en bestemt dybde i huden og optages af cellerne, hvilket sætter naturlige regenereringsprocesser i gang.

Rødt LED-lys (630 nm) - stimulerer metaboliske processer i celler, fremmer dyb restitution, forbedrer hudens tekstur og lysner pigmentpletter.

Blåt LED-lys (415 nm): normaliserer balancen i fedtet hud, fremmer omhyggelig rensning og beroliger den.

Nær infrarød (NIR) (830 nm): trænger ind i dybe vævslag, accelererer cellefornyelsen, øger elasticiteten og opstrammer hændernes hud.

Blandet (Rød + Blå) (630 + 415 nm): kombinerer kraften fra de to spektre for kraftfulde anti-aging, rensende og genoprettede effekter.

**EGENSKABER:**
1. Automatisk og manuel styring: brug en færdig automatisk cyklus på 15 minutter, hvor farverne skifter af sig selv, eller vælg 1 målrettet manuel tilstand med 1 lys i 10 minutter.
2. Smart timer: apparatet slukker automatisk efter behandlingen (15 minutter automatisk, 10 minutter manuelt), hvilket sikrer sikker brug.
3. 106 LED'er giver kraftig og ensartet dækning af hele hændernes, underarmenes og håndleddenes overflade.
4. Ergonomi og sikkerhed: masken er lavet af fødevaregodkendt silikone og fastgøres nemt på hånden med behagelige velcrostropper.
5. Trådløs styring: batteriet på 1500 mAh giver op til 40 minutters uafbrudt pleje uden tilslutning til stikkontakten.
6. Det nærinfrarøde spektrum (NIR) sætter foryngelsesprocesser i gang i de dybeste lag af dermis, som almindelig kosmetik og standardfototerapi ikke når.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Montér stropperne på masken: før højre og venstre strop gennem de tilsvarende huller på maskens sider, og fastgør dem med velcro.
2. Læg masken på hånden, og fastgør venstre strop oven på højre.
3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen. Masken tændes automatisk manuelt i rødt LED-lys.
4. Vælg den ønskede tilstand med tilstandsknappen (AUTO/MANUAL):
Automatisk eller manuel. LED'en A eller M lyser ud for den valgte tilstand.
5. Manuel tilstand (M): vælg lys med korte tryk på tænd/sluk-knappen (1 rødt, 2 blåt, 3 nærinfrarødt, 4 blandet). Den smarte timer løber i 10 minutter.
6. Automatisk tilstand (A): tilstandene skifter selv: 5 minutter rødt, 4 minutter blåt, 3 minutter nærinfrarødt og 3 minutter blandet. Den samlede behandlingstid er 15 minutter.
7. Hold tænd/sluk-knappen inde for at slukke apparatet manuelt.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Følsomhedstest Vigtigt: udfør en følsomhedstest før første behandling. Læg apparatet på indersiden af underarmen. Tænd masken, og gennemfør mindst 10 minutter. Stop straks ved varme eller ubehag. Vent mindst 6 timer efter testen. Hvis huden er rød og/eller klør, er apparatet ikke egnet til dig.
2. Rens huden på hånden efter følsomhedstesten; påfør ikke plejeprodukter.
3. Læg masken på hånden, og fastgør stropperne.
4. Vælg automatisk eller manuel tilstand, og udfør behandlingen.
5. Det anbefales ikke at overskride timerens brugstid.
6. Påfør gerne pleje- og fugtprodukter efter behandlingen for at fastholde resultatet.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**
For en synlig effekt anbefales LED HAND MASK i mindst 4 uger. Uge 1: hver 3. dag i 10-15 minutter. Uge 2 og 3: hver 2. dag i 10-15 minutter. Uge 4: dagligt i 10-15 minutter.

Protokol „Dyb anti-age og løft"

| TILSTAND | FASE | TID | LYS | RATIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL | 1. behandling | 10 min | Nærinfrarødt lys (NIR) | Opvarmer væv dybt, accelererer cellulært stofskifte og forbereder dermis til fornyelse. |
| | 2. behandling | 10 min | Rødt LED lys. | Stimulerer kollagenproduktionen kraftigt |

Skift mellem de efterfølgende behandlinger i overensstemmelse med LED HAND MASKs brugshyppighed og -varighed.



Protokol for detox og antibakteriel pleje

| TILSTAND | FASE | TID | LYS | RATIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL | 1. behandling | 10 min | Blåt LED lys. | Ødelægger bakteriemiljøet, normaliserer fedtindholdet og beroliger irriterede områder |
| | 2. behandling | 10 min | Blandet lys | Stimulerer kollagenproduktionen kraftigt |

Skift mellem de efterfølgende behandlinger i overensstemmelse med LED HAND MASKs brugshyppighed og -varighed.

Universel foryngelsesprotokol. Brug automatisk tilstand uden yderligere indstillinger: den fører huden gennem alle trin fra kollagenproduktion til dyb infrarød stimulation.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget lysfølsomhed: apparatet må ikke bruges ved sygdomme, som giver overfølsomhed for lys (f.eks. lupus erythematosus eller fotodermatose).
2. Medicin og kosmetik: brug ikke masken, hvis du tager medicin eller påfører produkter, som øger lysfølsomheden (retinoider, visse antibiotika, æteriske citrusolier).
3. Hudskader: masken må ikke bruges på åbne sår, hudsår, dybe revner, friske operationssyninger eller ved tegn på kraftig betændelse.
4. Graviditet og amning: masken må i disse perioder kun bruges efter obligatorisk samråd med en læge.
5. Intolerans over for behandlingen: apparatet er ikke egnet til dig, hvis huden bliver rød eller begynder at klø efter den obligatoriske test på underarmen.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Obligatorisk test: udfør altid en følsomhedstest på indersiden af underarmen før første brug.
2. Forværring af helbredet: stop straks, hvis du oplever varme, ubehag eller generel forværring under behandlingen.
3. Beskyttelse af synet: se ikke direkte på de tændte LED'er, mens apparatet arbejder.
4. Elsikkerhed: masken må under ingen omstændigheder bruges under opladning. Afbryd strømkablet, før behandlingen begynder.
5. Fugtbeskyttelse: apparatet er ikke vandtæt. Det må ikke bruges på badeværelset eller nær vand, berøres med våde hænder, nedsænkes i vand eller vaskes under rindende vand.
6. Forsigtig håndtering: bøj ikke masken for meget, klem den ikke, og læg ikke tunge genstande ovenpå; det kan beskadige de fleksible interne kredsløb og LED'erne.
7. Temperatur: brug eller opbevar ikke masken ved varmeapparater, åben ild, i direkte sollys eller i en bil i varmt vejr
8. Rengøring: masken må kun rengøres, når den er helt slukket og afbrudt fra elnettet.
9. Reparation og ændring: brug ikke en beskadiget maske, og skil ikke selv apparatet ad eller ændr det - det kan give elektrisk stød og ophæver garantien.

10. Formål: brug kun masken til det tilsigtede formål og efter vejledningen.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) maske, (2) fastgørelsesstropper, (3) Dual Type-C-ladekabel, 4. brugsanvisning, (5) opbevaringsposer.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**
**MÅL (H×B×D):** 385x185x52 mm. STRØMKILDE: lithium-ion-batteri. DRIFTSSPÆNDING: 3.7 V. EFFEKT: 5 W. BATTERIKAPACITET: 1500 mAh. FORSYNINGSSPÆNDING: 5 V. SMART TIMER: 15 minutter (automatisk), 10 minutter (manuel). OPLADNINGSTID: 1.5 timer. MAKSIMAL UAFBRUDT DRIFTSTID: 40 minutter. ANTAL LED'ER: 106 lamper.
**BØLGELÆNGDER:**
• rødt - 630 nm
• blåt - 415 nm
Nærinfrarødt (NIR) - 830 nm
• blandet (rødt + blåt) - 630 + 415 nm
**LYSINTENSITET:**
• rødt: 4.9 mW/cm2
• blåt - 28 mW/cm2
Nærinfrarødt (NIR) - 10.1 mW/cm2
• blandet (rødt + blåt) - 15 mW/cm2



# LED MASK - FOTOTERAPIMASKE TIL HJEMMEBRUG

Reducerer pigmentering

Forbedrer hudens udseende

Forbedrer hudens fasthed

Udglatter rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** hudens aldringstegn, fotoaldring, pigmentering og hyperpigmentering, akne, eftervirkninger af akne, couperose, rosacea og andre karforandringer.

**MATERIALER:** ABS-plast, silikone.

**VÆGT:** 215 g.

**FUNKTIONER:**

Rødt LED-lys - Dette lys trænger dybere ind i huden end de andre farver i det synlige spektrum. Det virker på fibroblaster (celler, der syntetiserer kollagen), og fremmer derved hudforyngelse og bekæmper ældningstegn.

Blåt LED-lys har den laveste indtrængningsdybde og fungerer på niveau med epidermis. Porphyriner (pigmenter i den menneskelige krop) er i stand til at absorbere blåt LED-lys og frigive singlet-iltmolekyler, der dræber acnebakterier, der lever på overfladen af huden. Således desinficerer blåt LED-lys, reducerer inflammatoriske formationer, bekæmper acne.

Gult LED-lys - trænger ind i huden dybt nok til at fremme produktionen af kollagen, på grund af hvilket det udglatter rynker. Under påvirkning af gult LED-lys på cellulære processer aktiveres lymfekar, dræning og lymfestrøm forbedres. Således aftager hævelsen, toksiner fjernes fra kroppen. Derudover har gult LED-lys en beroligende og anti-inflammatorisk effekt på huden.

Blandet lys - kombinationen af røde og blå farver giver dig mulighed for at kombinere deres funktionalitet, så blandet lys anses for at være det mest effektive, når du arbejder med betændelse: acne og postacne. Blåt LED-lys på grund af mere overfladisk penetrering bekæmper hudsygdomme forbundet med det øverste ydre lag af huden - epidermis. Til gengæld har rødt LED-lys en væsentlig effekt på produktionen af talg, som i kombination giver høj effektivitet i kampen mod hudsygdomme.

**EGENSKABER:**
1. Masken har justerbare fastgørelsesstropper.
2. Indbyggede øjenbeskyttere forhindrer direkte lys i øjnene.

3. Masken af fødevaregodkendt silikone er sikker at bruge.
4. Den kompakte fjernbetjening gør masken transportabel under brug.
5. Automatisk og manuel styring.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Udfør en „følsomhedstest" efter vejledningen før første brug af masken.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 1 sekund for at tænde masken. Efter tænding aktiveres den røde LED-lysfunktion og manuel styring. Ved siden af omskifterknappen lyser en indikator med bogstavet M (Manuel - manuel kontroltilstand).
3. Hvis masken skal oplades, skal du læse afsnittet om opladning og bemærke, at masken ikke virker under opladning.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen igen, masken skifter til blå LED-lystilstand.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for tredje gang, den gule LED-lystilstand starter.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen for fjerde gang for at aktivere blandet fototerapi.
7. Tryk på tilstandsknappen for at skifte masken til automatisk tilstand (Auto - automatisk lysskift).
8. I automatisk tilstand er 5 minutter den røde LED-lystilstand, 3 minutter blå LED-lys, 4 minutter gul LED-lys og derefter 3 minutter blandet.
9. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke masken.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens huden, før du tager masken på.
2. Tag masken på, og sørg for, at øjenbeskytterne slutter tæt omkring øjnene.
3. Vælg manuel eller automatisk styring efter ønske.
4. Vælg den ønskede LED-lysfarve i manuel tilstand.
5. Bemærk, at den smarte timer på 10 minutter starter forfra, når du skifter tilstand ved manuel styring. Det anbefales dog kraftigt ikke at bruge masken i mere end 15 minutter.
6. Nyd fototerapibehandlingen derhjemme.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGS-FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| AKNE / BETÆNDELSE | Aften | Blåt LED-lys: 7 min. Rødt LED-lys: 3 min. Gult LED-lys: 5 min. | Hver anden dag | Løbende |
| FINE LINJER / ALDERSRELATEREDE FORANDRINGER | Aften | Blåt LED-lys: 2 min. Rødt LED-lys: 7 min. Blandet lys: 5 min. | 2-3 gange om ugen | Løbende |
| SYNLIGE BLODKAR / COUPEROSE / FØLSOM HUD | Aften | Blåt LED-lys: 2 min. Rødt LED-lys: 2 min. Gult LED-lys: 2 min. Blandet lys: 5 min. | 2-3 gange om ugen | Løbende |
| PIGMENTERING / UJÆVN HUDTONE | Aften | Rødt LED-lys: 6 min. Gult LED-lys: 4 min. Blandet lys: 5 min. | 2-3 gange om ugen | Løbende |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Stop brugen ved ubehag eller bivirkninger.

**ADVARSLER:**
1. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
2. Brug ikke masken under opladning.
3. Lad ikke vand trænge ind på overfladen eller i apparatets kabinet.
4. Brug ikke apparatet nær en åben varmekilde.
5. Afbryd strømmen under rengøring og vedligeholdelse.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) ansigtsmaske, (2) betjeningspanel, (3) DC-USB-ladekabel, 4. fastgørelsesstropper, (5) øjenbeskyttere, (6) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3-4 h

**DRIFTSTID:** 40-45 min

**SMART TIMER:** 15 minutter (automatisk tilstand), 10 minutter (manuel tilstand)

**MODES:**
- Rødt LED-lys - bølgelængde på 630 nm
- Blåt LED-lys - bølgelængde 490 nm
- Gult LED-lys - bølgelængde på 590 nm
- blandet lys

**SPECIFIK EFFEKT (BESTRÅLINGSSTYRKE):**
- rødt LED-lys: 2,4041 mW/cm2
- blåt LED-lys - 8,6094 mW/cm2

Gult LED-lys - 1,2704 mW/cm2
- blandet lys - 7.4833 mW/cm2

**ENERGIDOSE (ENERGITÆTHED) VED EN BEHANDLING PÅ 15 MINUTTER:**
- rødt LED-lys - 2,1637 J/cm2
- blåt LED-lys - 7,7485 J/cm2
- gult LED-lys - 1,1434 J/cm2
- blandet lys - 6.7350 J/cm2

**VANDBESTANDIGHED:** IP22




# LED MASK 2.0 - FORYNGENDE FOTOTERAPI-MASKE

Reducerer pigmentering

Forbedrer hudens udseende

Forbedrer hudens fasthed

Udglatter rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** synlige aldringstegn, fotoaldring, pigmentering og hyperpigmentering, akne, eftervirkninger af akne, couperose, rosacea og andre karforandringer.

**MATERIALER:** silikone, ABS-plast.

**VÆGT:** 380 g.

**FUNKTIONER:**
LED MASK bygger på LED-lysterapi. Masken har indbyggede LED-lamper, som hver er programmeret til at udsende en bestemt farve. Hver farve svarer til en bestemt bølgelængde i det synlige lysspektrum. Lyset påvirker huden i forskellige dybder og optages af hudens receptorer, aktiverer naturlige processer i cellerne og fremkalder en bestemt hudreaktion.

Rødt LED-lys, der har den største bølgelængde, rødt LED-lys trænger dybere ind i huden end alle de viste lys. Det virker på fibroblaster, som stimulerer produktionen af kollagen og derved regenerering af huden. Som et resultat af terapi med rødt LED-lys fremskyndes sårheling, huden opstrammes, ydre tegn på hudens aldring, såsom rynker, aftager.

Blåt LED-lys har den korteste bølgelængde af alle farverne i det synlige spektrum. Det virker på niveauet af epidermis og har en antimikrobiel virkning. Porphyriner (pigmenter i vores krop) er i stand til at absorbere blåt LED-lys og frigive singlet-iltmolekyler, der dræber acnebakterier, der lever på overfladen af huden. Således desinficerer blåt LED-lys, reducerer inflammatoriske formationer, bekæmper acne.

Grønt LED-lys absorberes af epidermis og dermis, hvilket forårsager en cellulær reaktion, som blandt konsekvenserne har restaurering og heling af huden. Det bruges til at reducere rødme, lindre irritation af følsom hud. Grønt LED-lys bekæmper couperosis, reducerer størrelsen af kapillærerne og bidrager til den frie strøm af blod.

Gult LED-lys (rødt + grønt) bruges til at stimulere blodcirkulationen, hjælper med at lette hudtonen, reducere sværhedsgraden af pigmentering.

Blandet lys (rødt + blåt + grønt = hvidt) bruges til hurtig og dyb indtrængning af kosmetik. Det har desuden en generelt afslappende og beroligende effekt på kroppen.

**EGENSKABER:**
1. Indbygget fastgørelse uden stropper.
2. Betjeningspanel med LCD-display.
3. Flere LED'er - 117 stk.
4. 3 intensitetsniveauer for hver lystilstand og høj energitæthed.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Udfør en „følsomhedstest" efter vejledningen før første brug af masken.
2. Tilslut masken til betjeningspanelet med Type C-kablet, til det klikker på plads.
3. Tryk og hold tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet nede i 2 sekunder for at tænde enheden, vent på lydsignalet. Masken tændes automatisk i rød LED-lystilstand ved det første intensitetsniveau.
4. Et kort tryk (1 sekund) på omskiftningsknapperne (↑/↓) vil tillade dig at skifte til blå LED-lystilstand (indikator C: B på kontrolpanelet), grøn LED-lystilstand (indikator C: G), gul LED-lystilstand (indikator C: RG), hvid lystilstand (indikator C: RGB).
5. Et kort tryk (1 sekund) på knapperne til lysintensitet (-/+) øger niveauet til 3 eller vender tilbage til niveau 1.
6. Et kort tryk (1 sekund) på pauseknappen sætter apparatet på pause; tryk igen for at fortsætte.
7. Hold tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet inde i 2 sekunder for at slukke apparatet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Vask og tør hænder og ansigt.
2. Sæt masken på ansigtet, og fastgør velcrobåndene, så den sidder behageligt.
3. Tænd masken ved at tilslutte betjeningspanelet.
4. Vælg den ønskede lystilstand og intensitet.
5. Nyd fototerapibehandlingen.
6. Hver lystilstand arbejder i 15 minutter, hvorefter fjernbetjeningen slukker automatisk. Timeren starter forfra ved tilstandsskift. Sørg under fototerapien omhyggeligt for, at den samlede behandlingstid ikke overstiger 15 minutter, når flere tilstande bruges i samme behandling.
7. Brug serum eller creme efter LED-lysterapien, da huden optager plejeprodukter bedre efter brug af LED-masken.



**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| AKNE / BETÆNDELSE | Aften | Uge 1: blåt, lav - 4 min; rødt, lav - 3 min; grønt, mellem - 6 min. Uge 2: blåt, mellem - 4 min; rødt, lav - 4 min; grønt, mellem - 6 min. Uge 3: blåt, høj - 5 min; rødt, høj - 3 min; grønt, høj - 6 min. Uge 4: pause. | Hver anden dag | 1 måned inklusive pausen. Hold 1 uges pause. Gentag programmet i 2-3 måneder. |
| FINE LINJER / ALDERSRELATEREDE FORANDRINGER | Aften | Uge 1: rødt, mellem - 5 min; grønt, høj - 5 min; blandet, høj - 2 min. Uge 2: rødt, høj - 5 min; grønt, høj - 7 min; blandet, høj - 2 min. Skift mellem uge 1 og 2. | 2-3 gange om ugen | Ingen fast grænse for forløbets varighed |
| SYNLIGE BLODKAR / COUPEROSE / FØLSOM HUD | Aften | Uge 1: rødt, lav - 3 min; grønt, mellem - 5 min; blandet, mellem - 5 min. Uge 2: rødt, mellem - 5 min; grønt, høj - 2 min; blandet, høj - 5 min. Uge 3: rødt, høj - 5 min; grønt, høj - 5 min; blandet, høj - 3 min. Uge 4: pause. | Hver anden dag | 1 måned inklusive pausen. Hold 1 uges pause. To forløb på 4 uger og derefter 1 måneds pause. |
| PIGMENTERING / UJÆVN HUDTONE | Aften | Rødt: høj ved mørk pigmentering, mellem ved normal pigmentering - 6 min. Grønt, høj - 4 min. Blandet, mellem - 5 min. | 2-3 gange om ugen | Løbende |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Apparatet må ikke bruges af personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelsygdom eller medicinsk behandling af skjoldbruskkirtlen.
2. Masken må ikke bruges på beskadiget eller skadet hud eller operationssår.

**ADVARSLER:**
1. Den foryngende fototerapimaske er et apparat til hjemmebrug. Den må kun bruges efter vejledningen. Masken må ikke bruges til andre formål, da det kan beskadige produktet eller skade kroppen.
2. Stop brugen, hvis masken er beskadiget, og kontakt den organisation, der er bemyndiget til at modtage forbrugerklager, for at undgå fare.
3. Masken må ikke bruges under opladning. Berør ikke maske, ladekabel eller USB-adapter med våde hænder under opladning.
4. Stop straks ved ubehag eller en uønsket reaktion (rødme, kløe, allergi) efter brug af masken.

**PAKKENS INDHOLD:** 1) maske, 2) Type C-Type C-kabel til betjeningspanelet,
3. fjernbetjening, 4) USB-C-ladekabel, 5) vejledning, 6) opbevaringspose.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3-4 h

**DRIFTSTID:** 140 minutter (rød/blå/grøn) • 80 minutter (blandet lys) • 78 minutter (gult LED-lys)

**SMART TIMER:** 15 min

**MODES:**
• Rødt LED-lys - bølgelængde på 660 nm
• Blåt LED-lys - bølgelængde 460 nm
• Grønt LED-lys - bølgelængde på 525 nm
• Gul LED-lys - rød + grøn
• blandet lys (hvidt) - rødt + blåt + grønt

**SPECIFIK EFFEKT (BESTRÅLINGSSTYRKE):**
Niveau 1
• rødt LED-lys - 6.595 mW/cm2
• blåt LED-lys - 17.112 mW/cm2
• grønt LED-lys - 6.612 mW/cm2
Gult LED-lys - 14.049 mW/cm2
• blandet lys - 27.542 mW/cm2 niveau 2
• rødt LED-lys - 14.058 mW/cm2
• blåt LED-lys - 30,48 mW/cm2
• grønt LED-lys - 15.636 mW/cm2
Gult LED-lys - 17.857 mW/cm2
• blandet lys - 32.169 mW/cm2



Niveau 3
• rødt LED-lys - 16.368 mW/cm2
• blåt LED-lys - 47.653 mW/cm2
• grønt LED-lys - 23.095 mW/cm2
Gult LED-lys - 28.081 mW/cm2
• blandet lys - 39.089 mW/cm2

**ENERGIDOSE (ENERGITÆTHED) VED EN BEHANDLING PÅ 15 MINUTTER:**
Niveau 1
• rødt LED-lys - 5,9355 J/cm2
• blåt LED-lys - 15.4008 J/cm2
• grønt LED-lys - 5,9508 J/cm2
• gult LED-lys - 12,6441 J/cm2
• blandet lys - 24.7878 J/cm2 niveau 2
• rødt LED-lys - 12,6522 J/cm2
• blåt LED-lys - 27.432 J/cm2
• grønt LED-lys - 14.0724 J/cm2
• gult LED-lys - 16.0713 J/cm2
• blandet lys - 28.9521 J/cm2 niveau 3
Rødt LED-lys - 14,7312 J/cm2
• blåt LED-lys - 42,8877 J/cm2
• grønt LED-lys - 20,7855 J/cm2
• gult LED-lys - 25,2729 J/cm2
• blandet lys - 35.1801 J/cm2

**VANDBESTANDIGHED:** IP22




# LED MASK 3.0 - TRÅDLØS FOTOTERAPIMASKE

7 lysspektre

Udglatter rynker

Reducerer pigmentering

Reducerer akne og mærker efter akne

Glød indefra

**PROBLEMOMRÅDER:** rynker, tab af elasticitet, akne og betændelse, hyperpigmentering, trist hudtone, hævelser, langsom regenerering og lav effekt af kosmetik.

**MATERIALER:** ABS-plast, silikone.

**VÆGT:** 265 g.

**FUNKTIONER:**
Fototerapi (LED) er en ikke-termisk metode, hvor lysbølger med forskellige bølgelængder trænger ned til en bestemt dybde i dermis og optages af cellernes fotoreceptorer, hvilket aktiverer naturlige regenereringsprocesser.

Rødt LED-lys (630 nm): trænger dybt ind i dermis og stimulerer kollagensyntesen. Som et resultat af terapi med rødt LED-lys accelereres sårheling, huden strammes, ydre tegn på hudens aldring, såsom rynker, falder.

Blåt LED-lys (415 nm): har en kraftig antibakteriel effekt, påvirker årsagerne til acne, desinficerer, reducerer betændelse og beroliger huden.

Grønt LED-lys (520 Nm): Justerer den overordnede hudtone. Det bruges til at reducere rødme, pigmentering, lindre irritationer af følsom hud. Grønt LED-lys bekæmper couperosis, reducerer størrelsen af kapillærerne og bidrager til den frie strøm af blod.

Gult LED-lys (630+520 nm): forbedrer mikrocirkulationen i væv, giver lymfedrænage, eliminerer stagnation og hævelse.

Hvidt lys (630+520+415 nm): accelererer cellulær metabolisme, fremmer den dybeste absorption af de aktive komponenter i kosmetik.

Nær infrarød (NIR, 830 nm): Fremskynder vævsregenerering på et dybt niveau, helbreder mikroskader og beroliger huden.

Dyb infrarød (DIR, 1070 nm): aktiverer cellernes indre energi, giver en udtalt effekt af at "lyse indefra."

**EGENSKABER:**
1. 7 farvespektre: maksimal farvedækning til en lang række æstetiske problemer med 1 apparat.
2. Dobbelt styringssystem: betjening via fjernbetjeningen eller direkte på masken giver bekvemmelighed i enhver situation.
3. Trådløs styring. Masken understøtter Bluetooth-forbindelse til fjernbetjeningen, så tilstande kan indstilles og styres på afstand uden kabel mellem maske og fjernbetjening. Det giver høj mobilitet og komfort under alle forhold.
4. Manuel indstilling. Skab personlige programmer: du bestemmer farvernes rækkefølge og hvert spektrums driftstid.
5. 3D-formen følger ansigtets anatomi og sikrer tæt pasform.
6. Smart timer: afslutter automatisk behandlingen efter 15 minutter for sikker og effektiv brug.
7. Stemmevejledning. Apparatet meddeler valgte tilstande og Bluetooth-forbindelse på 2 sprog (russisk og engelsk). Funktionen er valgfri og kan slås fra.
8. Hukommelsesfunktion: gemmer de seneste manuelle indstillinger og sparer tid ved regelmæssig brug.
9. 2 IR-lys til dyb indtrængning. LED MASK 3.0 har to infrarøde spektre (830 nm og 1070 nm). De sætter foryngelsesprocesser i gang i de dybeste lag af dermis, som almindelig kosmetik og standardfototerapi ikke når.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
LED MASK 3.0 har et dobbelt styringssystem:
1. Via den indbyggede betjeningsenhed på masken.
2. Via fjernbetjeningen.

Brug af den indbyggede betjeningsenhed Ved betjening direkte på masken kan den kun arbejde automatisk.



1. Hold knappen inde i 2 sekunder for at tænde eller slukke masken. Dette ledsages af et langt bip.
2. Tryk kort på knappen for at skifte maskens lys.
3. Hold knappen inde i 5 sekunder for at aktivere Bluetooth og oprette forbindelse til betjeningspanelet. Når masken er forbundet med fjernbetjeningen, lyser indikatoren på maskens betjeningsenhed blåt.



4. Tryk kort på knappen for at øge lysintensiteten.
5. Tryk på knappen for at vælge stemmesprog: engelsk eller russisk.



6. Tryk kort på knappen for at sænke lysintensiteten.
7. Tryk på knappen for at slå stemmen til eller fra.



For at bruge fjernbetjeningen skal du først tænde masken på dens betjeningsenhed, derefter tænde fjernbetjeningen og vente på forbindelsen. Når forbindelsen er oprettet, høres „Bluetooth is connected/Bluetooth is connected" (Bluetooth er tilsluttet).



1. Tænd masken med et langt tryk på knappen.
2. Et kort tryk på knappen vælger maskens styringstilstand:
Automatisk (1 lys bruges under hele behandlingen, og brugeren vælger selv farven) eller manuel (brugeren indstiller farveskiftene samt den ønskede farves varighed og intensitet).
3. Et langt tryk slukker masken.



4. Et kort tryk bekræfter de valgte indstillinger: intensitet og tid.
5. Et dobbelttryk efter alle indstillinger i manuel tilstand starter masken.
6. Et kort tryk under behandlingen sætter den på pause. Et nyt kort tryk fortsætter den afbrudte behandling. Skærmen blinker under pausen.
7. I manuel tilstand nulstiller et langt tryk efter skift til manuel styring de gemte indstillinger (de senest indstillede).



8. Et kort tryk på knappen går til det ønskede lys: ned-knappen går til næste lystype, og op-knappen går tilbage til indstillingerne for det foregående lys.



9. I manuel tilstand øger et kort tryk på plusknappen intensiteten og behandlingstiden, mens minusknappen reducerer dem.



10. I automatisk tilstand øger et kort tryk på plusknappen intensiteten, mens minusknappen sænker den.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens ansigtshuden før behandlingen: fjern makeup, og påfør ikke plejeprodukter.
2. Tænd masken på dens betjeningsenhed.
3. Sæt masken på ansigtet, så den slutter tæt.
4. Saml og fastgør velcrobåndene bagpå, så masken sidder behageligt.

Automatisk styring
5. Automatisk tilstand kan styres både direkte på masken og via betjeningspanelet.

Direkte styring på masken
6. Tænd den med et langt tryk på tænd/sluk-knappen på maskens betjeningsenhed.
7. Tryk kort på samme knap (tænd/sluk/tilstandsskift) for at vælge den ønskede lystype.
8. Indstil den ønskede lysintensitet med plus- og minusknapperne.

9. Behandlingen starter automatisk; starten skal ikke bekræftes.
10. Den smarte timer på 15 minutter afslutter selv programmet.

Indstilling via betjeningspanelet
11. Opret Bluetooth-forbindelse mellem masken og fjernbetjeningen. Tænd masken, tænd derefter betjeningspanelet, og vent på lydsignalet.
12. Betjeningspanelet starter i automatisk styring. Kontrollér, at bogstavet A vises nederst på skærmen.
13. Vælg det ønskede lys.
14. Justér intensiteten fra 1 til 3.
15. Masken starter automatisk og begynder den smarte timers nedtælling.
16. Efter 15 minutter slukker masken af sig selv.

Manuel styring
17. Aktivér masken på dens betjeningsenhed.
18. Manuel tilstand kan kun styres via betjeningspanelet, så det er vigtigt at oprette Bluetooth-forbindelse mellem maske og panel. Tænd masken, tænd derefter betjeningspanelet, og vent på lydsignalet.
19. Vælg manuel styring på betjeningspanelet. Bogstavet M lyser på skærmen.
20. Indstil den ønskede lyskombination samt intensitet og varighed.
21. Den første til at justere er et rødt LED-lys. Du kan starte opsætningen fra intensitetsniveauet. Intensitetsniveaubetegnelsen blinker på skærmen. Brug +/- knapperne til at vælge det ønskede niveau. Bekræft det ved at trykke på start/pause-knappen.
22. Vælg derefter driftstiden for dette lys. Brug +/- til at forlænge eller forkorte tiden. Bekræft ved at trykke på start/pause-knappen.
23. Indstil næste farve på samme måde (Blåt -> Gult -> Grønt -> Hvidt -> Nærinfrarødt -> Dyb infrarød).
24. Hvis du vil springe en farve over, skal du indstille dens tid til nul eller gå videre til næste lys med V/Λ-knapperne (farveskift).
25. Med Λ-knappen (farveskift) kan du gå tilbage til det foregående lys og justere lysstyrke og driftstid.
26. LED MASK 3.0 har hukommelsesfunktion i manuel styring. Hold start/pause-knappen inde efter aktivering af manuel indstilling på panelet for at nulstille den gemte lyskombination.
27. Påfør gerne pleje- og fugtprodukter efter fototerapien.



## BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| AKNE | Begyndere og følsom hud: blåt LED-lys om morgenen; rødt LED-lys om aftenen (en time før sengetid). Erfarne brugere og andre hudtyper: morgen eller dag. Blåt LED-lys undertrykker melatoninproduktionen og kan ændre søvnmønstre. | Begyndere og følsom hud: blåt LED-lys - 15 minutter på en dag; rødt LED-lys - 15 minutter hver anden dag. Gentag denne ændring. Erfarne brugere og andre hudtyper inden for 1 session: blåt LED-lys - 7 minutter; rødt LED-lys - 7 minutter. | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 4-6 uger Pause: 2 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| MÆRKER EFTER AKNE | Rødt LED lys - aften (en time før sengetid) Andre farver uanset tidspunkt på dagen | Ar: rødt LED-lys - 7 minutter; nær-infrarødt lys - 7 minutter. Røde pletter: gult LED-lys - 7 minutter; grønt LED-lys - 7 minutter. | Ar: 3 gange om ugen Røde pletter: 3 gange om ugen | Ar: behandlingsforløb - 12 uger; pause - 4-6 uger. Gentag kurset eller start et nyt kursus for en anden bekymring. Røde pletter: behandlingsforløb - 6-8 uger; pause - 4 uger. Gentag kurset eller start et nyt kursus for en anden bekymring. |
| UDVIDEDE PORER / FEDTET GLANS | Morgen/dag (fordi blåt LED-lys undertrykker melatoninproduktionen, kan ændre søvnmønstre) | Blåt - 7 minutter Rødt - 7 minutter | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 6-8 uger Pause: 3 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| PIGMENTERING | Uanset tidspunktet på dagen. | Gult LED-lys - 7 minutter Grønt LED-lys - 7 minutter | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8-12 uger Pause: 4-6 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| HUD FLAGER / FØLELSE AF STRAM HUD | Aften (en time før sengetid) | Rødt LED-lys - 5-7 minutter nær-infrarødt lys - 5-7 minutter | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 6 uger Pause: 4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes |
| ROSACEA | Rødt LED lys - aften (en time før sengetid) Andre farver uanset tidspunkt på dagen | Gult LED-lys - 15 minutter på en dag; rødt LED-lys - 10 minutter hver anden dag, plus nær-infrarødt lys - 5 minutter hver anden dag. Gentag denne ændring. | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8-12 uger Pause: 4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| KARSPRÆNGNINGER | Uanset tidspunktet på dagen. | Grønt LED-lys - 15 minutter | 2 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8-12 uger Pause: 4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| RYNKER | Aften (en time før sengetid) | Rødt LED-lys - 7 minutter nær-infrarødt lys - 7 minutter | 3 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8-12 uger Pause: 4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| TRIST HUDTONE | Rødt LED-lys - aften (en time før sengetid) Gult LED-lys uanset tidspunkt på dagen | Rødt LED-lys - 15 minutter (den ene dag). Gult LED-lys - 15 minutter (hver anden dag). Skift mellem disse behandlinger. | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 6-8 uger Pause: 3-4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| HÆVELSE | Uanset tidspunktet på dagen. | Gult LED-lys - 15 minutter | 3-4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8 uger Pause: 2-4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| MODEN HUD / TAB AF FASTHED OG SPÆNDSTIGHED / SLAP HUD | Aften (en time før sengetid) | 1 session 2 gange om ugen: rødt LED-lys - 7 minutter, nærinfrarødt lys - 7 minutter. 1 session 2 gange om ugen: dybt infrarødt lys - 15 minutter. Uge 1: session på 5 minutter. Uge 2: session på 10 minutter. Fra uge 3: session på 15 minutter. | 4 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 8-12 uger Pause: 4 uger Forløbet kan gentages, eller et nyt forløb mod et andet problem kan begyndes. |
| Niveau: Start på niveau 1 og brug det i 1 uge. Skift derefter til niveau 2 og brug det i 1.5 uger. Skift derefter til niveau 3. | | | | |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Brug ikke masken, hvis du har lupus erythematosus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Fototerapi kan i disse tilfælde give en alvorlig hudreaktion.
2. Masken må ikke bruges ved nogen form for lysfølsomhed.
3. Brug ikke masken, hvis du tager medicin, der øger lysfølsomheden, f.eks. visse antibiotika, kemoterapimidler eller vanddrivende medicin. Rådfør dig med lægen før brug.
4. Brug ikke masken, hvis du har sår, eller undgå det pågældende område under fototerapien.
5. Brug ikke masken, hvis du har været solskoldet inden for de sidste 2 uger.
6. Brug ikke masken ved Fitzpatrick-hudtype I, V eller VI.
7. Brug ikke masken, hvis du tidligere har haft lysudløst epilepsi.
8. Brug ikke ved svær akne.
9. Apparatet må ikke bruges af spædbørn eller personer med skjoldbruskkirtelsygdom eller medicinsk behandling af skjoldbruskkirtlen.



10. Brug ikke masken under opladning eller vedligeholdelse. Berør ikke maske, ladekabel eller USB-adapter med våde hænder under opladning.
11. Brug ikke en beskadiget maske. Kontakt den organisation, producenten har bemyndiget til at modtage forbrugerklager.

**ADVARSLER:**
1. Udfør en følsomhedstest, før masken bruges.
2. Sluk og tag masken af, hvis den virker varm, eller huden mærker ubehagelig varme.
3. Brug kun masken på renset hud: fjern makeup, og påfør ikke plejeprodukter før behandlingen. Nogle ingredienser kan give lysfølsomhed eller mindske behandlingens effekt.
4. Brug masken væk fra vand, og undgå vand på apparatet.
5. Læg ikke masken på varme overflader.
6. Forsøg ikke selv at ændre eller reparere apparatet. Det ophæver garantien og kan give elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, brugeren selv kan servicere.
7. Brug ikke masken, hvis selve apparatet, betjeningsenheden, ladestikket eller kablet er beskadiget.
8. Kontrollér før tilslutning, at spændingen svarer til den, der er angivet på apparatet.
9. Udsæt ikke udstyret for kraftige slag, da lamperne kan beskadiges.
10. Se ikke ind i lyskilden under brug for at beskytte øjnene.
11. Brug ikke masken under følgende forhold: i felter fra MR-scanning, diatermi, elektrokoagulation, trådløs energioverførsel, 5G eller andre systemer med elektromagnetiske sendere.
12. Undgå at bruge udstyret tæt ved eller stablet sammen med andet udstyr, da det kan give funktionsfejl. Hvis det er nødvendigt, skal begge apparater overvåges for korrekt funktion.
13. Brug originale omformere og kabler. Andet tilbehør end det, producenten angiver eller leverer, kan øge den elektromagnetiske udstråling eller sænke udstyrets immunitet og dermed medføre forkert funktion.
14. Brug ikke masken nærmere end 30 cm fra aktive radioapparater: Wi-Fi-routere, mobiltelefoner, babyalarmer og antenner. Kraftige radiosignaler kan give funktionsfejl eller reducere behandlingens effekt.
15. LED MASK 3.0 er en personlig hygiejneartikel og bør ikke deles med andre.
16. Stop brugen af en beskadiget maske, og kontakt den organisation, der er bemyndiget til at modtage forbrugerklager, for at undgå fare. Ved egen reparation, adskillelse eller forkert brug bortfalder denne organisations garantiforpligtelser.
17. Stop straks ved ubehag eller en uønsket reaktion (rødme, kløe, allergi) efter brug af masken.

**PAKKENS INDHOLD:** 1) maske, 2) Dual Type-C-ladekabel, 3) fjernbetjening, 4. brugsanvisning, (5) opbevaringsposer.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**EFFEKT:** 3 W

**BATTERIKAPACITET:** 850 mAh

**DRIFTSSPÆNDING:** 3,7 V

**FORSYNINGSSPÆNDING:** 5 V

**SMART TIMER:** 15 min

**OPLADNINGSTID:** 4 timer (maske), 45 minutter (fjernbetjening)

**DRIFTSTID:** • 64 minutter (tilstand med rødt LED-lys) • 60 minutter (tilstand med blåt LED-lys), • 55 minutter (tilstand med gul LED-lys), • 55 minutter (tilstand med grønt LED-lys), • 57 minutter (tilstand med hvidt lys), • 93 minutter (tilstand nær infrarød (NIR)), • 215 minutter (dyb infrarød) tilstand (DIR)

**MODES:**
• Rødt LED-lys - bølgelængde på 630 nm
• Blåt LED-lys - bølgelængde 415 nm
• Grønt LED-lys - bølgelængde på 520 nm
• Gul LED-lys - rød + grøn
• hvidt lys - rødt + blåt + grønt
Nærinfrarødt lys - 830 nm
Dybt infrarødt lys - 1070 nm

**SPECIFIK EFFEKT (BESTRÅLINGSSTYRKE):**
Niveau 1
• rødt LED-lys: 10,5 mW/cm2
• blåt LED-lys - 12,4 mW/cm2
• gult LED-lys - 10,4 mW/cm2
• grønt LED-lys - 8,4 mW/cm2
hvidt lys - 13.3 mW/cm2
• NIR - 7.76 mW/cm2
DIR - 3.14 mW/cm2 niveau 2
• rødt LED-lys - 14,4 mW/cm2
• blåt LED-lys - 18,5 mW/cm2
• gult LED-lys - 13,9 mW/cm2
• grønt LED-lys - 11,2 mW/cm2
hvidt lys - 16.9 mW/cm2
• NIR - 10.49 mW/cm2
DIR - 4.24 mW/cm2 niveau 3
• rødt LED-lys - 17,4 mW/cm2
• blåt LED-lys - 20,2 mW/cm2
• gult LED-lys - 17,6 mW/cm2
• grønt LED-lys - 14,6 mW/cm2



hvidt lys - 19.1 mW/cm2
• NIR - 17.1 mW/cm2
• DIR - 8.3 mW/cm2

**ENERGIDOSE (ENERGITÆTHED) VED EN BEHANDLING PÅ 15 MINUTTER:**
Niveau 1
• rødt LED-lys - 9,45 J/cm2
• blåt LED-lys - 11,16 J/cm2
• gult LED-lys - 9,36 J/cm2
• grønt LED-lys - 7,56 J/cm2
hvidt lys - 11.97 J/cm2
• NIR - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2 niveau 2
• rødt LED-lys - 12,96 J/cm2
• blåt LED-lys - 16,65 J/cm2
• gult LED-lys - 12,51 J/cm2
• grønt LED-lys - 10,08 J/cm2
hvidt lys - 15.21 J/cm2
• NIR - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2 niveau 3
• rødt LED-lys - 15,66 J/cm2
• blåt LED-lys - 18,18 J/cm2
• gult LED-lys - 15,84 J/cm2
• grønt LED-lys - 13,14 J/cm2
hvidt lys - 17.19 J/cm2
• NIR - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

**MÅL (H X B X D):** 255×580×121 mm




# LED NECK MASK 2.0 - LYSTERAPI TIL HALS OG DEKOLLETAGE

Forbedrer cirkulationen

Reducerer pigmentering

Udjævner hudtonen

Udglatter rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** pigmentering, akne, couperose, rosacea, akne, hudens aldringstegn, øget talgproduktion, udvidede porer samt trist og træt hud.

**MATERIALER:** silikone, ABS-plast.

**VÆGT:** 210 g.

**FUNKTIONER:**
LED NECK MASK bygger på LED-lysterapi. Masken har indbyggede LED-lamper, som hver er programmeret til at udsende en bestemt farve. Hver farve svarer til en bestemt bølgelængde i det synlige lysspektrum. Lyset påvirker huden i forskellige dybder og optages af hudens receptorer, aktiverer naturlige processer i cellerne og fremkalder en bestemt hudreaktion.

Rødt LED-lys - Dette lys trænger dybere ind i huden end de andre farver i det synlige spektrum. Det virker på fibroblaster (celler, der syntetiserer kollagen), og fremmer derved hudforyngelse og bekæmper ældningstegn.

Blåt LED-lys har den laveste indtrængningsdybde og fungerer på niveau med epidermis. Porphyriner (pigmenter i den menneskelige krop) er i stand til at absorbere blåt LED-lys og frigive singlet-iltmolekyler, der dræber acnebakterier, der lever på overfladen af huden. Således desinficerer blåt LED-lys, reducerer inflammatoriske formationer, bekæmper acne.

Grønt LED-lys absorberes af epidermis og dermis, hvilket forårsager en cellulær reaktion, som blandt konsekvenserne har restaurering og heling af huden. Det bruges til at reducere rødme, lindre irritation af følsom hud. Grønt LED-lys bekæmper couperosis, reducerer størrelsen af kapillærerne og bidrager til den frie strøm af blod.

Gult LED-lys (rødt + grønt) - bruges til at stimulere blodcirkulationen, hjælper med at lette hudtonen, reducere sværhedsgraden af pigmentering.

Blandet lys (rød + blå + grøn = hvid) - bruges til hurtig og dyb penetration af kosmetik. Derudover har den en generel afslappende og beroligende effekt på kroppen.

Nærinfrarødt lys - fremskynder dyb vævsregenerering, heler mikroskader og beroliger huden.

**EGENSKABER:**
1. Unik form til de sårbare områder på hals og dekolleté.
2. Enkel fastgørelse på begge sider af masken.
3. Ergonomisk betjeningspanel.
4. 3 intensitetsniveauer for hver lystilstand og høj energitæthed.
5. Masken af fødevaregodkendt silikone er sikker at bruge.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tilslut masken til betjeningspanelet med et Type C-kabel. Sæt kablet i stikket, til du hører det karakteristiske klik.
2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Masken tændes automatisk i rød LED-lystilstand ved det første intensitetsniveau (indikatorer C: R, L: 1 på kontrolpanelets display).
3. Et kort tryk (1 sekund) på skifteknapperne (↑/↓) giver dig mulighed for at skifte til blå LED-lystilstand (indikator C: B på kontrolpanelet), grøn LED-lystilstand (indikator C: G), gul LED-lystilstand (indikator C: RG), hvid lystilstand (indikator C: RGB), NIR-tilstand (indikator C: IR_).
4. Et kort tryk (1 sekund) på knapperne til lysintensitet (-/+) øger niveauet til 3 eller vender tilbage til niveau 1 (L-indikator: 1 (2/3) på betjeningspanelet).
5. Et kort tryk (1 sekund) på pauseknappen sætter apparatet på pause; tryk igen for at fortsætte.
6. Hold tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet inde i 2 sekunder for at slukke apparatet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
Udfør en følsomhedstest før første brug:
Læg masken på indersiden af hånden.
Tænd masken, og gennemfør en fuld fototerapibehandling på 15 minutter.
Stop straks brugen ved ubehag eller en brændende fornemmelse i huden.
• Vent ca. 6 timer efter testen. Hvis huden på indersiden af hånden er rød og/eller klør, er LED NECK MASK ikke egnet til dig.
1. Tilslut fjernbetjeningen til masken.
2. Læg masken omkring halsen.
3. Tænd masken, og vælg den ønskede lystilstand og intensitet.
4. Nyd fototerapibehandlingen. Hver lystilstand arbejder i 15 minutter, hvorefter fjernbetjeningen slukker automatisk. Timeren starter forfra ved tilstandsskift. Sørg under fototerapien omhyggeligt for, at den samlede behandlingstid ikke overstiger 15 minutter, når flere tilstande bruges i samme behandling.
5. Brug serum eller creme efter LED-lysterapien, da huden optager plejeprodukter bedre efter brug af LED-masken.
6. Brug masken regelmæssigt 3-4 gange om ugen i mindst 4 uger for synlige resultater.
7. Når den ønskede effekt er nået, kan du udføre 1-2 behandlinger om ugen.



**KONTRAINDIKATIONER:**
1. LED-fototerapimasken til hals og dekolleté er til hjemmebrug. Brug den kun som beskrevet i denne vejledning. Brug til andre formål kan beskadige produktet eller skade kroppen.
2. Stop brugen af en beskadiget maske, og kontakt den organisation, der er bemyndiget til at modtage forbrugerklager, for at undgå fare. Ved egen reparation, adskillelse eller forkert brug bortfalder denne organisations garantiforpligtelser.
3. Masken må ikke bruges under opladning. Berør ikke maske, ladekabel eller USB-adapter med våde hænder under opladning.
4. Stop straks ved ubehag eller en uønsket reaktion (rødme, kløe, allergi) efter brug af masken.
5. Apparatet må ikke bruges af personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelsygdom eller medicinsk behandling af skjoldbruskkirtlen.
6. Masken må ikke bruges på beskadiget eller skadet hud eller operationssår.

**ADVARSLER:**
1. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
2. Brug ikke masken under opladning.
3. Lad ikke vand trænge ind på overfladen eller i apparatets kabinet.
4. Brug ikke apparatet nær en åben varmekilde.
5. Afbryd strømmen under rengøring og vedligeholdelse.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) fototerapimaske, (2) betjeningspanel, (3) Type C-kabel mellem panel og maske, (4) USB-Type C-ladekabel, (5) opbevaringspose, (6) vejledning, (7) 2 maskestropper.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**
**OPLADNINGSTID:** 2 timer driftstid: 60 minutter smart timer: 15 minutter (automatisk)
**MODES:**
• Rødt LED-lys - bølgelængde på 630 nm
• Blåt LED-lys - bølgelængde 415 nm
• Grønt LED-lys - bølgelængde på 525 nm
• Gul LED-lys - rød + grøn
• blandet lys (hvidt) - rødt + blåt + grønt
Nærinfrarødt lys - bølgelængde 830 nm

**SPECIFIK EFFEKT (BESTRÅLINGSSTYRKE):**
Niveau 1
• rødt LED-lys: 7.755 mW/cm2
• blåt LED-lys - 16,6 mW/cm2
• grønt LED-lys: 12.214 mW/cm2
Gult LED-lys - 16.069 mW/cm2
• blandet lys - 30.211 mW/cm2
• Nærinfrarødt lys: 6.2 mW/cm2

Niveau 2
• rødt LED-lys - 16.562 mW/cm2
• blåt LED-lys - 23,34 mW/cm2
• grønt LED-lys - 15.710 mW/cm2
• gult LED-lys - 26.597 mW/cm2
• blandet lys - 33.950 mW/cm2
Nærinfrarødt lys - 11.9 mW/cm2 niveau 3
• rødt LED-lys - 22.896 mW/cm2
• blåt LED-lys - 29,57 mW/cm2
• grønt LED-lys - 25.895 mW/cm2
Gult LED-lys - 30.697 mW/cm2
• blandet lys - 38.154 mW/cm2
Nærinfrarødt lys - 19.54 mW/cm2

ENERGIDOSE (ENERGITÆTHED) VED EN BEHANDLING PÅ 15 MINUTTER
Niveau 1
Rødt LED-lys: 7.755 J/cm2
• blåt LED-lys - 17.928 J/cm2
• grønt LED-lys - 12.214 J/cm2
• gult LED-lys - 16.069 J/cm2
• blandet lys - 30.211 J/cm2
Nærinfrarødt lys - 6.20 J/cm2 niveau 2
• rødt LED-lys - 16.562 J/cm2
• blåt LED-lys - 33.240 J/cm2
• grønt LED-lys - 15.710 J/cm2
• gult LED-lys - 26.597 J/cm2
• blandet lys - 33.950 J/cm2
Nærinfrarødt lys - 11.9 J/cm2 niveau 3
• rødt LED-lys - 22.896 J/cm2
• blåt LED-lys - 50.627 J/cm2
• grønt LED-lys - 25.895 J/cm2
• gult LED-lys - 30.697 J/cm2
• blandet lys - 38.154 J/cm2
• nærinfrarødt lys -19.54 J/cm2

**VANDBESTANDIGHED:** IP22




# LED PATCHES - LED-PATCHES TIL MÅLRETTET HUDPLEJE

Beroliger hurtigt betændelse

Lysner pigmentering

Målrettet løft

Forbedrer fastheden

**PROBLEMOMRÅDER:** lokal betændelse og akne, allergiske hudreaktioner, små urenheder, ubalance i talgproduktionen, aldersforandringer i bestemte områder (rynker, folder) og pigmentpletter.

**MATERIALER:** PC-plast, silikone.

**VÆGT:** 23.4g (etui), 2.78g (patch).

**FUNKTIONER:**

Fototerapi (LED) er en metode, hvor lysbølger med forskellige bølgelængder trænger ned til en bestemt dybde i huden og optages af cellerne, hvilket sætter naturlige regenereringsprocesser i gang.

Rødt LED-lys (630 nm): stimulerer metaboliske processer i celler, fremmer dyb restitution, forbedrer hudtekstur og lysner pigmentpletter.

Blåt LED-lys (415 nm): normaliserer balancen i fedtet hud, fremmer omhyggelig rensning og beroliger den.

Patchene arbejder i én KOMBINERET TILSTAND, som forener to lysspektre for samtidig antibakteriel og foryngende effekt.

UVC - Stråling (275 nm) i etui: Anvendes udelukkende i et lukket etui til at sterilisere plastre. Strålingen ødelægger DNA og RNA fra bakterier og vira, hvilket sikrer, at den næste brug af plasteret vil være absolut sikker for huden.

**EGENSKABER:**
1. Målrettet behandling: den kompakte størrelse gør det muligt at sætte patchen præcist på området, der skal behandles (bums, hudfold eller pigmentplet).
2. Frie hænder: patchene sidder sikkert på huden med særlige hypoallergene klæbestrimler (32 stk. medfølger), så du kan fortsætte dine gøremål under behandlingen.
3. Automatisk sterilisering: det lukkede etui med patchene starter automatisk en UVC-desinfektion på 1 minut, som sikrer sikker kontakt med huden ved hver brug.
4. Smart timer: behandlingen varer præcis 10 minutter, hvorefter patchen slukker af sig selv.
5. Batteritid: et fuldt opladet etui rækker til 10 fulde opladninger af patchene, og én patch kan arbejde uafbrudt i op til 60 minutter.

6. Dobbelt effektivitet: ladeetuiet indeholder 2 uafhængige patches. Du kan bruge dem samtidigt på forskellige problemområder i ansigtet (f.eks. symmetriske rynker eller flere betændte områder) og halvere behandlingstiden. Eller skifte mellem dem: mens den ene patch oplades og desinficeres, er den anden klar til brug, så plejen kan fortsætte uden afbrydelse.
7. Bærbarhed: opbevar og oplad patchene på farten. Det kompakte, lukkede etui beskytter apparaterne mod ydre skader i tasken.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tag en af patchene ud af ladeetuiet.
2. Tag klæbestrimlen, og sæt den på apparatets bagside.
3. Fjern beskyttelsesfilmen, og sæt patchen på ren hud i behandlingsområdet. Tryk, så den hæfter på huden.
4. Tryk på knappen på patchens forside for at tænde den.
5. Apparatet slukker automatisk efter 10 minutter (eller tryk igen på knappen for at slukke manuelt).
6. Fjern og kassér den brugte klæbestrimmel efter behandlingen.
7. Læg patchen tilbage i det trådløse etui med knappen vendt bagud og ladekontakterne nedad til opladning og automatisk desinfektion. En grøn indikator bekræfter korrekt forbindelse.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Følsomhedstest. Vigtigt: udfør en test før behandlingen. Læg den tændte patch på indersiden af underarmen i 10 minutter. Fjern straks apparatet ved varme eller ubehag. Vurdér reaktionen efter 6 timer. Hvis huden er rød eller klør, er patchene ikke egnet til dig.
2. Daglig brug: rens huden før behandlingen. Påfør ikke plejeprodukter.
3. Fastgør patchen på problemområdet, og tænd den.
4. Det anbefales ikke at overskride grænsen på 10 minutter på ét område i én behandling.
5. Påfør dit sædvanlige pleje- eller fugtprodukt efter brug.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

**TIL NYBEGYNDERE MED LED-PLEJE:** brug patchen hver anden dag på problemområdet, indtil den ønskede effekt er nået.

**TIL ERFARNE BRUGERE:** brug patchen 1 gang dagligt på problemområdet, indtil effekten er nået.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget lysfølsomhed: apparatet må ikke bruges ved sygdomme, som giver overfølsomhed for lys (f.eks. lupus erythematosus eller fotodermatose).
2. Særlig medicin og kosmetik: brug ikke patchene, hvis du tager medicin eller bruger kosmetik, der øger lysfølsomheden, f.eks. retinoider, visse antibiotika og æteriske citrusolier.
3. Hudskader: undgå brug på åbne sår eller dybe rifter.
4. Intolerans over for behandlingen: apparatet er ikke egnet til dig, hvis huden bliver rød eller begynder at klø efter testen på underarmen.



**FORHOLDSREGLER:**
1. Tørre hænder: sørg for, at hænderne er helt tørre før brug.
2. Beskyttelse af synet: se ikke direkte på lyskilden i længere tid, når patchen er tændt.
3. Stop ved ubehag: afbryd straks brugen, hvis du oplever irritation under behandlingen.
4. Fugtbeskyttelse: patchene er ikke vandtætte. Vask dem ikke med vand, og brug dem ikke i fugtige omgivelser (f.eks. badeværelset).
5. Sikker opladning: lad ikke ladeetuiet være tilsluttet strømmen i længere tid. Afbryd det straks ved 100% opladning. Brug ikke apparatet, mens det er tilsluttet stikkontakten.
6. Rengøring: tør forsigtigt patchens behandlingsflade med en blød, fnugfri klud efter hver brug. Brug ikke aggressive desinfektionsmidler eller brandfarlige stoffer.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) ladeetui x1, 2) patches x2, 3) klæbestrimler til fastgørelse x32, 4. Dual Type C-ladekabel x1, 5) brugsanvisning x1.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** 35x58x20 mm (etui), 21x21x5 mm (patch)

**STRØMKILDE:** litiumionbatteri

**DRIFTSSPÆNDING:** 3,6 V

**FORSYNINGSSPÆNDING:** 5 V

**EFFEKT:** 0,09 W

**BATTERIKAPACITET:** 200 mAh (etui), 18 mAh (patch)

**OPLADNINGSTID:** 1,5 h

**SMART TIMER:** 10 min

**MAKSIMAL TRÅDLØS DRIFTSTID:** 10 fulde opladninger af patchen (fra 1 opladning af etuiet), 60 minutters kontinuerlig drift (1 patch)

**ANTAL LED'ER:** 1 lampe i patchen

**BØLGELÆNGDER:**
• Blandet: rødt 630 nm + blåt 415 nm
Etui-funktion: automatisk UVC-desinfektion - 275 nm

**LYSINTENSITET:**
• blandet spektrum - 36.36 mW/cm2



# LED SET - LYSTERAPI TIL ANSIGT, HALS OG DEKOLLETAGE

Forbedrer hudens udseende

Udglatter rynker

Reducerer akne og mærker efter akne

Forbedrer cirkulationen

Reducerer pigmentering

**PROBLEMOMRÅDER:** synlige aldringstegn, fotoaldring, pigmentering og hyperpigmentering, akne, eftervirkninger af akne, couperose, rosacea og andre karforandringer.

**MATERIALER:** silikone, ABS-plast.

**VÆGT:** 380 g ansigtsmaske + 210 g halsmaske.

**FUNKTIONER:**
LED SET bygger på LED-lysterapi. Masken har indbyggede LED-lamper, som hver er programmeret til at udsende en bestemt farve. Hver farve svarer til en bestemt bølgelængde i det synlige lysspektrum. Lyset påvirker huden i forskellige dybder og optages af hudens receptorer, aktiverer naturlige processer i cellerne og fremkalder en bestemt hudreaktion.

Rødt LED-lys, der har den største bølgelængde, trænger dybere ind i huden end alle de viste lys. Det virker på fibroblaster, som stimulerer produktionen af kollagen og derved regenerering af huden. Som et resultat af terapi med rødt LED-lys fremskyndes sårheling, huden opstrammes, ydre tegn på hudens aldring, såsom rynker, aftager.

Blåt LED-lys har den korteste bølgelængde af alle farverne i det synlige spektrum. Det virker på niveauet af epidermis og har en antimikrobiel virkning. Porphyriner (pigmenter i vores krop) er i stand til at absorbere blåt LED-lys og frigive singlet-iltmolekyler, der dræber acnebakterier, der lever på overfladen af huden. Således desinficerer blåt LED-lys, reducerer inflammatoriske formationer, bekæmper acne.

Grønt LED-lys absorberes af epidermis og dermis, hvilket forårsager en cellulær reaktion, som blandt konsekvenserne har restaurering og heling af huden. Det bruges til at reducere rødme, lindre irritation af følsom hud. Grønt LED-lys bekæmper couperosis, reducerer størrelsen af kapillærerne og bidrager til den frie strøm af blod.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**
Gult LED-lys (rødt + grønt) - bruges til at stimulere blodcirkulationen, hjælper med at lette hudtonen, reducere sværhedsgr
hvid) - bruges til hurtig og dyb penetration af kosmetik. Derudover har den en generel afslappende og beroligende effekt pa

**EGENSKABER:**
1. Behandlingsområde: 2 masker dækker 3 plejekrævende områder.
2. Én fjernbetjening: begge masker styres med 1 fjernbetjening.
3. Alsidig brug: maskerne kan bruges som sæt (2 samtidigt) eller hver for sig
4. Manuel styring gør det muligt at indstille en individuel behandling.
5. Masken er lavet af fødevaregodkendt silikone, som er sikker for huden og ikke giver irritation.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tilslut maskerne til betjeningspanelet med et Type C-kabel. Sæt hver kabelende helt i maskernes stik, til du hører et klik.
2. Hold tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet inde i 2 sekunder for at tænde apparaterne.
3. Et kort tryk (1 sekund) på omskiftningsknapperne (↑/↓) vil tillade dig at skifte til blå LED-lystilstand (indikator C: B på kontrolpanelet), grøn LED-lystilstand (indikator C: G), gul LED-lystilstand (indikator C: RG), hvid lystilstand (indikator C: RGB).
4. Et kort tryk (1 sekund) på knapperne til lysintensitet (-/+) øger niveauet til 3 eller vender tilbage til niveau 1 (L-indikator: 1 (2/3) på betjeningspanelet).
5. Et kort tryk (1 sekund) på pauseknappen sætter apparaterne på pause; tryk igen for at fortsætte.
6. Hold tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet inde i 2 sekunder for at slukke maskerne.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Udfør en „følsomhedstest" efter vejledningen før første brug af masken.
2. Tilslut fjernbetjeningen til maskerne.
3. Tag ansigtsmasken og masken til hals og dekolleté på.
4. Tænd maskerne, og vælg ønsket lystilstand og intensitet.
5. Nyd fototerapibehandlingen.
6. Hver lystilstand arbejder i 15 minutter, hvorefter fjernbetjeningen slukker automatisk. Timeren starter forfra ved tilstandsskift. [Vigtigt]: sørg omhyggeligt for, at den samlede fototerapitid ikke overstiger 15 minutter, når flere tilstande bruges i samme behandling.
7. Brug serum eller creme efter LED-lysterapien, da hudens optagelsesevne øges efter behandlingen.

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| **AKNE / INFLAMMATION / FEDTET HUD** | Morgen / aften | Uge 1: blåt, lav - 3 min; gult, lav - 3 min; rødt, lav - 3 min; grønt, lav - 3 min; blandet, lav - 3 min. Uge 2: blåt, mellem - 4 min; gult, mellem - 3 min; rødt, mellem - 2 min; grønt, mellem - 3 min; blandet, mellem - 3 min. Uge 3: blåt, høj - 3 min; gult, høj - 3 min; rødt, høj - 3 min; grønt, høj - 3 min; blandet, høj - 3 min. Uge 4: blåt, høj - 5 min; gult, høj - 3 min; rødt, høj - 2 min; grønt, høj - 3 min; blandet, høj - 2 min. | Hver anden dag | Gentag programmet i 2-3 måneder. Én gang hver 6. måned. |
| **FINE LINJER / ALDERSRELATEREDE FORANDRINGER** | | Blåt, høj - 2 min. Gult, høj - 3 min. Rødt, høj - 5 min. Grønt, høj - 3 min. Blandet, høj - 2 min. | 2-3 gange om ugen | Ingen fast grænse for forløbets varighed |
| **SYNLIGE BLODKAR / COUPEROSE / FØLSOM HUD** | Aften | Uge 1: blåt, lav - 1 min; rødt, lav - 3 min; grønt, mellem - 3 min; gult, mellem - 3 min; blandet, mellem - 5 min. Uge 2: blåt, lav - 1 min; rødt, mellem - 3 min; grønt, høj - 3 min; gult, høj - 3 min; blandet, høj - 5 min. Uge 3: blåt, lav - 2 min; rødt, høj - 5 min; grønt, høj - 2 min; gult, høj - 3 min; blandet, høj - 3 min. Uge 4: pause. | Hver anden dag | 1 måned inklusive pausen. Hold 1 uges pause. Gennemfør 2-3 forløb på fire uger, og hold derefter 1 måneds pause. Gentag 2-3 forløb på fire uger, og fortsæt denne cyklus. |

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| PIGMENTERING / UJÆVN HUDTONE | Aften | Rødt, høj - 5 min. Gult, høj - 3 min. Grønt, høj - 2 min. Blåt, lav - 1 min. Blandet, mellem - 4 min. | 2-3 gange om ugen | Ingen fast grænse for forløbets varighed. Påfør en creme med SPF efter brug. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Apparatet må ikke bruges af spædbørn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelsygdom eller medicinsk behandling af skjoldbruskkirtlen.
2. Maskerne må ikke bruges på beskadiget eller skadet hud eller operationssår.

**ADVARSLER:**
1. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
2. Stop brugen, hvis en af maskerne er beskadiget, og kontakt den organisation, der er bemyndiget til at modtage forbrugerklager, for at undgå fare.
3. Maskerne må ikke bruges under opladning. Berør ikke masker, ladekabel eller USB-adapter med våde hænder under opladning.
4. Stop straks ved ubehag eller en uønsket reaktion (rødme, kløe, allergi) efter brug af masken.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) ansigtsmaske, (2) fototerapimaske til hals og dekolleté, (3) kabel til Type C-betjeningspanelet, (4) betjeningspanel,
5. Type C-USB-ladekabel, 6) vejledning, 7) opbevaringsposer, 8) 2 stropper til halsmasken.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**
**OPLADNINGSTID:** 4 h

**DRIFTSTID:** 30 minutter (med 2 masker samtidig på højeste intensitetsniveau)

**SMART TIMER:** 15 min

**MODES:**
- Rødt LED-lys - bølgelængde på 660 nm
- Blåt LED-lys - bølgelængde 415 nm
- Grønt LED-lys - bølgelængde på 525 nm
- Gul LED-lys - rød + grøn
- blandet lys (hvidt) - rødt + blåt + grønt

**SPECIFIK EFFEKT (BESTRÅLINGSSTYRKE):**
Niveau 1 LED MASK
- rødt LED-lys: 5.455 mW/cm2
- blåt LED-lys - 12.065 mW/cm2
- grønt LED-lys - 8.582 mW/cm2

Gult LED-lys - 13.012 mW/cm2
- blandet lys - 21.826 mW/cm2



LED NECK MASK
- rødt LED-lys: 5.171 mW/cm2
- blåt LED-lys - 10.707 mW/cm2
- grønt LED-lys - 6.413 mW/cm2
- gult LED-lys - 11.888 mW/cm2
- blandet lys - 18.059 mW/cm2 niveau 2 LED MASK
- rødt LED-lys - 12.155 mW/cm2
- blåt LED-lys - 23.541 mW/cm2
- grønt LED-lys - 12.757 mW/cm2
- gult LED-lys - 16,86 mW/cm2
- blandet lys - 26.797 mW/cm2 LED NECK MASK
- rødt LED-lys - 9.759 mW/cm2
- blåt LED-lys - 25,02 mW/cm2
- Grønt LED-lys: 13.664 mW/cm2

Gult LED-lys - 16.725 mW/cm2
- blandet lys - 25.447 mW/cm2 niveau 3 LED MASK
- rødt LED-lys: 15,94 mW/cm2
- blåt LED-lys - 33,06 mW/cm2
- grønt LED-lys - 17.461 mW/cm2
- gult LED-lys - 20.607 mW/cm2

Blandet lys - 29.321 mW/cm2 LED NECK MASK
- rødt LED-lys - 15.275 mW/cm2

Blåt LED-lys: 31.849 mW/cm2
- grønt LED-lys - 16.986 mW/cm2
- gult LED-lys - 19.561 mW/cm2
- blandet lys - 30.183 mW/cm2

**ENERGIDOSE (ENERGITÆTHED) VED EN BEHANDLING PÅ 15 MINUTTER:**
Niveau 1 LED MASK
- rødt LED-lys - 4,9095 J/cm2
- blåt LED-lys - 10,8585 J/cm2
- grønt LED-lys - 7,7238 J/cm2
- gult LED-lys - 11,7108 J/cm2

Blandet lys - 19.6434 J/cm2 LED NECK MASK
- rødt LED-lys - 4,6539 J/cm2
- blåt LED-lys - 9,6363 J/cm2
- grønt LED-lys - 5,7717 J/cm2

• gult LED-lys - 10,6992 J/cm2
• blandet lys - 16.2531 J/cm2 niveau 2 LED MASK
• rødt LED-lys - 10,9395 J/cm2
• blåt LED-lys - 21.1869 J/cm2
• grønt LED-lys - 11.4813 J/cm2
• gult LED-lys - 15.174 J/cm2
Blandet lys - 24.1173 J/cm2 LED NECK MASK
• rødt LED-lys - 8,7831 J/cm2
• blåt LED-lys - 22.518 J/cm2
• grønt LED-lys - 12.2976 J/cm2
• gult LED-lys - 15,0525 J/cm2
• blandet lys - 22.9023 J/cm2 niveau 3 LED MASK
Rødt LED-lys - 14.346 J/cm2
• blåt LED-lys - 29.754 J/cm2
• grønt LED-lys - 15,7149 J/cm2
• gult LED-lys - 18.5463 J/cm2
• blandet lys - 26.3889 J/cm2 LED NECK MASK
• rødt LED-lys - 13,7475 J/cm2
• blåt LED-lys - 28,6641 J/cm2
• grønt LED-lys - 15,2874 J/cm2
• gult LED-lys - 17.6049 J/cm2
• blandet lys - 27.1647 J/cm2

**VANDBESTANDIGHED:** IP22




# MAMI - LØFTENDE MASSAGEAPPARAT TIL ANSIGT OG HALS

Forbedrer hudtonen

Ansigtsløft

Udglatter rynker

Reducerer hævelser

**PROBLEMOMRÅDER:** synlige aldersforandringer, fotoaldring, hængende kinder, trist hudtone, akne, pigmentering, udvidede porer, hævelser og tab af hudelasticitet.

**MATERIALER:** ABS-plast, zinklegering, rustfrit stål.

**VÆGT:** massageapparat - 179 g, base - 108 g.

**FUNKTIONER:**

EMS - elektrisk strøm til muskelstimulation, som trænger dybt ned i hudlagene og når muskellaget. Ved at stimulere muskelsammentrækninger fremmer EMS opstramning, giver en løftende effekt, øger produktionen af kollagen og elastin samt hudens fasthed og elasticitet og reducerer hævelser.

3 Lysfototerapi: røde, blå og blandede farver af det synlige lysspektrum med forskellige bølgelængder, der trænger ind i huden, udløser regenereringsprocesser. Blåt LED-lys med den laveste indtrængningsdybde virker på hudens overflade, desinficerer den og reducerer derved inflammation. Rødt LED-lys med den højeste penetrationsdybde påvirker fibroblaster, som syntetiserer kollagen, bruges til at forynge huden og bekæmpe ældningstegn. Kombinationen af rødt og blåt LED-lys er en kombination af de to funktioner til effektivt at behandle inflammation.

Vibration er en mekanisk påvirkning af huden, som fremmer alle stofskifteprocesser, strammer huden op og reducerer synlige rynker.

**EGENSKABER:**
1. 3 EMS-intensitetsniveauer til valg af en behagelig påvirkning.
2. 2 elektroder som strømkilder.
3. Den bueformede behandlingsflade følger kroppens kurver; massageapparatet kan bruges på to områder: ansigt og hals.
4. Manuel styring: du bestemmer selv tilstandene og driftstiden for hver og skaber en individuel kombination.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Hold POWER-knappen inde for at tænde eller slukke apparatet.
2. Tryk kort på POWER-knappen for at vælge lyset for fototerapi. Automatisk tændes det allerførste blå LED-lys, ved at trykke igen kan du vælge et rødt LED-lys for at tænde for blandet lys-tilstand, tryk på POWER-knappen igen.
3. Når apparatet er tændt, vælger et kort tryk på LEVEL-knappen EMS-intensiteten fra svag til stærk. Svagt niveau - 1 indikator lyser.

(Low), middel - 2 indikatorer (Low + Medium), stærkt niveau - 3 indikatorer (Low + Medium + High) lyser.
4. Tænd vibration med et langt tryk på LEVEL-knappen. Det samme lange tryk slukker vibration.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Fjern makeup, og vask ansigtet med et renseprodukt.
2. Påfør plejeproduktet jævnt (vandbaseret geltekstur, som giver maksimal strømledning og de bedste resultater).
3. Tænd apparatet, og vælg fototerapitilstand.
4. Justér EMS-intensiteten.
5. Læg apparatets massageflade mod ansigtshuden, og massér langs massagelinjerne. Bevæg dig nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen i panden).
6. Gentag behandlingen tre gange langs alle massagelinjer. Det anbefales ikke at bruge apparatet i mere end 10 minutter.
7. Sluk apparatet efter massagen, og rengør massagefladen med en rengøringsklud.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| **AKNE / BETÆNDELSE** | ALLE TIDSPUNKTER PÅ DAGEN | LED-tilstand: • Blåt LED-lys - 5 minutter • Rødt LED-lys - 2 minutter Mode "EMS" • Gennemsnitligt intensitetsniveau - 5-7 minutter Modes bruges ikke samtidigt, men i den specificerede rækkefølge | HVER ANDEN DAG | 2 uger 3-4 dages pause 2 uger Forløb på 4-5 uger om året |
| **FINE LINJER / TØR HUD / PIGMENTERING / UJÆVN HUDTONE** | AFTEN | LED-tilstand: • Rødt LED-lys - 7 minutter • Blandet lys - 5 minutter "EMS"-tilstand: • Lav intensitet - 5 minutter • Gennemsnitligt intensitetsniveau - 3 minutter • Maksimalt niveau (til tæt hud) - 3 minutter LED- og EMS-tilstande kan bruges samtidigt | 2 gange om ugen | 3-4 uger 1 uges pause Gentag et forløb på 4 uger Gentag derefter løbende |
| **SYNLIGE BLODKAR / COUPEROSE / FØLSOM HUD** | AFTEN | "LED"-tilstand: • Rødt LED-lys - 7 minutter • Blandet lys - 5 minutter Modus "Vibration": 5 minutter Modus "EMS" for couperosis er kontraindiceret Modus bruges ikke samtidigt, men i den specificerede rækkefølge | 2 gange om ugen | 4 uger 1 uges pause Gentag et forløb på 4 uger Gentag derefter løbende |



**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Brug ikke apparatet, hvis huden heler efter kosmetisk eller kemisk peeling, laserresurfacing, fraktioneret laserforyngelse, mesoterapi eller dermale fillere inden for de sidste to uger.
2. Apparatet er ikke beregnet til personer under 12 år.
3. Apparatet er ikke beregnet til personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner.
4. Brug ikke apparatet ved øreproblemer (ydre øregangsbetændelse, øreinfektion eller andre sygdomme).
5. Brug ikke massageapparatet på revnet hud, åbne sår eller problemhud og irriteret hud (svær akne, solskoldning, infektion osv.).
6. Brug ikke apparatet på det følsomme område omkring øjnene, hvor huden er tynd og sart.
7. Brug ikke apparatet på slimhinder (f.eks. i næse, mund eller kønsområde), da det kan give lokal irritation.

**ADVARSLER:**
1. Hold ladestikket og USB-kablet tørre.
2. Oplad ikke apparatet i fugtige omgivelser (f.eks. ved et fyldt badekar, en tændt bruser eller en fyldt swimmingpool).
3. Brug kun apparatet med det USB-kabel, som følger med massageapparatet.
4. Udskift kun et beskadiget USB-kabel med et originalt kabel for at undgå fare.
5. Oplad massageapparatet helt til 100% mindst én gang hver 2. måned - det forlænger batteriets levetid.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massageapparat, (2) baseholder, (3) USB-C-ladekabel, 4. vejledning, (5) klud, (6) pose.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**NOMINEL DRIFTSSPÆNDING:** 5-9 V

**NOMINEL FORSYNINGSSPÆNDING:** 3,7 W

**STRØMKILDE:** litiumion

**BATTERIKAPACITET:** 900 mAh

**MÅL:** 147.1x83x44.4 mm (apparat), 57.1x57.1x76 mm (holder)

**VÆGT:** apparat - 179 g, holder - 108 g

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** Rødt LED-lys/Blå LED-lystilstand - 200 minutter Blandet lystilstand - 300 minutter

**LYSINTENSITET:**
Rødt LED-lys: 7,7867 mW/cm2
- Blåt LED-lys - 32.758 mW/cm2
- Blandet lys - 23.322 mW/cm2

**EMS:**
- Niveau 1 - 0.08 mA
- Niveau 2 - 0.11 mA
- Niveau 3 - 0.13 mA

**STRØMFREKVENS:** 34,7 kHz

**BØLGELÆNGDE:** Rødt LED-lys - 625 nm - blåt LED-lys - 465 nm

**BØLGEFORM:** bifasisk symmetrisk rektangulær bølgeform

**VANDBESTANDIGHED:** IPX4



# MEI1 - EMS-MASSAGEAPPARAT TIL ANSIGT OG HALS

V-formet løft

Reducerer hævelser

Former konturerne

Udglatter folder og rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** tab af elasticitet og uklare ansigtskonturer, morgenhævelser, muskelkramper og spændinger, aldersforandringer (rynker), trist hudtone og lav optagelse af daglige plejeprodukter.

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** 78 g.

**FUNKTIONER:**
Apparatet påvirker alle vævslag samlet gennem samspillet mellem
4 teknologier:

EMS - efterligner kroppens naturlige bioelektriske signaler, får ansigtsmusklerne til skånsomt at trække sig sammen og træner dem, så de genvinder spændstighed.

Dyb varme (42 °C) - varmen afslapper spændte muskler og øger mikrocirkulationen.

BØLGEVIBRATION (8500 rpm) - højfrekvente mekaniske svingninger fremmer kraftig lymfedrænage og reducerer hævelser og væskeophobning i vævet.

ION IMPORT (iontoforese) - sammen med varme hjælper teknologien aktive serumingredienser ned i dermis' dybe lag og mangedobler deres virkning.

**EGENSKABER:**
1. Intelligent 360°-design: alle kabinettets sider er aktive behandlingsflader. Den øverste del (rullerne) bruges til 3D-massage, siderne til gua sha-massage og den nederste fremspringende del til målrettet akupressur.
2. 4 teknologier i 1 apparat: EMS, bølgevibration, varme og iontoforese.
3. 2 driftstilstande: grundtilstand (hvid indikator) til lymfedrænage og toning om morgenen; kombineret tilstand med varme (rød indikator) til intensiv foryngende aftenpleje og afslapning.
4. Smart timer: af hensyn til sikker brug slukker apparatet automatisk efter 10 minutters uafbrudt drift og går i dvale efter 2 minutters inaktivitet.
5. Bærbarhed og batteritid: det indbyggede batteri på 800 mAh giver op til 80 minutters uafbrudt brug på én opladning.

6. Alsidig anvendelse: apparatets form gør det egnet til punkt-, rulle- og løftende pleje samt massage af hals, skuldre, arme og ben.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Hold tænd/sluk-knappen inde i 1-2 sekunder for at tænde eller slukke apparatet (der høres et lydsignal).
2. Første korte tryk (standardtilstand): aktiverer EMS, vibration og Ion Import. Indikatorringen lyser hvidt. Ideel til morgenhævelser og toning.
3. Andet korte tryk (kombineret tilstand): føjer dyb varme til de foregående teknologier. Indikatoren lyser rødt. Velegnet til intensivt løft og afslapning.
4. Under opladning blinker indikatoren jævnt med rødt LED-lys, og når den når 100 %, brænder den konstant.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. For at EMS virker, skal du påføre rigeligt ledende gel, fugtserum eller essens udelukkende på vandbasis på renset hud. Plejeproduktet må ikke indeholde olier og syrer (AHA-, BHA- eller PHA-syrer, retinol eller høje koncentrationer af C-vitamin).
2. Tænd apparatet, og vælg den ønskede tilstand.
3. Massér langs massagelinjerne med den valgte behandlingsflade i tæt kontakt med huden. Før apparatet jævnt med konstant hastighed og uden for stort tryk.
4. Efter 10 minutters brug slukker den smarte timer automatisk apparatet.
5. Tør massageapparatet med en fugtig klud (fugtbeskyttelsesklasse IPX3 - det må ikke vaskes under rindende vand).

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| TÆT HUD MED HÆVELSER | Aften, 2 anden halvdel af dagen | Tilstanden "EMS, vibration, ionindføring" - 3-5 minutter Tilstanden "EMS, vibration, ionindføring, opvarmning" - 5 minutter | 2-3 gange om ugen | Behandlingsforløb: 10 uger. Pause: 2 uger. Gentag 10-ugers forløbet løbende. |
| TØR HUD MED FINE LINJER | Morgen. | Tilstanden "EMS, vibration, ionindføring" - 3-4 minutter Tilstanden "EMS, vibration, ionindføring, opvarmning" - 3-4 minutter | 1-2 gange om ugen | Behandlingsforløb: 10 uger. Pause: 2 uger. Gentag 10-ugers forløbet løbende. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Må ikke bruges af personer med pacemaker, osteoporose, manglende temperatur-/smertesans eller hudsygdomme.
2. Brug ikke på områder med rifter, efter plastikkirurgi, på pusfyldt eller betændt hud eller ved øjeæbler, øjenlåg og skjoldbruskkirtel.
3. Brug ikke på områder med metalproteser.
4. Personer under tandbehandling (eller med fyldninger/bøjle) samt personer med metalallergi eller couperose (telangiektasier) bør bruge apparatet forsigtigt.



5. Ved graviditet, menstruation, amning, højt blodtryk eller feber må apparatet kun bruges efter samråd med en læge.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Apparatet er ikke vandtæt.
2. Det må ikke bruges i vand, vaskes under vandhanen eller opbevares ved høj luftfugtighed (f.eks. på badeværelset).
3. Brug ikke apparatet under opladning. Afbryd altid strømmen før en behandling.
4. Sluk straks apparatet, hvis du bemærker unormal varme eller røg under opladning eller brug.
5. Undgå at tabe apparatet eller udsætte det for slag.
6. Opbevar apparatet tørt og køligt, væk fra direkte sollys. Genoplad batteriet hver 3. måned ved længere opbevaring uden brug.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massageapparat, (2) opbevaringspose, (3) Type-C-ladekabel, 4. brugsanvisning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** 140×80×10 mm

**STRØMKILDE:** indbygget litiumbatteri

**DRIFTSSPÆNDING:** 5 V

**EFFEKT:** 4,4 W

**BATTERIKAPACITET:** 800 mAh

**SMART TIMER:** 10 min

**OPLADNINGSTID:** ≤ 2 h

**MAKSIMAL DRIFTSTID (FULD OPLADNING):** 80 min

**STRØM:** 1,4 mA

**VIBRATION:** 8500 omdrejninger pr. minut

**OPVARMNINGSTEMPERATUR:** 42 °C

**VANDBESTANDIGHED:** IPX3




# MIGA - MUNDSKYLLER

Hjælper med at forebygge tandkøds-sygdomme

Fjerner madrester

Hjælper med at forebygge caries

Renser svært tilgængelige steder i munden

**PROBLEMOMRÅDER:** plak, caries, tandkødssygdom og dårlig ånde.

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** 157 g.

**FUNKTIONER:**

Væsken renser effektivt selv de mest utilgængelige steder i munden og fjerner madrester, hvilket forebygger caries.

Mundskyllerens væsketryk masserer tandkødet og stimulerer dets blodcirkulation og heling.

Rensning af tunge og kinder med vandstråler hjælper med at fjerne dårlig ånde.

**EGENSKABER:**
1. Der medfølger 1 standarddyse, opbevaringsetui og ladekabel.
2. 1 tilstand.
3. Beholderen rummer 70 ml.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Oplad batteriet helt før første brug ved at tilslutte det magnetiske ladekabel til kontakterne på mundskyllerens kabinet. Apparatet kan ikke bruges under opladning.
2. Montering/afmontering af dyse Sæt dysen i hullet på apparatets øverste dæksel, til den klikker på plads. Klikket bekræfter korrekt montering. Fjern dysen ved at trykke på det øverste dæksel, holde det nede og trække dysen ud.
3. Fyldning Kontrollér, at apparatet er slukket, åbn vandbeholderens låg nederst, og fyld beholderen med vand.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke apparatet. Bemærk: indikatoren lyser konstant blåt under brug.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Montér dysen, og gør apparatet klar ved at holde i kabinettet med den ene hånd og trække vandbeholderen ned med den anden.
2. Før dysen ind i munden, ret den mod tænderne, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. Hold mundskylleren lodret under rensningen.
3. Begynd ved kindtænderne, og før dysen frem mod fortænderne for det bedste resultat. Ret vandstrålen mod tandkødet i en vinkel på 90 grader, og åbn ikke munden helt, så vandet ikke sprøjter ud.
4. Før dysen langs tandkødsranden, og bliv kort ved hver tand, indtil tandkødslommen og mellemrummet er renset.
5. Sluk med tænd/sluk-knappen efter rensning, og tøm beholderen for resterende vand. Åbn låget, hæld vandet ud, og fold derefter mundskylleren tilbage til udgangspositionen.
6. Rens munden 2 gange dagligt efter måltider. Bemærk: let blødning ved den første rensning er normalt og forsvinder inden for en uge. Stop brugen, og kontakt tandlægen, hvis blødningen fortsætter i mere end 2 uger.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt efter et måltid; ved pleje af tandreguleringsapparatur efter hvert måltid.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Forværring af parodontitis og akutte betændelsestilstande i munden.
2. Kraftig blødning fra tandkødet.
3. De første 2 måneder efter operation i munden.

**ADVARSLER:**
1. Brug ikke mundskylleren i brusebadet, nedsænk den ikke i vand, og placér den ikke, hvor den kan falde i vand.
2. Placér ikke apparatet ved høj temperatur eller luftfugtighed eller i direkte sollys.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder under opladning, og efterlad det aldrig uden opsyn under opladning.
4. Håndtér ladekablet forsigtigt: hold det væk fra varmekilder, undgå at strække, bøje eller sno det med kraft, og lad det ikke komme i klemme, da det kan ødelægge kablet. Brug eller oplad ikke mundskylleren, hvis apparatet eller ladekablet er beskadiget (f.eks. efter fald eller vandindtrængning).
5. Oplad kun mundskylleren med den originale oplader; tilslut ikke apparatet til en anden spænding end den angivne.
6. Brug ikke apparatet uden dyse eller med dyser, producenten ikke anbefaler.



7. Opbevares utilgængeligt for børn.
8. Stik ikke fremmedlegemer ind i mundskylleren.
9. Afbryd ladekablet, før du fylder vand på, og undgå at overfylde beholderen.
10. Kontrollér før rengøring og vedligeholdelse, at apparatet er slukket og ikke oplades.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) opbevaringsetui, (2) mundskyller, (3) dyse, (4) USB-ladekabel med magnetisk stik, (5) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** mere end 2 timer

**DRIFTSTID:** 20 min

**SMART TIMER:** nej

**DRIFTSTID PR. FULD VANDBEHOLDER:** 30 s

**EFFEKT:** 482,3 kPa

**IMPULSER PR. MINUT:** 900-1100

**VANDBEHOLDERENS KAPACITET:** 70 ml

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7



# MIGA BLACK - MUNDSKYLLER

Hjælper med at forebygge tandkøds-sygdomme

Fjerner madrester

Hjælper med at forebygge caries

Renser svært tilgængelige steder i munden

Pleje af tandreguleringsapparatur

**PROBLEMOMRÅDER:** plak, caries, madrester i tandreguleringsapparatur og mellem tænderne, tandkødssygdom og dårlig ånde.

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** 183 g.

**FUNKTIONER:**

Væsken renser de mest utilgængelige steder, så caries kan forebygges, og tandreguleringsapparatur kan rengøres.

Mundskyllerens væsketryk masserer tandkødet og stimulerer dets blodcirkulation og heling.

Rensning af tunge og kinder med vandstråler hjælper med at fjerne dårlig ånde.

3 tilstande og 4 medfølgende dyser sikrer effektiv fjernelse af madrester og plak samt rensning mellem tænderne, i tandkødslommer, på tungen og på tandreguleringsapparatur.

**EGENSKABER:**
1. 4 dyser medfølger (standard, parodontal, ortodontisk og tungerenser).
2. Kabinettet har et rum til opbevaring af dysen.
3. 3 driftstilstande (skånsom, pulserende, kraftig).
4. Beholderen rummer 140 ml.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Sæt dysen i, til den klikker.
Der medfølger 4 dysetyper med hver sin funktion:
Standarddysen bruges til daglig tandrensning. Den buede spids hjælper med at skylle plak og madrester væk.
Den parodontale dyse bruges til at rense tandkødslommer (de opstår, når betændt tandkød løsner sig fra tanden og danner en lomme).

Dysen har en blød gummispids til pleje af tandkødet.
• Den ortodontiske dyse er beregnet til rengøring af tandbøjler. Ud over vandåbningen har den en børste med stive børstehår for enden. Den renser bøjlernes brackets og skyller plak og madrester væk.
Tungerenseren er skeformet og kan fjerne belægninger og urenheder fra blødt væv.
2. Åbn beholderen, og fyld den med vand.
3. Før dysen ind i munden, og tryk kort på tænd-knappen for at starte apparatet.
4. Hold knappen på apparatet inde for at skifte mellem tilstandene.
Apparatet har 3 tilstande:
Skånsom (grøn indikator) - lavt tryk, egnet til begyndere og personer med følsomme tænder;
Pulserende (blå indikator) - varierende pulserende tryk, skiftevis kraftigt og svagt, til dybderensning og tandkødsmassage;
Kraftig (hvid indikator) - højt tryk og effektiv rensning til de flestes daglige behov.
5. Sluk apparatet med et kort tryk efter brug. Ved slukning gemmer det den seneste tilstand og starter automatisk i den næste gang.
6. Tryk på dyseudløseren, og tag forsigtigt dysen af; åbn opbevaringsrummet, og læg dysen deri.
7. Husk regelmæssig rengøring: tag beholderen af, og vask den. Bemærk: vælg skånsom tilstand ved første brug. Let blødning ved den første rensning er normalt og forsvinder inden for en uge. Stop brugen, og kontakt tandlægen, hvis blødningen fortsætter i mere end 2 uger.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Brug standarddysen til normal rensning. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Placér derefter dysen ud for tænderne, så strålen står vinkelret på behandlingsområdet. Bemærk: følsomt tandkød bløder let. Ret ikke strålen direkte mod tandkødet; personer med følsomme tænder bør vælge skånsom tilstand.
2. Begynd ved de bagerste tænder, og gå frem mod fortænderne. Gennemgå hele tandrækken, og bliv kort ved hver tand, indtil tandkød og tandmellemrum er renset. Hvis du startede på ydersiden, gentages proceduren på indersiden. Gør dette for både over- og undermund.
3. Brug den parodontale dyse til tandkødslommer. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Hold dysen skråt, så spidsen vender mod tandkødsranden og ind i tandkødslommen. Rens efter anbefalingerne ovenfor.
4. Brug den skeformede dyse til tungen. Montér dysen, tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand.



Før dysen hen over tungen med fejende bevægelser i én retning fra tungerod til spids. Rensningen bør tage 30 sekunder, svarende til ca. 5 gennemgange.
5. Brug den ortodontiske dyse til tandbøjler. Ud over åbningen til vandstrålen har den stive børstehår for enden, som renser brackets og skyller plak og madrester væk.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt efter et måltid; ved pleje af tandreguleringsapparatur efter hvert måltid.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Forværring af parodontitis og akutte betændelsestilstande i munden.
2. Kraftig blødning fra tandkødet.
3. Brug anbefales ikke i nogle uger efter operation i munden.
4. Rådfør dig med tandlægen før brug, hvis du har tandkødssygdom eller er blevet opereret i munden inden for de sidste 2 måneder.

**ADVARSLER:**
1. Skil ikke apparatet ad, og udskift ikke dets dele; det kan give skader og medføre bortfald af garantien.
2. Brug ikke vand over 50 °C i beholderen for at undgå forbrændinger.
3. Udskift et beskadiget strømkabel eller stik før brug. Beskadig ikke kablet ved at strække, bøje eller sno det. Lad det ikke blive klemt af tunge genstande eller mellem genstande, og hold apparat og kabel væk fra varmekilder.
4. Brug kun apparatet til det tilsigtede formål: mundrensning. Tryk ikke på tænder og tandkød, så de beskadiges.
5. Nedsænk ikke apparatet i vand i længere tid, da det kan medføre fejl, brand, elektrisk stød og andre farer.
6. Hold apparatet væk fra åben ild og varmeapparater.
7. Oplad ikke apparatet på våde steder som badeværelse eller toilet.
8. Brug ikke mundskylleren uden dyse.
9. Apparatet er ikke beregnet til børn. Brug er kun mulig under opsyn af voksne. Opbevar det utilgængeligt for børn.
10. Kom ikke mundskyl i vandbeholderen; det kan give korrosion og få beholderen til at hæfte på kabinettet, så den senere bliver svær at åbne.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) mundskyller, (2) standarddyse, (3) parodontal dyse, 4. ortodontisk dyse, (5) tungerenser, (6) opbevaringspose, (7) USB-C-ladekabel, (8) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 1,5 h

**DRIFTSTID:** 90 min

**SMART TIMER:** nej

**DRIFTSTID PR. FULD VANDBEHOLDER:** 40 s

**EFFEKT:** • skånsom tilstand: 275-413 kPa • pulstilstand: 413-758 kPa • kraftig tilstand: 827-965 kPa

**IMPULSER PR. MINUT:** 1600

**VANDBEHOLDERENS KAPACITET:** 140 ml

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7



# MIGA NEW - MUNDSKYLLER

Hjælper med at forebygge tand-kødssygdomme

Fjerner madrester

Hjælper med at forebygge caries

Renser svært tilgængelige steder i munden

Pleje af tandreguleringsapparatur

**PROBLEMOMRÅDER:** plak, caries, madrester i tandreguleringsapparatur, tandkødssygdom og dårlig ånde.

**MATERIALER: ABS-plast.**

**VÆGT:** 195 g.

**FUNKTIONER:**

Væsken renser de mest utilgængelige steder, så caries kan forebygges, og tandreguleringsapparatur kan rengøres.

Mundskyllerens væsketryk masserer tandkødet og stimulerer dets blodcirkulation og heling.

Rensning af tunge og kinder med vandstråler hjælper med at fjerne dårlig ånde.

Der medfølger 3 dysetyper med hver sin funktion:

Standarddysen bruges til daglig tandrensning. Den buede spids hjælper med at skylle plak og madrester væk.

Den PARODONTALE DYSE bruges til tandkødslommer (de opstår, når betændt tandkød løsner sig fra tanden og danner en lomme). Den har en blød gummispids til tandkødspleje.

Tungerenseren er skeformet og kan fjerne belægninger og urenheder fra blødt væv.

Desinfektionstilstanden steriliserer dyserne. Kontakt med vand eller urteopløsninger kan medføre vækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer på dyserne. Mundskyllerens dyserum har en indbygget UV-lampe. Ultraviolet lys ved denne bølgelængde (275 nm) har bakteriedræbende virkning.

**EGENSKABER:**
1. 3 dyser medfølger.
2. Større vandbeholder - 130 ml.
3. Det sammenklappelige design gør mundskylleren lille og kompakt.
4. Desinfektionstilstand til dyserne.
5. Indbygget rum til opbevaring af dyser.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Montering og fjernelse af dyse Bemærk: hvis du finder urenheder i produktet ved første brug (i væskebeholder eller vandslange), kan produktet være beskadiget. Spor af ren væske indeni er derimod normalt. Det er destilleret vand fra afprøvning af mundskylleren. Vask produktet, og brug det uden bekymring. Tag dysen ud af opbevaringsrummet. Sæt den i åbningen; den magnetiske lås fastgør den automatisk. Træk dysen ud af åbningen for at fjerne den. Læg den i opbevaringsrummet, og luk låget sikkert.
2. Påfyldning Åbn støvlåget. Hold mundskylleren lodret, og hæld vand i. Luk derefter støvlåget. Rent postevand anbefales. Hvis vandet føles koldt, bruges stuetempereret vand på højst 40 °C. Saltvand eller et mundplejeprodukt kan også bruges efter lægens anbefaling.
3. Tænding og valg af tilstand Tryk på tilstandsknappen for at skifte. I skånsom tilstand lyser den første indikator. I kraftig tilstand lyser den anden. I pulserende tilstand lyser den tredje. Ved desinfektion lyser den sidste, indikator 4. Vælg den rette tilstand. Start gerne skånsomt, og øg intensiteten gradvist, efterhånden som du vænner dig til den.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Brug standarddysen. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Placér derefter dysen ud for tænderne, så vandstrålen står vinkelret på behandlingsområdet. Bemærk: følsomt tandkød bløder let. Ret ikke strålen direkte mod tandkødet!
2. Begynd ved de bagerste tænder, og gå frem mod fortænderne. Gennemgå hele tandrækken, og bliv kort ved hver tand, indtil tandkød og tandmellemrum er renset. Hvis du startede på ydersiden, gentages proceduren på indersiden. Gør dette for både over- og undermund. Bemærk: personer med følsomme tænder bør vælge skånsom tilstand.
3. Hold produktet lodret under brug, så dysens magnetiske lås ikke løsner sig og afbryder vandtilførslen.
4. Brug den parodontale dyse til tandkødslommer. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Hold dysen skråt, så spidsen vender mod tandkødsranden og ind i tandkødslommen. Rens efter anbefalingerne ovenfor.



5. Brug den skeformede dyse til tungen. Montér dysen, tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Før dysen hen over tungen med fejende bevægelser fra tungerod til spids. Rensningen bør tage 30 sekunder, svarende til ca. 5 gennemgange.
6. Desinfektion: læg dysen i dyserummet, og luk støvlåget.
7. Vælg den fjerde tilstand, desinfektion, med tilstandsknappen, og tryk derefter på tænd-knappen.
8. Desinfektionstilstanden aktiveres og steriliserer dyse og dyserum.
9. Se ikke direkte på den violette steriliseringslampe, da det kan skade synet.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt efter et måltid; ved pleje af tandreguleringsapparatur efter hvert måltid.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Forværring af parodontitis og akutte betændelsestilstande i munden.
2. Kraftig blødning fra tandkødet.
3. Umiddelbart efter operation i munden.

**ADVARSLER:**
1. Hold ladestikket tørt under opladning.
2. Tilslut ikke en strømkilde med anden spænding end den angivne.
3. Berør ikke opladeren med våde hænder.
4. Brug ikke et beskadiget eller fejlbehæftet apparat.
5. Ret ikke en vandstråle direkte mod tunge, ører eller andre kropsdele - vandtrykket kan skade dem.
6. Ved tandsygdom skal produktet bruges under tandlægens opsyn.
7. Produktet kan bruges sammen med et mundplejeprodukt eller et middel anbefalet af tandlægen.
8. Ikke-fagfolk må ikke skille apparatet ad eller stikke fremmedlegemer i dets åbninger.
9. Det anbefales ikke at bruge apparatet under barske udendørs forhold.
10. Hæld ikke jod, blegemiddel eller vanduopløselige aromaolier i beholderen; de påvirker ydeevnen og forkorter apparatets levetid.
11. Fjern alle smykker fra munden før brug.
12. Brug ikke produktet ved synlige sår på tungen eller i munden.
13. Hvis lægen ordinerer antibiotika, må produktet kun bruges efter lægens udtrykkelige anbefaling.
14. Ret ikke vandstrålen ind i ørerne for at undgå skader.
15. Lad ikke børn under 3 år bruge produktet.
16. Opbevar produktet tørt og rent, væk fra direkte sollys og varmekilder.

17. Oplad batteriet helt før længere opbevaring (over 3 måneder).
18. Forsøg ikke at tænde produktet uden vand i beholderen; det kan ødelægge apparatet.
19. Brug ikke vand over 50°C til rengøring af beholderen. Undgå deformation fra høj varme for at forlænge beholderens levetid. Produktet bør rengøres med stuetempereret vand under 40 °C eller rindende postevand.
20. Tilsæt ikke tandpasta, salt, faste mundskylletabletter eller andre kemikalier til vandet, da det kan tilstoppe og beskadige produktet.
21. Kontrollér før tilsætning af mundskyl eller åndefrisker, om produktet indeholder isopropylmyristat, som kan beskadige apparatet og påvirke normal drift.
22. Brug ikke fortyndere, alkoholer eller andre aggressive rengøringsmidler; de kan ændre produktets farve og give funktionsfejl.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) mundskyller, (2) standarddyse, (3) parodontal dyse, (4) tungerenser, (5) opbevaringspose, (6) vejledning, (7) USB-C-ladekabel.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** • skånsom tilstand - 50 minutter • kraftig tilstand - 45 minutter • pulstilstand - 100 minutter • desinfektionstilstand - 220 minutter

**SMART TIMER:** nej

**DRIFTSTID PR. FULD VANDBEHOLDER:** • skånsom tilstand: 35 ± 8 sekunder • kraftig tilstand: 30 ± 8 sekunder • pulstilstand: 65 ± 10 sekunder

**EFFEKT:** • skånsom tilstand: 392-637 kPa • kraftig tilstand: 686-931 kPa • pulstilstand: 588-833 kPa

**IMPULSER PR. MINUT:** 1600±20%

**VANDBEHOLDERENS KAPACITET:** 130 ml

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7



# MIGA PRO - BÆRBAR MUNDSKYLLER

Hjælper med at forebygge tand-kødssygdomme

Fjerner madrester

Hjælper med at forebygge caries

Renser svært tilgængelige steder i munden

Pleje af tandreguleringsapparatur

**PROBLEMOMRÅDER:** plak, caries, madrester i tandreguleringsapparatur, tandkødssygdom og dårlig ånde.

**MATERIALER:** MS-plast, ABS-plast.

**VÆGT:** 260 g.

**FUNKTIONER:**

Væsken renser de mest utilgængelige steder, så caries kan forebygges, og tandreguleringsapparatur kan rengøres.

Mundskyllerens væsketryk masserer tandkødet og stimulerer dets blodcirkulation og heling.

Der medfølger 3 dysetyper med hver sin funktion:

Standarddysen bruges til daglig tandrensning. Den buede spids hjælper med at skylle plak og madrester væk.

Den ortodontiske dyse er beregnet til rengøring af tandbøjler. Ud over vandåbningen har den en børste med stive børstehår for enden. Den renser bøjlernes brackets og skyller plak og madrester væk.

Den PARODONTALE DYSE bruges til tandkødslommer (de opstår, når betændt tandkød løsner sig fra tanden og danner en lomme). Den har en blød gummispids til tandkødspleje.

Desinfektionstilstanden steriliserer beholderen. Kontakt med vand og urteopløsninger kan medføre vækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i mundskylleren. En indbygget UV-lampe steriliserer beholderen.

**EGENSKABER:**
1. 3 dyser medfølger.
2. Større vandbeholder - 180 ml.
3. Det sammenklappelige design gør mundskylleren kompakt og nem at transportere.
4. Desinfektionstilstand til beholderen.
5. Indbygget rum til opbevaring af dyser.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Montering og fjernelse af dyse Tag dysen ud af opbevaringsrummet. Sæt den i åbningen, til den klikker på plads. Fjern dysen ved at trykke på udløserknappen og trække den ud. Læg dysen i opbevaringsrummet, og luk sikkert.
2. Påfyldning Åbn beholderens låg. Hold mundskylleren vandret, og hæld vand i. Luk låget efter påfyldning. Rent destilleret vand anbefales. Hvis vandet føles koldt, bruges stuetempereret vand på højst 40 °C. Saltvand eller et mundplejeprodukt kan også bruges efter lægens anbefaling.
3. Tænding og valg af tilstand Tryk kort på tænd-knappen for at starte apparatet. Tryk kort igen for at skifte rensetilstand. Et langt tryk (3 sekunder) på tilstandsknappen ændrer hastigheden. Sluk apparatet efter brug med et langt tryk (3 sekunder). Ved slukning gemmer det den seneste tilstand og starter automatisk i den næste gang.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Brug standarddysen. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand og hastighed. Placér derefter dysen ud for tænderne, så vandstrålen står vinkelret på behandlingsområdet. Bemærk: følsomt tandkød bløder let. Ret ikke strålen direkte mod tandkødet!
2. Begynd ved de bagerste tænder, og gå frem mod fortænderne. Gennemgå hele tandrækken, og bliv kort ved hver tand, indtil tandkød og tandmellemrum er renset. Hvis du startede på ydersiden, gentages proceduren på indersiden. Gør dette for både over- og undermund. Bemærk: personer med følsomme tænder bør vælge skånsom tilstand.
3. Brug den parodontale dyse til tandkødslommer. Tryk på tænd-knappen, og vælg tilstand. Hold dysen skråt, så spidsen vender mod tandkødsranden og ind i tandkødslommen. Rens efter anbefalingerne ovenfor.
4. Brug den ortodontiske dyse til tandbøjler. Ud over åbningen til vandstrålen har den stive børstehår for enden, som renser brackets og skyller plak og madrester væk.
5. Desinfektion: fold mundskylleren sammen, så UV-rensningen automatisk starter i 10 minutter.



6. Se ikke direkte på den violette steriliseringslampe, da det kan skade synet.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt efter et måltid; ved pleje af tandreguleringsapparatur efter hvert måltid.

**BRUGSVARIGHED:**
**Ubegrænset.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Forværring af parodontitis og akutte betændelsestilstande i munden.
2. Kraftig blødning fra tandkødet.
3. Umiddelbart efter operation i munden.

**ADVARSLER:**
1. Hold ladestikket tørt under opladning.
2. Tilslut ikke en strømkilde med anden spænding end den angivne.
3. Berør ikke opladeren med våde hænder.
4. Brug ikke et beskadiget eller fejlbehæftet apparat.
5. Ret ikke en vandstråle direkte mod tunge, ører eller andre kropsdele - vandtrykket kan skade dem.
6. Ved tandsygdom skal produktet bruges under tandlægens opsyn.
7. Produktet kan bruges sammen med et mundplejeprodukt eller et middel anbefalet af tandlægen.
8. Ikke-fagfolk må ikke skille apparatet ad eller stikke fremmedlegemer i dets åbninger.
9. Det anbefales ikke at bruge apparatet under barske udendørs forhold.
10. Hæld ikke jod, blegemiddel eller vanduopløselige aromaolier i beholderen; de påvirker ydeevnen og forkorter apparatets levetid.
11. Fjern alle smykker fra munden før brug.
12. Brug ikke produktet ved synlige sår på tungen eller i munden.
13. Hvis lægen ordinerer antibiotika, må produktet kun bruges efter lægens udtrykkelige anbefaling.
14. Ret ikke vandstrålen ind i ørerne for at undgå skader.
15. Lad ikke børn under 3 år bruge produktet.
16. Opbevar produktet tørt og rent, væk fra direkte sollys og varmekilder.
17. Oplad batteriet helt før længere opbevaring (over 3 måneder).
18. Forsøg ikke at tænde produktet uden vand i beholderen; det kan ødelægge apparatet.
19. Brug ikke vand over 40°C til rengøring af beholderen. Undgå deformation fra høj varme for at forlænge beholderens levetid. Produktet bør rengøres med stuetempereret vand under 40 °C eller rindende postevand.
20. Tilsæt ikke tandpasta, salt, faste mundskylletabletter eller andre kemikalier til vandet, da det kan tilstoppe og beskadige produktet.

21. Kontrollér før tilsætning af mundskyl eller åndefrisker, om produktet indeholder isopropylmyristat, som kan beskadige apparatet og påvirke normal drift.
22. Brug ikke fortyndere, alkoholer eller andre aggressive rengøringsmidler; de kan ændre produktets farve og give funktionsfejl.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) mundskyller, (2) standarddyse, (3) parodontal dyse, 4. ortodontisk dyse, 5) opbevaringspose, 6) vejledning, 7) USB-DC-ladekabel.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 4 h

**SMART TIMER:** nej

**DRIFTSTID I HVER TILSTAND OG VED HVER HASTIGHED:**
STANDARDTILSTAND
• Lav hastighed - 96 minutter
• Middelhastighed: 72 minutter
Høj hastighed: 59 minutter PULSERENDE TILSTAND
• Lav hastighed - 133 minutter
• Middelhastighed: 103 minutter
• Høj hastighed - 84 minutter
• SKÅNSOM TILSTAND
• Lav hastighed - 140 minutter
• Middelhastighed: 96 minutter

**IMPULSFREKVENS I HVER TILSTAND OG VED HVER HASTIGHED:**
STANDARDTILSTAND
• Lav hastighed - 1440/minut
• Middelhastighed: 1920/minut
• Høj hastighed: 2400/minut
• PULSERENDE TILSTAND
Lav hastighed - 1440/min. ± 10%
Middelhastighed - 1920/min. ± 10%
Høj hastighed - 2400/min. ± 10%
• SKÅNSOM TILSTAND
Lav hastighed - 960/min. ± 10%
• Middelhastighed: 1440/min ±10%
• Høj hastighed - 1920/min. ± 10%

**VANDBEHOLDERENS KAPACITET:** 180 ml

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7

**BRUGSTID (TØMNING) FOR EN FULD BEHOLDER:**
STANDARDTILSTAND
• Lav hastighed - 116 sekunder
Middelhastighed - 68 sekunder Høj hastighed - 55 sekunder



PULSERENDE TILSTAND
Lav hastighed - 144 sekunder
• Middelhastighed: 93 sekunder
• Høj hastighed - 65 sekunder SKÅNSOM TILSTAND
• Lav hastighed - 143 sekunder
Middelhastighed: 92 sekunder
• Høj hastighed - 65 sekunder

**EFFEKT:** Standardtilstand • Lav hastighed - 339.2 kPa • Mellemhastighed - 661.2 kPa • Høj hastighed - 901.1 kPa. Pulstilstand • Lav hastighed - 315.1 kPa • Mellemhastighed - 460.6 kPa • Høj hastighed - 776.3 kPa. Skånsom tilstand • Lav hastighed - 133.1 kPa • Mellemhastighed - 375.8 kPa • Høj hastighed - 655.0 kPa




# MIO2 - MIKROSTRØMSMASSAGEAPPARAT MED EMS

Forbedrer hudens fasthed

Reducerer aldringstegn

Udglatter rynker

Modvirker hævelse og pigmentering

**PROBLEMOMRÅDER:** mimiske rynker, hævelser i ansigtet og mørke rande, trist og slap hud, hængende kinder, aldersforandringer, udvidede porer og pigmentering.

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast, zinklegering.

**VÆGT:** massageapparat - 80 g, base - 70 g.

**FUNKTIONER:**

EMS - elektrisk strøm til muskelstimulation, som trænger dybt ned i hudlagene og når muskellaget. Ved at stimulere muskelsammentrækninger fremmer EMS opstramning, giver en løftende effekt, øger produktionen af kollagen og elastin samt hudens fasthed og elasticitet og reducerer hævelser.

Funktionen giver massage ved 42 + / - 3 °C og øger derved blod- og lymfecirkulationen, aktiverer stofskifteprocesser og øger vævets iltforsyning. Det forbedrer hudtonen, udglatter huden og gør aldringstegn mindre synlige.

Vibration er en mekanisk påvirkning, som fremmer cellernes stofskifteprocesser, stimulerer udskillelsen af toksiner og fremmer hudens regenerering.

**EGENSKABER:**
1. 3 tilstande: EMS, varme, EMS/vibration/varme.
2. Mærkbar strøm - i det opdaterede WAU-apparat har ingeniørerne tilpasset strømstyrke og impulsfrekvens, så EMS både giver en synlig effekt efter brug og kan mærkes under behandlingen.
3. To uafhængige kanaler (2 elektroder som strømkilder) øger dækningsområdet og giver tydeligere muskelpåvirkning og en mere mærkbar strøm.
4. Trådløs opladning via ladebase.
5. Enkel betjening - 1 knap styrer både tænd/sluk og skift af tilstand.
6. MIO2's buede form følger ansigtets konturer, og de kegleformede hjørner hjælper med at massere akupunkturpunkter og afslappe musklerne. Formen gør også apparatet egnet til gua sha-massage.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. MIO2 betjenes med 1 knap.
2. Tænd apparatet med et langt tryk på tænd/sluk-knappen.
3. Vælg tilstand med et kort tryk på tænd/sluk-knappen:
• Blå indikator - EMS;
• Rød indikator - varme;
Hvid indikator - kombination af EMS, varme og vibration.
4. Sluk massageapparatet med et langt tryk på tænd/sluk-knappen.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør ledende massagegel på huden. Læg apparatets behandlingsflade mod massageområdet.
2. Massér ansigt og hals nedefra og op i overensstemmelse med ansigtsmusklernes anatomiske placering.
3. MIO2's massageflade kan bruges til gua sha-massage langs massagelinjerne.
4. Apparatets kegleformede hjørne bruges til massage af akupunkturpunkter. Berør disse punkter let, og lav en lille cirkelbevægelse.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | BEHANDLINGSFORLØBETS HYPPIGHED | |
|---|---|---|---|---|
| TÆT HUD / HÆVELSER / SLAP HUD | Aften, 2 anden halvdel af dagen | EMS - 3-5 minutter EMS + varme + vibration - 5 minutter | 2-3 gange om ugen | 10 uger Pause: 2 uger Gentag forløbet på 10 uger Fortløbende |
| TØR HUD MED FINE LINJER | Om morgenen. | Varme - 2-3 minutter EMS - 3-4 minutter EMS + varme + vibration - 3 minutter | 1-2 gange om ugen | 10 uger Pause: 2 uger Gentag forløbet på 10 uger Fortløbende |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Brud på hudens overflade.
2. Hudens helingsperiode efter kosmetiske behandlinger (f.eks. laserresurfacing, kemisk peeling, mesoterapi osv.).
3. Indtagelse af steroidmedicin.

**ADVARSLER:**
1. Nedsænk ikke apparatet i vand.
2. Oplad ikke apparatet i fugtige omgivelser (f.eks. ved et fyldt badekar, brusebad eller swimmingpool).
3. Kast ikke apparatet i ild.
4. Brug ikke apparatet, hvis massageapparatet eller dets dele er beskadiget.
5. Oplad massageapparatet helt til 100% mindst én gang hver 2. måned - det forlænger batteriets levetid.
6. Apparatet er ikke beregnet til personer under 12 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) massageapparat, (2) ladebase, (3) USB-C-ladekabel,
4. opbevaringspose, (5) klud, (6) vejledning.



**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** massageapparat 136x54x22 mm, opladningsbase 85x78x52 mm

**STRØMKILDE:** litiumionbatteri

**BATTERIKAPACITET:** 500 mAh

**DRIFTSSPÆNDING:** 3,7 V

**EFFEKT:** 5 W

**OPLADNINGSTID:** 2,5 h

**DRIFTSTID:** 50 minutter fra fuld opladning

**SMART TIMER:** 10 min

**VIBRATIONSHASTIGHED:** 1200 omdrejninger pr. minut

**EMS-INTENSITET:** 2 mA

**STRØMFREKVENS:** 2,5 kHz

**BØLGEFORM:** bifasisk symmetrisk rektangulær bølgeform

**OPVARMNINGSTEMPERATUR:** 42 ± 3 °C

**VANDBESTANDIGHED:** IPX4



# MIRA - LØFTENDE MASSAGEAPPARAT TIL ANSIGT OG HALS

Reducerer hævelser

Løfter ansigt og hals

Reducerer rynker

Forbedrer hudens fasthed

Modvirker akne

**PROBLEMOMRÅDER:** rynker, slap og hængende hud, tab af glød og forringet hudtone, hævelser, rødme, irritation og betændelse.

**MATERIALER:** PC-plast, ABS-plast, silikone, zinklegering.

**VÆGT:** massageapparat - 164 g, base - 115 g

**FUNKTIONER:**

EMS er elektrisk strøm til muskelstimulation, som trænger dybt ned i hudlagene og når muskellaget. Ved at stimulere muskelsammentrækninger fremmer EMS opstramning, giver en løftende effekt, øger produktionen af kollagen og elastin samt hudens fasthed og elasticitet og reducerer hævelser.

VIBRATION - mekaniske svingninger (=impulser), som forbedrer lymfedrænage og mikrocirkulation (blod- og lymfebevægelse) i vævet og afslapper muskelspændinger, så hævelser reduceres, hudtonen forbedres, og kosmetik trænger bedre ind.

LED - Terapi - hver farve svarer til en bestemt bølgelængde i spektret af synligt lys. Ved at virke på huden i forskellige dybder absorberes lyset af hudreceptorer, hvilket aktiverer naturlige processer inde i cellen og forårsager en vis hudreaktion. Rødt LED-lys - trænger dybt ind i huden, absorberes af mitokondrier og aktiverer produktionen af kollagen og elastin af fibroblaster. Resultatet af disse processer er udtrykt i følgende æstetiske effekter: foryngelse, elasticitet, reduktion af rynker. Blåt LED-lys absorberes af porfyrinbakterier P. acnes, hvilket fører til dannelsen af singlet-ilt, der ødelægger bakterier og derved bekæmper acne, betændelse og normaliserer talgkirtlerne. Grønt LED-lys - beroliger huden, forsnævrer blodkarrene og forbedrer lymfegennemstrømningen. God til følsom og reaktiv hud. Effektiv til at eliminere rødme, reducere hævelse, bekæmpe couperosis.

Varme - giver vasodilatation, dvs. udvidelse af små blodkar. Det øger blodtilførslen til behandlingsområdet. Den øgede cirkulation fremskynder udskillelsen af stofskifteprodukter og forbedrer hudcellernes næring. Øget blodgennemstrømning og temperatur aktiverer desuden svedgangene. Det „åbner" fysisk porerne og forbereder dem til rensning eller kosmetik.

Kulde trækker blodkarrene sammen, mindsker blodtilførslen til hudoverfladen og reducerer kapillærvæggenes gennemtrængelighed - det reducerer rødme (via mindre blodtilførsel) og hævelser (via mindre væskeudsivning fra kar til væv).

**EGENSKABER:**
1. 5 teknologier. Alsidighed. 1 apparat til alle problemer giver besparelse ved købet.
2. Apparatet gør det muligt at kombinere tilstandene og tilpasse plejen til hudens behov.
3. 3 EMS-niveauer til behagelig og smertefri påvirkning.
4. 3 fototerapifarver til forskellige problemer.
5. Ergonomisk form: det fyldige håndtag giver et behageligt greb, så du kan koncentrere dig om massagen.
6. Smart teknologi. Massageapparatet har en smart timer og slukker automatisk efter 10 minutters massage. Kuldetilstanden varer op til 3 minutter, hvilket sikrer sikker brug og effektiv teknologi.
7. Alsidig behandlingsflade. Den bueformede flade kan behandle mange områder: hals, hage (ansigtskonturer), kinder, under øjnene og pande.
8. Behandlingsfladens materiale. MIRA-hovedet har to aktive stålelektroder med guldbelægning. Guld har den tredjehøjeste elektriske ledningsevne efter sølv og kobber. Elektrodernes særlige belægning fremmer strømledningen i apparatet.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tænd apparatet med et langt tryk på den midterste knap (LED-knappen).
2. Et kort tryk på LED-knappen skifter lyset for fototerapi. Det første tryk involverer rødt LED-lys, det andet tryk blåt LED-lys, det tredje tryk grønt, det fjerde tryk slukker for fototerapifunktionen.
3. Ved hvert skift af fototerapifarve lyser en diode med den tilsvarende farve omkring LED-knappen.
4. Et kort tryk på den øverste knap (EMS-knappen) aktiverer EMS. Korte tryk vælger intensiteten. Første tryk: niveau 1 (svagt), andet tryk: niveau 2 (middel), tredje tryk: niveau 3 (stærkt). Et nyt tryk slukker EMS helt.
5. Ved hvert tilstandsskift viser displayet strømintensiteten fra svagest til stærkest. Niveau 1: 1 diode, niveau 2: 2 dioder, niveau 3: alle 3 dioder lyser.
6. Et langt tryk på den øverste knap (EMS-knappen) aktiverer bølgevibration. Et nyt langt tryk slukker vibrationsfunktionen.
7. Et kort tryk på den nederste knap (temperaturknap) tænder for den kolde tilstand. Den virker i 3 minutter og lukker automatisk ned efter dette tidspunkt. Dette beskytter enheden mod overophedning og giver dig mulighed for at arbejde ved den koldeste temperatur i den koldest mulige tilstand. Når du tænder for den kolde tilstand på enhedens display, lyser det blå LED-lystermometerikon.
8. Tryk igen på temperaturknappen for at skifte fra kulde til varme. Ved varme lyser det røde termometer på displayet.



9. Massageapparatet har en smart timer og slukker selv efter 10 minutters brug.
10. Hold LED-knappen inde for at slukke apparatet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør ledende kontaktgel eller et vandbaseret plejeprodukt med geltekstur på huden for bedre strømledning og maksimale resultater.
2. Tænd apparatet. Indstil de ønskede tilstande.
3. Begynd ved halsen. Følg lodrette linjer fra øreflippen til kravebenet for at „åbne" lymfebanerne.
4. Massér derefter ansigtet langs massagelinjerne fra midten og udad. Bevægelsen går skråt opad for at modvirke tyngdekraften og stramme musklerne. Arbejd nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen i panden).
5. Pandens vandrette rynker udglattes ved lodrette opadgående bevægelser.
6. Start gerne massagen med varme og vibration. Kombinationen forbereder huden, så den bliver mest modtagelig for aktive ingredienser og stimulation. Forberedelsen afslapper muskler, åbner porerne til rensning og øger blodcirkulation og lymfedrænage for at forberede cellerne. Varighed: op til 2 minutter.
7. Dernæst kommer hoveddelen af proceduren, hvor celler og muskler stimuleres, blodcirkulationen forbedres. Målet med denne fase er at skabe nyt kollagen og elastin, træne muskler (løft) og eliminere specifikke problemer (for eksempel acne eller pigmentering). Tænd for EMS-tilstanden, indstil et behageligt intensitetsniveau for dig. Indstil LED-terapi. Start med et rødt LED-lys.
8. Efter den primære foryngende effekt for at løse et specifikt problem, kan du skifte det røde LED-lys til blåt (når du arbejder med acne og bekæmpelse af fedtindhold) eller grønt (til at berolige huden og bekæmpe couperosis / rødme). Den samlede varighed af scenen er 6 minutter.
9. Afslut med kuldefunktionen for at fastholde resultatet. Kulden beroliger huden, reducerer resterende rødme og fastholder kosmetikkens aktive ingredienser i huden. Afslutningen varer op til 2 minutter.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| **FEDTET ELLER KOMBINERET HUD / UDVIDEDE PORER / FEDTET GLANS / MÆRKER EFTER AKNE** | MORGEN | EMS + Blå LED lys + Kold. Start med kold tilstand (2 minutter), og tilføj derefter EMS og lys. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2-3 gange om ugen i 10-15 minutter | BEHANDLINGS-KURS: 1 måned Pause: 2-3 måneder Mellem kurserne: blåt LED-lys 2-3 gange om ugen i 10-15 minutter |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SLAP HUD / ALDRING MED HÆVELSER / MORGENHÆVELSER** | MORGEN | EMS + Kold. Start med kold tilstand (2 minutter), og tilføj derefter EMS. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 3-4 gange om ugen i 10-15 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1 måned. Pause: 2-3 måneder. |
| **TRIST HUD / TAB AF FASTHED OG SPÆNDSTIGHED** | Morgen / aften (når som helst) | EMS + rødt LED-lys + varme (10-15 minutter), derefter koldt (2-3 minutter). Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2-3 gange om ugen, 10-15 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1 måned. Gentagelse: 4-5 måneder. Mellem forløbene: 1 vedligeholdende behandling om ugen |
| **TØR / DEHYDRERET HUD** | AFTEN | EMS + varme. Start med varmetilstand (2 minutter), og tilføj derefter EMS. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2 gange om ugen, 10-15 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1 måned. Gentagelse: 4-5 måneder. Mellem forløbene: Vedligeholdende behandling 1 gang hver 2. uge |
| **MODEN HUD / TAB AF FASTHED OG SPÆNDSTIGHED** | AFTEN | EMS + Rødt LED lys + Varme. Start med varmetilstand (2 minutter), og tilføj derefter EMS og lys. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2-3 gange om ugen, 15 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1-1.5 måneder. Gentagelse: 4-5 måneder. Mellem forløbene: Vedligeholdende behandling 1-2 gange om måneden + rødt LED-lys 3 gange om ugen (15 minutter) |
| **FORHØJET MUSKELTONUS / SPÆNDINGER** | AFTEN | EMS (kun intensitetsniveau 1) + Grønt LED-lys. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2-3 gange om ugen, 15 minutter. Bevæg dig i retning af muskelfibrene. | BEHANDLINGS-FORLØB: 1-1.5 måneder. Gentagelse: Efter et halvt år eller ved en følelse af muskelspænding |
| **FØLSOM HUD / COUPEROSE I RO** | Morgen / aften (når som helst) | EMS (kun intensitetsniveau 1) + Grønt LED-lys. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. | 2 gange om ugen, 10 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1 måned. Gentagelse: Efter 4-5 måneder. Mellem forløbene: Vedligeholdende behandling 1 gang hver 2-3. uge |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HALS** | AFTEN | EMS + Rødt LED lys + Varme. Start med varmetilstand (2 minutter), og tilføj derefter EMS og lys. Brug den minimale EMS-intensitet til op til 3 behandlinger, og øg derefter gradvist. Brug kun, hvis der ikke er kontraindikationer såsom skjoldbruskkirtelsygdom. Undgå altid skjoldbruskkirtlen og sinus carotis-området ved siden af skjoldbruskkirtlen, hvor pulsen kan mærkes. | 2-3 gange om ugen, 10-15 minutter | BEHANDLINGS-FORLØB: 1 måned. Gentagelse: 4 måneder. Mellem forløbene: Vedligeholdende behandling 1 gang hver 2. uge |

**KONTRAINDIKATIONER:**

1. Dette apparat er kun til personlig hjemmebrug og er ikke medicinsk udstyr.
2. Følgende personer må kun bruge apparatet efter anvisning fra en læge:
- Gravide og ammende kvinder.
- Personer med følsom hud eller hudsygdomme.

Personer med implanteret elektronisk medicinsk udstyr (f.eks. pacemaker).
- Personer med diabetes eller kredsløbsforstyrrelser.

3. Brug ikke apparatet på følgende områder:
- Beskadiget hud (sår, betændelse, eksem).
- Slimhinder (øjne, mund).

**ADVARSLER:**

1. Hold ikke apparatet for længe på samme hudområde i kuldetilstand, da det kan give forfrysning.
2. Stop straks varmebehandlingen, hvis du mærker overophedning, for at undgå forbrændinger.
3. Børn må kun bruge apparatet under opsyn af voksne.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) MIRA-massageapparat, (2) dæksel til behandlingsfladen, (3) ladebase, 4. USB-Type C-kabel, 5) vejledning, 6) opbevaringsposer.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** 179.5x72x48.4 mm (massageapparat), 81x69.8x64.8 mm (base)

**EFFEKT:** 10 W

**DRIFTSSPÆNDING:** 3,7 V

**STRØMKILDE:** indbygget litiumpolymerbatteri

**BATTERIKAPACITET:** 1350 mAh

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** 35 min

**SMART TIMER:** 10 minutter Varmetilstand - 5 minutter Kuldetilstand - 3 minutter

**VIBRATIONSHASTIGHED:** 7000 omdrejninger pr. minut

**STRØM:** Niveau 1 - 1.9 mA Niveau 2 - 2.48 mA Niveau 3 - 3.44 mA

**STRØMFREKVENS:** Svagt niveau - 20 kHz Middelniveau - 25.2 kHz Højt niveau - 30.6 kHz

**BØLGELÆNGDE:** Rødt LED-lys - 630 nm Blåt LED-lys - 460 nm Grønt LED-lys - 520 nm

**BØLGEFORM:** bifasisk symmetrisk bølgeform

**LYSINTENSITET:**
Rødt LED-lys - 10 mW/cm2 Blåt LED-lys - 24 mW/cm2 Grønt LED-lys - 21 mW/cm2

**VANDBESTANDIGHED:** IPX3



# MORI BLACK - ELEKTRISK SONISK TAND-BØRSTE

Styrker tandkødet

Renser tænderne

Fjerner tandsten

**PROBLEMOMRÅDER:** tandbørstning, plak, dårlig ånde og tandkødssygdom.

**MATERIALER: plast.**

**VÆGT:** 200 g.

**FUNKTIONER:**
Tandbørsten arbejder med højfrekvent vibration. Det er ikke lyden, men børstehårenes hurtige vibration, der renser; den sættes i gang af en lydbølge (=højfrekvent vibration). Børstehårene udfører hurtige fejende bevægelser fra tandkødet til tandens kant, og den høje hastighed skaber en strøm af mikrobobler fra spyt, vand og tandpasta. Denne dynamiske væskestrøm renser effektivt selv svært tilgængelige steder i munden.

**EGENSKABER:**
1. 5 tilstande: fra skånsom (31000 svingninger) til mest intensiv (48000 svingninger).
2. 2 børstehoveder medfølger med bløde og middelhårde børstehår.
3. Lydsignaler minder om at skifte børsteområde.
4. De middelhårde børstehår skifter farve som påmindelse om udskiftning af hovedet.
5. Hukommelsesfunktion.
6. Lang ledning til ladebasen.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Placér børstehovedet lige over elmotorens spidsaksel (drivakslen), og montér det. Vigtigt: drej ikke hovedet under montering.
2. Tænd tandbørsten med et kort tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen.
3. Gentagne korte tryk skifter tilstand i denne rækkefølge: Sensitive (skånsom), Gum care (tandkødspleje), Polish (polering), White (blegning), Clean (rensning).
4. Tandbørsten holder pause hvert 30. sekund for at minde om at skifte børsteområde.
5. Efter 2 minutter slutter den automatiske børstetid, og børsten slukker.
6. Tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen for selv at slukke børsten.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Montér børstehovedet.
2. Fugt børstehovedet med vand, og påfør den nødvendige mængde tandpasta.
3. Tænd tandbørsten.
4. Før børstehovedet ind i munden, og hold det i en vinkel på 45 grader mod tandkødet. Tryk på tænd-knappen, og vælg en behagelig tilstand.
5. Begynd tandbørstningen. Før hovedet over tanden med fejende bevægelser fra tandens base til dens kant.
6. Tandlæger anbefaler mindst 2 minutters tandbørstning. Munden kan deles i 4 områder, så hver fjerdedel (kvadrant) børstes i 30 sekunder.
For at følge anbefalingen har børsten en timer hvert 30. sekund:
Børsten stopper i nogle sekunder. Efter 2 minutter slutter den automatiske børstetid, og den slukker.
7. Skyl børstehovedet efter brug, og lad det lufttørre. Tandbørstens kabinet kan også skylles med vand.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt, 1 børstning på 2 minutter.

**BRUGSVARIGHED:**
1 børstehoved kan bruges i 3 måneder.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Infektiøs parodontitis.
2. Perioden efter operation eller sårheling i munden.
3. Øget tandfølsomhed.
4. Patologisk bevægelighed af tænderne.
5. Ikke beregnet til børn.

**ADVARSLER:**
1. Skyl den soniske tandbørstes hoved med vand efter hver brug.
2. Børstens kabinet kan rengøres direkte med vand.
3. Læg ikke metalgenstande på ladebasen under opladning for at undgå ulykker.
4. Brug ikke børsten, hvis kabinet eller hoved er beskadiget.
5. Holdes væk fra varmekilder.
6. Saml eller skil ikke selv en elektrisk sonisk tandbørste ad.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) tandbørstekabinet, (2) hoved med bløde børstehår,
3. hoved med middelhårde børstehår, (4) induktionsladebase,
5. vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 12 h

**DRIFTSTID:** 240 min

**SMART TIMER:** 2 min



**TILSTANDE OG VIBRATION:**
• Skånsom - 31000 omdrejninger pr. minut
tandkødspleje - 35000 omdrejninger pr. minut
• Polering - 41000 omdrejninger pr. minut
• Blegning - 45000 omdrejninger pr. minut
Rensning - 48000 omdrejninger pr. minut

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7



# MORI 2.0 - ELEKTRISK SONISK TANDBØRSTE

Styrker tandkødet

Renser tænderne

Fjerner tandsten

Hjælper med at forebygge tandkødsbetændelse

**PROBLEMOMRÅDER:** tandbørstning, plak, dårlig ånde og tandkødssygdom.

**MATERIALER: PC-plast.**

**VÆGT:** 110 g.

**FUNKTIONER:**
Tandbørsten arbejder med højfrekvent vibration. Det er ikke lyden, men børstehårenes hurtige vibration, udløst af en lydbølge, der renser.

Børsten har en tryktransducer, som omdanner fysisk tryk til et elektrisk signal.

MORI 2.0 kan udarbejde 3D-kort til analyse af børstningen. Desinfektionsetuiet har en UV-sterilisator, som dræber mikroorganismer og virus.

**EGENSKABER:**
1. Smart timer.
2. 5 professionelle børstetilstande:
• Skånsom (til følsomme tænder)
• Rensning (standard)
• Hvid emalje (blegning)
• Polering
• Massage
3. Stænkbeskyttelse.
4. Intensitetsjustering: hver tilstand har 5 niveauer (10, 30, 50, 70 og 90), så du kan vælge en behagelig indstilling.
5. Interaktiv 3D-visning af børsteområderne.
6. Etui med UV-sterilisering.
7. Påmindelse om udskiftning af børstehoved.
8. Ladeindikator og overvågning under opladning.
9. Tryksensor med LED-indikation
10. Tre udskiftelige børstehoveder til forskellige former for rensning
• Klassisk børstehoved til daglig hygiejne
• Blegehoved med forstærket poleringseffekt
• Hoved med bløde børstehår til følsomme tænder

11. Hukommelsesfunktion.
12. Automatisk registrering af børstehovedet.
13. Automatisk aktivering.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. MORI 2.0-tandbørsten har automatisk tænding:
Børsten tænder, når du griber om kabinettet med håndfladen.
2. Tænd børsten med et kort tryk på tænd/sluk/funktionsvalg-knappen.
3. Bladr i menuen med knappen til funktionsskift; vælg et afsnit med et kort tryk på tænd/sluk/funktionsvalg-knappen.
4. Bladr til „Menu / Setting" (menu/indstillinger), og åbn punktet. Vælg „3D OFF / 3D OFF" i menuen. Aktivér funktionen ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen.
5. Vælg et sprog. MORI 2.0 er klar til videre indstilling og brug.
6. Vælg det ønskede hoved, placér det lige over elmotorens spidsaksel (drivakslen), og montér det. Fortsæt derefter indstillingen af MORI 2.0 efter vejledningen.
7. Gå til indstillinger, og vælg „Cleaning time" (børstetid). Indstil tiden til 2/3/4 minutter eller „Unlimited" (ubegrænset) med funktionsvalg-knappen.
8. Gå fra „Settings" (indstillinger) tilbage til hovedmenuen ved at vælge „Back" (tilbage).
9. Vælg børstetilstand i menuen.
10. Vælg derefter intensitet med funktionsvalg-knappen. MORI 2.0 har 5 effektniveauer i hver tilstand: 10, 30, 50, 70 og 90.
11. MORI 2.0 har hukommelsesfunktion. Hvis en tilstand bruges i mere end 10 sekunder, gemmes den og aktiveres ved næste brug.
12. MORI 2.0 holder en kort pause som påmindelse om at skifte børsteområde. Ved 2 minutters børstetid stopper den hvert 30. sekund; ved 3 minutter hvert 45. sekund; ved 4 minutter hvert minut. Ved ubegrænset børstetid („Unlimited") holder børsten ingen pauser.
13. MORI 2.0 har en tryksensor. Bag på børsten er en lysindikator, som ændrer farve og vibrationstype og giver en „du-du"-lyd for at styre trykket under børstningen.
14. Børsten slukker efter den automatiske børstetid. Hvis du selv vil stoppe den, skal du efter 5 sekunders børstning trykke kort på tænd/sluk-knappen.
15. Efter børstning viser displayet det resterende batteriniveau og børsteresultatet med et kort over munden.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Montér børstehovedet.
2. Fugt børstehovedet med vand, og påfør den nødvendige mængde tandpasta.
3. Før børstehovedet ind i munden, og hold det i en vinkel på 45 grader mod tandkødet. Læg børstehårene let mod tandkødsranden eller lidt over den.
4. Tænd børsten, og vælg en behagelig tilstand.
5. Begynd tandbørstningen. Før hovedet over tanden med fejende bevægelser fra tandens base til dens kant.
6. Ved indersiden af overmundens tænder skal tandbørsten holdes lodret, så hovedet står lodret på tanden og renser hver tand.
7. Børsten stopper efter den indstillede tid. Displayet viser først resterende batteri og derefter et 3D-kort over munden med børsteresultatet.



8. Analysér behandlingen på 3D-kortet for at opnå en perfekt rensning.
9. Skyl børstehovedet efter brug, og lad det lufttørre. Tandbørstens kabinet kan også skylles med vand.

**BRUGSHYPPIGHED:**
2 gange dagligt, 1 børstning på 2 minutter.

**BRUGSVARIGHED:**
1 børstehoved kan bruges i 3 måneder.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Infektiøs parodontitis.
2. Perioden efter operation eller sårheling i munden.
3. Øget tandfølsomhed.
4. Patologisk bevægelighed af tænderne.
5. Ikke beregnet til børn.

**ADVARSLER:**
1. MORI 2.0 kan bruges af børn over 8 år og personer med sensoriske, fysiske og mentale funktionsnedsættelser, hvis de har fået brugsvejledning og kender sikker brug og mulige farer ved forkert brug.
2. Apparatet må ikke bruges som legetøj.
3. Børns tandbørstning og brug skal kun ske under opsyn af en voksen.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) tandbørstekabinet, udskiftelige hoveder: (2) til følsomme tænder, (3) blegehoved, (4) rensehoved, (5) Type-C-ladekabel,
6. opbevaringspose, 7) vejledning, 8) etui til desinfektion af hovederne.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 8 h

**SMART TIMER:** 2 min

**DRIFTSTID:** • Skånsom tilstand - 1200 minutter • Rensetilstand - 250 minutter • Tandblegning - 400 minutter • Poleringstilstand - 500 minutter • Massagetilstand - 400 minutter

**TILSTANDE OG SVINGNINGSFREKVENS:**
• Skånsom (28000 vibrationer/minut)
Rensning (37000 vibrationer/minut)
• Hvid emalje (41000 vibrationer/minut)
Polering (36000 svingninger/minut)
Massage (35000 vibrationer/minut)

**VANDBESTANDIGHED:** IPX7




# NEO - APPARAT TIL HUDFORYNGELSE

Løftende effekt

Målrettet hudproblemer

Genopretter hudens fasthed og elasticitet

Reducerer pigmentering

Reducerer ar

**PROBLEMOMRÅDER:** aldersbetingede ændringer i ansigtskonturerne, rynker, slap hud, pigmentering, akne, rosacea, ar og ardannelser samt strækmærker.

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast, silikone.

**VÆGT:** massageapparat med base - 183 g.

**FUNKTIONER:**
NEO-massageapparatet bygger på lavtemperaturplasma (koldt plasma), en gas af neutrale molekyler og ladede partikler: frie elektroner samt positive og negative ioner. Plasma desinficerer huden, bekæmper akne og rosacea og forebygger betændelse. Ved at stimulere genopretning af kollagenfibrenes tæthed fremmer plasmateknologien heling af sår, ar og ardannelser. Plasmaaktivering af gener knyttet til anti-age-processer reducerer rynker og dybe ansigtsfolder. Plasma omdanner lipidernes dobbeltlag og danner kanaler for forskellige stoffer, så kosmetik trænger bedre ind. Det nedbryder desuden melaninsamlinger og lysner pigmentering.

**EGENSKABER:**
1. Originalt patenteret design - udviklet specielt til WAU; de afrundede former bagpå ligger godt i hånden og gør massagen let og behagelig.
2. Praktisk behandlingsflade - behandler både store hudområder og svært tilgængelige steder med den særlige smalle øverste spids.
3. 3 intensitetsniveauer til gradvis tilvænning af huden til plasma.
4. Nem betjening med 1 knap og smart timer på 10 minutter.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
Apparatet må ikke komme i kontakt med vand, berøres med våde hænder eller bruges på våd hud - det kan være farligt.
1. Tænd apparatet med et langt tryk (2 sekunder) på tænd/sluk-knappen. Ved tænding høres et lydsignal.
2. Displayet med intensitetsindikatorer lyser. Apparatet har 3 styrker: STRONG (stærk), MEDIUM (middel) og SOFT (svag). Vælg en passende styrke ved gentagne tryk på niveauknappen. SOFT kommer først, og dets ikon lyser. Næste tryk skifter til MEDIUM, og det følgende aktiverer STRONG.
3. Apparatet har en smart timer og slukker automatisk efter 10 minutters brug med et lydsignal.
4. Hold tænd/sluk/intensitetsknappen inde for at slukke apparatet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Vask ansigtet med dit sædvanlige renseprodukt, og fjern urenheder og overskydende talg.
2. Fjern alle væskerester fra ansigtet, og lad huden tørre helt før brug. Vand på huden kan give betydeligt ubehag under behandlingen.
3. Tænd apparatet, og vælg intensitet. Start gerne ved den laveste styrke, så huden kan vænne sig til apparatet.
4. Pres ikke apparatet mod huden, men hold det 2-3 mm fra overfladen. Før det langsomt langs massagelinjerne nedefra (fra hagen) opad (mod hårgrænsen). Vær særligt opmærksom på problemområder. Under brug høres plasmadannelsen, og du kan lugte ozon - det er normalt.
5. Sluk apparatet efter brug, og påfør dit plejeprodukt for at fugte huden. Massér let for bedre optagelse af kosmetikken.
6. Rengør behandlingsfladen med en fugtig, alkoholvædet klud. Bemærk: støv og talgrester klæber let til den keramiske del, når de nedbrydes af plasma under behandlingen. Det kan gulne keramikken, men påvirker ikke apparatets effekt.



**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | FORLØB |
|---|---|---|---|---|
| AKNE / BETÆNDELSE | MORGEN | Indledende forløb: 5-10 minutter på hvert ansigtsområde. Den samlede varighed af en behandling er op til 20-30 minutter. For at tilvænne huden anbefales en gradvis øgning af styrken: Uge 1 er det laveste niveau (ved følsom hud bruges det laveste niveau i 2 uger). Uge 2 er mellemniveauet. Uge 3 og frem er det højeste niveau, hvis huden har tilpasset sig godt. Vedligeholdende forløb (forebyggelse): 10-20 minutter til hele ansigtet | Indledende forløb: 2-3 gange om ugen (kan fortsættes, indtil de vigtigste symptomer er væk). Vedligeholdende forløb (forebyggelse): 1 gang hver 10-14. dag | Indledende forløb: 6-8 uger. Efter forløbet anbefales en pause på 1-2 måneder, så huden kan komme sig og ikke vænner sig til konstant stimulering |
| PIGMENTERING | AFTEN | | 2 gange om ugen med fokus på områder med hyperpigmentering | |
| ALDERSFORANDRINGER | AFTEN | | Indledende forløb: 2-3 gange om ugen. Vedligeholdende forløb (forebyggelse): 1 gang om ugen (1 gang hver 10-14. dag er tilladt) | |
| AR | AFTEN | 5-10 minutter afhængigt af arrets størrelse. Til ansigtet: Start på laveste styrke i de første 3 behandlinger, og øg derefter styrken gradvist. Til kroppen: Start på mellemstyrke i de første 3 behandlinger, og øg derefter styrken gradvist. | 2 gange om ugen | BEHANDLINGSFORLØB: 1-1.5 måneder. Gentagelse: 2-3 forløb årligt. Mellem forløbene: 1-2 behandlinger om måneden |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Må ikke bruges af børn, allergikere eller personer, som har fået operation i ansigt/øjne.
2. Apparatet må ikke komme i kontakt med vand, berøres med våde hænder eller bruges på våd hud.

**ADVARSLER:**
1. Brug ikke apparatet, hvis det har været nedsænket i vand, fungerer forkert, er beskadiget eller defekt.
2. Brug ikke apparatet ved øjnene (langs øvre og nedre øjenhuleknogle), på tindingerne, skjoldbruskkirtlen, brystet eller kønsorganerne.
3. Skil ikke apparatet ad; det kan give skader, funktionsfejl, elektrisk stød, brand eller personskade.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) apparat, (2) baseholder, (3) ladekabel, (4) opbevaringspose, (5) klud, (6) vejledning.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** 60 min

**SMART TIMER:** 10 min

**STRØM:** • SOFT-tilstand - 590 mA (når apparatet arbejder på hudoverfladen), 278 mA (uden kontakt med huden) • MEDIUM-tilstand - 1670 mA (når apparatet arbejder på hudoverfladen), 570 mA (uden kontakt med huden) • STRONG-tilstand - 1820 mA (når apparatet arbejder på hudoverfladen), 1010 mA (uden kontakt med huden)

**VANDBESTANDIGHED:** IPX3



# REN - ULTRALYDSSPATEL TIL ANSIGTS-RENSNING

Rensning

Forbedrer mikrocirkulationen

Eksfoliering

Forbedrer optagelsen af hudpleje

**PROBLEMOMRÅDER:** fedtet hud, udvidede porer, komedoner, akne, trist og usund hudtone samt tab af elasticitet.

**MATERIALER:** ABS-plast, silikone.

**VÆGT:** 140 g.

**FUNKTIONER:**
Højfrekvent ultralydsvibration og positive ioner i tilstanden „Dybrensning" renser huden skånsomt. Ultralydsbølgerne hjælper med at eksfoliere partikler fra epidermis' øverste lag og fjerne overfladeurenheder og talgophobninger. I fugttilstanden øger de samme bølger sammen med negative ioner blodcirkulationen og produktionen af kollagen/elastin, så kosmetik optages aktivt. Plejeprodukternes effekt bliver dermed tydeligere.

**EGENSKABER:**
1. Kompakt apparat til hjemmebrug.
2. Magnetdækslet beskytter rensefladen og understøtter hygiejnisk brug.
3. Kraftigt batteri og lang driftstid uden genopladning, op til 100 minutter.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Apparatet styres med 1 knap. Hold „Tænd/sluk/tilstandsskift" inde for at tænde. Et langt lydsignal bekræfter tænding.
2. „Dybrensning" starter først. Den tilsvarende indikator lyser, og en konstant ultralydsvibration høres.
3. Tryk igen på „Tænd/sluk/tilstandsskift" for at skifte tilstand. Der høres et kort lydsignal
4. Apparatet går til „Fugt", og den tilsvarende indikator lyser. Du hører en pulserende ultralydsvibration.

5. Sluk apparatet ved at trykke på „Tænd/sluk/tilstandsskift”.
6. Apparatet har en smart timer. Spatlen slukker automatisk efter 10 minutters brug.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
**TILSTAND:** DYBRENSNING
1. Fjern makeup og vask ansigtet med et renseprodukt før brug.
2. For det bedste resultat anbefales kold opblødning før rensning med desinkrustationsgel (gel til ultralydsrensning). Påfør gelen i ansigtet, undgå øjnene, dæk med film, og lad virke i 15 minutter; begynd derefter ultralydsrensningen. Ud over gel eller lotion til ultralydsrensning kan saltvandsopløsning eller termalkildevand bruges.
3. Tryk på „Tænd/sluk/tilstandsskift” for at aktivere „Dybrensning”.
4. Hold apparatet med forsiden nedad og spatlen i en vinkel på 40 grader mod huden. Før applikatoren langs massagelinjerne for at rense de ønskede områder.
5. „Dybrensning” må ikke vare mere end 5 minutter.
6. Sluk apparatet, eller skift til næste tilstand.
7. Vask ansigtet med varmt vand, og tør applikatoren.
8. Efter rensning anbefales fugtbehandlingen.
1. Påfør dit valgte plejeprodukt jævnt efter ansigtsrensningen.
2. Tænd apparatet, og tryk igen på knappen for at vælge fugttilstanden.
3. Vend apparatet med forsiden opad, så spatlens flade ligger mod huden, ikke kanten. Læg applikatoren mod ansigtet, og før den skånsomt opad langs massagelinjerne, indtil plejeproduktet er helt optaget.
4. Start gerne ved halsen i denne tilstand, og bevæg dig fra midten mod siderne.
5. Fortsæt massagen fra hage mod pande, og før spatlen fra midten og udad.
6. „Fugt” kan bruges i 3 til 5 minutter. Sluk derefter spatlen med et langt tryk på tænd/sluk-knappen.
7. Tør applikatoren, og læg spatlen på plads.



**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| RENSNING AF FEDTET HUD / AKNE | Aften anbefales. Påfør ikke makeup efter behandlingen. | Dybderensning: 5 min. Fugttilførsel: 5 min. Brug denne rækkefølge. Fugttilførselstilstanden er kun effektiv efter dybderensning. | Højst én gang om ugen | 3-4 uger. Hold 2 ugers pause. Gentag forløbet på 3-4 uger, og fortsæt denne cyklus. |
| KARSPRÆNGNINGER / SYNLIGE BLODKAR | | | Højst to gange om måneden | Efter behov |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Apparatet er til personlig brug. Del det ikke med andre.
2. Brug ikke apparatet i en måned efter operation eller ved alvorlig solskoldning i ansigtet.
3. Brug ikke på betændt eller beskadiget hud.
4. Brug ikke på øjnene.
5. Må ikke bruges på områder med vene- eller arteriesygdom eller af personer med tromboflebitis eller tidligere blodstørkningsforstyrrelser.

**ADVARSLER:**
1. Brug ikke apparatet længe på samme hudområde.
2. Hold apparatet væk fra høje temperaturer.
3. Ved ansigtsimplantater, metaltandkroner, stifter eller bøjle skal du være opmærksom på dine egne fornemmelser. Stop brugen ved smerter eller ubehag.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) ultralydsspatel, (2) magnetdæksel, (3) USB-Type C-kabel, 4. vejledning, (5) opbevaringspose.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 2 h

**DRIFTSTID:** 100 min

**SMART TIMER:** 10 min

**ULTRALYDSFREKVENS:** 25±5 kHz

**VANDBESTANDIGHED:** IPX4



# SARA - 2-I-1-HÅRTØRRER OG GLATTEJERN

Til tørt og vådt hår

Hurtig tørring

Styler og former håret

Skånsom behandling

Modvirker krus

Glatte hår

**PROBLEMOMRÅDER:** hårskader fra klassiske glattejern, krus, statisk elektricitet, besværlig styling af vådt hår og tab af glans.

**MATERIALER:** MS-plast, ABS-plast.

**VÆGT:** 441 g (uden ledning), 657 g (med ledning).

**FUNKTIONER:**
Tørring: indeni sidder en højhastighedsmotor (BLDC) med 110000 omdrejninger pr. minut. Den skaber en kraftig luftstrøm (op til 12 m/s). Håret tørres ikke ved at blive „stegt" ved høj temperatur, men ved fysisk at blæse fugten fra hårets overflade. Ionisering: under tørring dannes en strøm af negativt ladede ioner (mere end 30 millioner). Hår har normalt positiv ladning, som får hårene til at frastøde hinanden og kruse. Negative ioner neutraliserer ladningen og gør håret medgørligt.
GLATNING: luften kommer ud gennem smalle spalter langs pladerne i en vinkel på 45 grader. Det skaber et retningsbestemt tryk. Når pladerne klemmes sammen, accelererer strømmen og „presser" hårets skællag ind mod hårstrået. Varme og rettet luft bryder midlertidigt hydrogenbindingerne i vådt hår og gendanner dem i en lige form. Håret tørrer dermed allerede glattet, og resultatet fikseres. KOLD LUFT (FIKSERING): til sidst afkøler kold luft straks det varme hår og „forsegler" skællaget. Det giver spejlglans og en holdbar frisure.

**EGENSKABER:**
1. Tørring og glatning 2 i 1. SARA kombinerer begge funktioner i én behandling og forkorter den samlede stylingtid.
2. Hårsikkerhed: glatning med luft er langt mere skånsom end kontakt med et almindeligt glattejerns meget varme plader.
3. Individuel indstilling. 3 luftstrømshastigheder og 5 temperaturtilstande giver optimal pleje til alle hårtyper.
4. Universel spænding. Det brede spændingsområde sikrer stabil og sikker drift overalt i verden.

5. Særlige DRY- og WET-tilstande med gennemtænkte indstillinger til effektiv behandling af både vådt og tørt hår.
6. Informativt LCD-display giver fuld kontrol over driftsparametrene og størst mulig komfort.
7. Den alsidige lås gør det muligt at bruge apparatet som en almindelig hårtørrer med lukkede plader.
8. Intelligent pause. Hvis apparatet ikke bruges i mere end 10 sekunder, går det automatisk i standby og slukker efter 3 minutter.
9. Hukommelsesfunktion. Apparatet husker de seneste indstillinger, så du straks kan begynde ved næste tænding.
10. Kraftig ionisering. Generatoren frigiver mere end 30 millioner ioner, som neutraliserer statisk elektricitet og giver spejlglans og silkeblødt hår.
11. Motorhastighed. Højhastighedsmotoren (110000 rpm) skaber en kraftig, koncentreret strøm til øjeblikkelig fjernelse af fugt.
12. Selvrensning. Automatisk motorrensning bevarer maksimal blæsekraft og forlænger levetiden.
13. Ledningslængde: 2 meter giver bevægelsesfrihed ved professionel brug og hjemmebrug.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Sæt hårtørrerens stik helt i stikkontakten. OFF-ikonet lyser på displayet og viser, at apparatet er slukket.
2. Apparatet har en lås, som holder glattepladerne lukkede. Skub låsen ned for at åbne pladerne. Når de er åbne, kan hårlokker placeres imellem dem til glatning.
3. Saml pladerne, og skub låsen op for at holde dem sammen. I lukket position fungerer apparatet som hårtørrer. Låsning sikrer også sikker opbevaring og transport.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Når apparatet er tændt med åbne plader, er luftstrømmen minimal. Klem apparatet sammen for at starte arbejdet og aktivere den valgte blæsehastighed.
5. Vælg de ønskede tørre- eller stylingindstillinger med tilstandsknappen.
6. WET er til nyvasket hår og tørrer og glatter samtidigt.
7. DRY udglatter og fikserer formen på allerede tørt hår.
8. Indstil de ønskede parametre med temperaturknappen.
9. WET har højere temperaturer: 120 °C, 140 °C og 160 °C til intensiv fordampning af fugt og hurtig formning af lokken.
10. DRY har temperaturerne 80 °C, 110 °C og 140 °C for at beskytte allerede tørt hår mod overophedning.
11. Temperaturen kan vises i Celsius eller Fahrenheit. Hold temperaturknappen inde i 3 sekunder for at skifte enhed.
12. Vælg 1 af 3 blæsehastigheder med hastighedsknappen. Antallet af blade i ikonet svarer til hastigheden: lav - 1 blad, middel - 2 blade, kraftig luftstrøm - 3 blade.



13. Hold hastighedsknappen inde i 5 sekunder for at starte selvrensning. Fjern først magnetfilteret. Rensningen varer 15 sekunder og stopper automatisk. Sæt filteret på igen.
14. Tryk på koldluftsknappen, hvis du ønsker kold tilstand.
15. Hvis apparatet er tændt og står åbent uden brug i mere end 10 sekunder, starter pausetilstanden automatisk, og temperaturikonet blinker konstant. Hvis det er inaktivt i pause i mere end 3 minutter, slukker det automatisk.
16. SARA har hukommelsesfunktion. Næste gang apparatet tændes, starter det i samme tilstand og med de indstillinger, der sidst blev brugt.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Sørg for tørre hænder, og at håret ikke er så vådt, at det drypper. Det anbefales først at tørre det med et håndklæde.
2. Red forsigtigt håret med en bredtandet kam for at undgå sammenfiltring under styling.
3. Tænd hårtørreren/glattejernet.
4. Vælg WET.
5. Indstil ønsket temperatur og hastighed.
6. Brug først SARA låst som hårtørrer til rødderne (pladerne lukkede, låsen skubbet op).
7. Skub låsen ned, åbn pladerne, og læg lokken imellem dem så tæt ved rødderne som muligt. Luftudløbene skal vende mod hårspidserne. Luk pladerne, og før langsomt apparatet ned mod spidserne.
8. Vælg DRY, hvis du fortsætter styling på tørt hår.
9. Læg en lok mellem pladerne, og klem sammen. Luftstrømmen øges automatisk til det valgte niveau. Før apparatet jævnt ned mod spidserne.
10. Den indbyggede ionisator neutraliserer statisk elektricitet og glatter skællaget under bevægelsen.
11. Aktivér kold luft efter tørring af alt håret for at fiksere formen og give ekstra glans. Den kolde luft lukker skællaget og gør frisuren glattere og mere holdbar.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Brug kun apparatet til naturligt menneskehår. Brug det ikke på kunstigt hår eller dyrehår.
2. Brug ikke varmeelementerne til at tørre andre genstande.
3. Må ikke bruges på badeværelset. Brug aldrig apparatet i badekar, brusebad, over en fyldt håndvask eller med våde hænder.
4. Nedsænk ikke apparatet i vand, og udsæt det ikke for rindende vand.
5. Brug ikke apparatet på hår, som er så vådt, at det drypper.
6. Tænd ikke apparatet, hvis det eller ledningen er beskadiget. Brug det heller ikke efter fald, ved synlige skader eller forkert funktion.
7. Afbryd straks strømmen, hvis apparatet er så beskadiget, at elektriske dele er blotlagt.

8. Personer med visse sygdomme (f.eks. epilepsi) eller motoriske forstyrrelser (dyskinesi) bør undlade at bruge apparatet.
9. Apparatet er ikke beregnet til personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller utilstrækkelig erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået brugsvejledning.

**ADVARSLER:**
1. Undgå kontakt mellem apparatets varme dele og øjne og hud.
2. Læg ikke det tændte apparat på træ-, papir- eller stofoverflader. Brug kun en plan, varmebestandig overflade.
3. Læg aldrig håndklæder eller lignende på eller under apparatet, da det kan give overophedning og brand.
4. Brug ikke apparatet nær brændbare væsker eller gasser (f.eks. aerosoler eller stylingmousse).
5. Ved beskadigede plader må der ikke bruges olier eller stylingspray.
6. Kontrollér før tænding, at netspændingen passer til apparatet. Parametrene står på håndtaget.
7. Tag altid stikket ud ved fejl under brug, før rengøring, efter slukning og når apparatet ikke bruges.
8. Beskyt ledningen mod skader. Træk aldrig i ledningen; hold i stikket, når det tages ud. Vikl ikke ledningen om apparatet.
9. Reparation må kun udføres af autoriserede servicecentre. Forsøg ikke selv at reparere apparatet; det har ingen brugerservicerbare dele. Kontakt ved fejl den organisation, der er bemyndiget til at modtage forbrugerklager.
10. Apparatet har en sikkerhedsafbryder ved overophedning.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) hårtørrer, (2) opbevaringspose, (3) vejledning, (4) klemmer.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**EFFEKT:** 1600 W

**NOMINEL SPÆNDING:** 220-240 V

**MOTORHASTIGHED:** 110000 omdr./min

Hastighed: 12 meter pr. sekund

**TEMPERATURTILSTANDE:** DRY: 80 °C, 110 °C, 140 °C WET: 120 °C, 140 °C, 160 °C Kold luft

**MÅL (H X B X D):** 329×55×38 mm

**STØJNIVEAU:** 85,6-86,9 dB

**STRØMLEDNINGENS LÆNGDE:** 2 m



# UMI - ULTRALYDSSPATEL TIL ANSIGTET

Rensning

Forbedrer mikrocirkulationen

Eksfoliering

Forbedrer optagelsen af hudpleje

**PROBLEMOMRÅDER:** fedtet hud, udvidede porer, komedoner, akne, trist og usund hudtone samt tab af elasticitet.

**MATERIALER:** ABS-plast, silikone.

**VÆGT:** 131 g.

**FUNKTIONER:**

Højfrekvent ultralydsvibration og positive ioner i tilstanden „Dybrensning" renser huden skånsomt. Ultralydsbølgerne hjælper med at eksfoliere partikler fra epidermis' øverste lag og fjerne overfladeurenheder og talgophobninger.

I fugttilstanden øger de samme ultralydsbølger sammen med negative ioner blodcirkulationen og produktionen af kollagen/elastin, så kosmetik optages aktivt. Plejeprodukternes effekt bliver dermed tydeligere.

**EGENSKABER:**
1. Bærbart apparat med magnetisk induktionsladebase - nemt at tage med på rejse.
2. Magnetdækslet beskytter rensefladen og understøtter hygiejnisk brug.
3. Blødt silikonekabinet giver maksimal komfort under brug.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Apparatet styres med én knap. Tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen for at tænde.
2. Dybrensning starter, og den tilsvarende indikator lyser.
3. Tryk igen på tænd/sluk/tilstandsknappen for at skifte. Apparatet starter „Fugt", og den tilsvarende indikator lyser.
4. Sluk med tænd/sluk/tilstandsknappen.
5. Spatlens driftstid er 5 minutter. Efter 5 minutters drift slukker den automatisk. Selv ved tilstandsskift er den samlede driftstid 5 minutter.

## SÅDAN BRUGES APPARATET:

**TILSTAND:** DYBRENSNING:
1. Fjern makeup og vask ansigtet med et renseprodukt før brug.
2. For det bedste resultat forberedes huden med kold opblødning og desinkrustationsgel. Påfør gelen i ansigtet, undgå øjnene, dæk med film, og lad virke i 15 minutter før ultralydsrensning. Lotion til ultralydsrensning, saltvandsopløsning eller termalkildevand kan også bruges.
3. Tænd apparatet.
4. Start „Dybrensning".
5. Hold apparatet med forsiden opad. Læg spatlen i en vinkel på 40 grader mod huden, og før applikatoren langs massagelinjerne for at rense de ønskede områder.
6. Apparatet slukker automatisk efter 5 minutter.
7. Vask ansigtet med varmt vand.
8. Tør spatlen helt.

**FUGTTILSTAND:**
1. Begynd fugtbehandlingen efter rensning. Påfør serum jævnt i ansigtet.
2. Tænd apparatet.
3. Skift til fugttilstand.
4. Hold apparatet med forsiden nedad. Læg spatlens flade mod huden, ikke dens kant.
5. Før applikatoren skånsomt opad langs massagelinjerne, indtil plejeproduktet er helt optaget.
6. Apparatet slukker automatisk efter 5 minutter.
7. Tør spatlen helt.

## BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| RENSNING AF FEDTET HUD / AKNE | Aften anbefales. Påfør ikke makeup efter behandlingen. | Dybderensning: 5 min. Fugttilførsel: 5 min. Brug denne rækkefølge. Fugttilførselstilstanden er kun effektiv efter dybderensning. | Højst én gang om ugen | 3-4 uger. Hold 2 ugers pause. Gentag forløbet på 3-4 uger, og fortsæt denne cyklus. |
| KARSPRÆNGNINGER / SYNLIGE BLODKAR | | | Højst to gange om måneden | Efter behov |

## KONTRAINDIKATIONER:
1. Brug ikke apparatet i en måned efter operation eller ved alvorlig solskoldning i ansigtet.
2. Brug ikke på betændt eller beskadiget hud.
3. Brug ikke på øjnene.



## ADVARSLER:
1. Brug ikke apparatet længe på samme hudområde.
2. Hold apparatet væk fra høje temperaturer.
3. Ved ansigtsimplantater, metaltandkroner, stifter eller bøjle skal du være opmærksom på dine egne fornemmelser. Stop brugen ved smerter eller ubehag.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) ultralydsspatel, (2) magnetdæksel, (3) trådløs ladebase, (4) brugsanvisning, (5) rengøringsklud.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

**OPLADNINGSTID:** 5 h

**DRIFTSTID:** 35 min

**SMART TIMER:** 5 min

**ULTRALYDSFREKVENS:** 25±5 kHz

**VANDBESTANDIGHED:** IPX5




# VIA GOLD - 3-I-1-APPARAT TIL ANSIGTS-FORYNGELSE

Reducerer hævelser

Definerer V-formede ansigtskonturer

Rensning

Løft

Reducerer rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** ændringer i ansigtets nederste tredjedel, hængende kinder, dobbelthage og synlige aldringstegn: rynker, løs hud, udvidede porer og trist hudtone.

**MATERIALER:** ABS-plast, metal.

**VÆGT:** 207,5 g.

**FUNKTIONER:**

Ultralyd og vibration - ultralydsbølger eksfolierer partikler fra epidermis' øverste lag og fjerner overfladeurenheder og talgophobninger. Vibration løfter disse urenheder op til hudoverfladen.

RF - radiofrekvensenergi, som opvarmer det dybe hudlag (dermis) til ca. 40-55 °C, stimulerer kollagenproduktionen og øger hudens elasticitet. I nogle tilfælde kan varmen også fremskynde fedtcellernes stofskifte (f.eks. ved dobbelthagen). Ved apparater til hjemmebrug er temperaturen på hudoverfladen normalt 38-45 °C af hensyn til sikker brug.

EMS - muskelstimulation med lavfrekvente strømme, som trænger dybt ind i vævet, skaber muskelsammentrækninger og karudvidelse, forbedrer blod- og lymfecirkulationen og stimulerer stofskifte og hudens næring. Det giver et øjeblikkeligt ansigtsløft, øger muskeltonus og strammer konturerne op.

**EGENSKABER:**
1. Kompakt apparat med 3 af de mest effektive teknologier.
2. Magnetring til fastgørelse af rensepads for grundigere rensning i SONIC-tilstand.
3. Justérbar EMS-styrke.
4. Kugler af rustfrit stål som elektroder for bedre strømledning.
5. VIA vandt kategorien „Best beauty-gadget" ved Live Organic Awards 2021.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Fjern beskyttelsesdæksel og hætte.
2. Tænd massageapparatet med et langt tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen.
3. Apparatet har 3 tilstande: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, som skifter i denne rækkefølge med korte tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen.
4. Hold tænd/sluk/tilstandsknappen inde for at slukke.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

SONISK TILSTAND
1. Fjern makeup, og vask ansigtet med et renseprodukt.
2. Påfør skintonic på en vatrondel, eller brug en rensepad.
3. Fastgør rondellen eller padden på applikatoren med magnetringen.
4. Tænd apparatet, og vælg SONIC.
5. Læg applikatoren mod ansigtet, og rens langs massagelinjerne fra hagen og op til hårgrænsen i panden. Rens gerne alle områder flere gange, især T-zonen, for det bedste resultat.
6. Efter 3 minutters brug slukker apparatet automatisk.
7. Fjern rondellen eller padden, og rengør applikatoren med en rengøringsklud.
8. Skyl ansigtet med vand.

RF-TILSTAND
1. Påfør et vandbaseret plejeprodukt i ansigtet. Det må ikke indeholde aggressive syrer eller olier.
2. Tænd apparatet, og vælg RF.
3. Før applikatoren langsomt fra ansigtets midte udad med jævn hastighed. Bliv ikke længe på ét sted.
4. Apparatet slukker automatisk efter 5 minutter.
5. Fjern kosmetikrester fra applikatoren med en rengøringsklud.

EMS-TILSTAND
1. Påfør et vandbaseret produkt med geltekstur i ansigtet for bedre strømledning og maksimale resultater.
2. Tænd apparatet, og vælg EMS.
3. Vælg svag eller stærk EMS-intensitet ved at trykke igen på tænd/sluk/tilstandsknappen.
4. Læg rullerne på ansigtskonturen, og før apparatet nedefra og op, mens huden strammes let. Gentag 3-5 gange langs massagelinjerne fra midten og udad. Undgå panden og øjenområdet.
5. Apparatet slukker automatisk efter 6 minutter.
6. Fjern kosmetikrester fra rullerne med en rengøringsklud.



**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**

| HUDTYPE / PROBLEM | TIDSPUNKT PÅ DAGEN | VARIGHED OG RÆKKEFØLGE | HYPPIGHED | BEHANDLINGSFORLØB |
|---|---|---|---|---|
| TRÆT / TYNGDEBETINGET OG HÆVET ALDRINGSTYPE | Aften, efter rensning | SONIC med rensepads: 3 min. RF: 5-7 min. EMS: lavt niveau - 5 min; højt niveau på de nedre kinder og hagen - 3 min. Brug denne rækkefølge, ikke samtidig. | 2-3 gange om ugen | 3 uger. Hold 1 uges pause. Gentag i op til 3 måneder. Én gang hver 6. måned. |
| HUD MED FINE LINJER | Morgen | SONIC med fugtgivende/løftende pads: 3 min. RF: 10 min. Fra uge 3, EMS: lav intensitet, 5-7 min. | RF og SONIC: to gange i uge 1 og derefter 3 gange om ugen fra uge 2. EMS: to gange om ugen. | 10 uger. Hold 2-3 ugers pause. Gentag forløbet på 10 uger. Én gang hver 6. måned. |
| HALS | Morgen | SONIC med fugtgivende/løftende pads: 3 min. RF: 10-15 min. EMS: lavt niveau - 5 min. Rødme efter behandling kan forekomme og er normalt. Behandl ikke midten af halsen over skjoldbruskkirtlen. | 2-3 gange om ugen | 10 uger. Hold 2-3 ugers pause. Gentag forløbet på 10 uger. Én gang hver 6. måned. |

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Apparatet må ikke bruges ved elektroniske implantater eller pacemaker.
2. Apparatet må ikke bruges af personer, som har fået operation i bughulen inden for den sidste måned eller været udsat for langvarigt sollys.
3. Apparatet må ikke bruges ved beskadiget hud, pusdannelse, forbrændinger, ar eller følsomhed over for elektromagnetisk påvirkning.
4. Brug anbefales ikke ved metalkeramiske eller keramiske tandkroner, implantater, bøjle eller øget tandfølsomhed.
5. Apparatet må ikke bruges ved blodsygdomme, tuberkulose, sygdomme i indre organer, ondartede tumorer, højt blodtryk, forhøjet kropstemperatur eller ansigtsneuralgi.
6. Bær ikke tøj af kunstfibre under brug af massageapparatet.
7. Brug ikke EMS omkring øjne, mund eller skjoldbruskkirtel eller på steder med spor efter plastikkirurgi eller skader.

8. Brug ikke apparatet på det følsomme område omkring øjnene, hvor huden er tynd og sart.
9. Brug ikke apparatet på slimhinder (f.eks. i næse, mund eller kønsområde), da det kan give lokal irritation.

**ADVARSLER:**
1. Efterlad ikke det tændte apparat uden opsyn.
2. Brug ikke massageapparatet ved høje temperaturer.
3. Skil ikke selv apparatet ad.
4. Tænd ikke under opladning.
5. Kontrollér for skader efter slag eller fald, før brugen fortsættes.
6. Kontrollér stik og strømkabel for skader for at undgå elektrisk stød.
7. Tag ur, briller og andre genstande med metaldele af før brug.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) apparat, (2) EMS-rullehætte, (3) magnetring på applikator, (4) USB-C-ladekabel, (5) vejledning, (6) klud,
7. opbevaringspose.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**OPLADNINGSTID:** 3 h

**DRIFTSTID:** SONIC-tilstand - 150 minutter; RF-tilstand - 40 minutter; EMS-tilstand - 2700 minutter

**SMART TIMER:** • SONIC-tilstand - 3 minutter • RF-tilstand - 5 minutter • EMS-tilstand - 6 minutter

**STRØM:** SONIC-tilstand - 100-400 mA • RF-tilstand - 200-2800 mA • EMS-tilstand - 3-30 mA

**HYPPIGHED:**
• SONIC 3 MHz +/-10%
• RF 1 MHz

**EMS-FREKVENS:** 2,91 KHz

**BØLGEFORM:** rektangulær bølgeform

**VANDBESTANDIGHED:** IPX6




# YUKI - IPL-HÅRFJERNINGSAPPARAT MED KØLING

Fjerner uønsket hår

Bremser hårvækst

Beskytter mod forbrændinger og smerter

Glat hud

**PROBLEMOMRÅDER: hårfjerning.**

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast.

**VÆGT:** 298 g.

**FUNKTIONER:**
Apparatet fjerner uønsket hår hurtigt, sikkert og smertefrit med avanceret INTENST PULSERET LYS (IPL). Dobbeltimpulstilstanden skaber en højenergetisk overlapning af fotoner, som virker direkte på hårsækken og hæmmer hårvæksten. IPL er egnet til naturligt sort, brunt og mørkblondt hår. Det kan være mindre effektivt på hvidt, lyst, rødt eller gråt hår.

Den innovative safirkøling sænker effektivt temperaturen i behandlingsområdet, beskytter epidermis mod forbrændinger og fjerner smerten helt.

**EGENSKABER:**
1. Bærbarhed: nemt at tage med på rejse - apparatet er let, kompakt og fylder lidt i bagagen.
2. Kølende safirflade: køler huden under lysglimtet, reducerer ubehag og beskytter mod forbrændinger.
3. 5 effektniveauer gør det nemt at vælge en sikker og effektiv intensitet til forskellige hudtyper og følsomme områder.
4. Manuel og automatisk tilstand: manuel til præcis behandling (ansigt, bikini) og automatisk til hurtig hårfjerning på store områder (ben, arme).
5. Ubegrænset antal lysglimt: holdbarhed uden køb af udskiftningspatroner - kapaciteten rækker til flere års brug.
6. Termometer: overvåger løbende apparatets og hudens temperatur for at undgå overophedning og sikre sikker brug.
7. Valgfri dobbeltimpuls: 2 lysglimt i én behandlingscyklus giver en effektiv, dybere påvirkning af hårsækken.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Tilslut adapterledningen til det tilsvarende stik på IPL-apparatet.
2. Sæt adapterens stik helt i stikkontakten.
3. Vigtigt: brug altid de medfølgende beskyttelsesbriller for at beskytte øjnene mod lysglimt.
4. Hold tænd-knappen inde i 2 sekunder for at starte apparatet. Den indbyggede køleblæser starter med en karakteristisk lyd.
5. Som standard starter apparatet på laveste intensitet, niveau 1. Justér effekten med korte tryk på tænd/niveau-knappen. Højere niveau giver kraftigere lysimpuls og hurtigere effekt. Start lavt, og øg gradvist, efterhånden som huden vænner sig til behandlingen.
6. Tilstandsindikator: når apparatet er tændt uden hudkontakt, lyser indikatoren konstant, og lysglimt er blokeret af sikkerhedshensyn. Ved tæt hudkontakt begynder indikatoren at blinke. Det viser korrekt kontakt og klarhed: et tryk på knappen udløser et lysglimt med enkelt- eller dobbeltimpuls afhængigt af tilstanden.
7. Vælg den ønskede driftstilstand:
Manuel og automatisk lystilstand: apparatet har to formater til forskellige opgaver og områder. Hold lysglimtknappen inde i 2 sekunder for at skifte, mens vinduet vender væk fra huden og ikke presses mod den.
Apparatets vindue er rettet ud til siden og rører ikke huden:
• Automatisk (klarindikatoren blinker) - apparatet udsender selv en impuls, hver gang safirvinduet har tæt kontakt med kroppen; du behøver ikke trykke hver gang. Tilstanden behandler store områder hurtigt og fortløbende (ben, arme, mave eller ryg), sparer tid og mindsker håndtræthed.
Manuel (klarindikatoren lyser konstant) - lysglimtet udløses kun, når du bevidst trykker på knappen. Tilstanden er til omhyggelig, skånsom og præcis behandling af små eller ujævne områder, som kræver maksimal kontrol (f.eks. ansigt, armhuler, bikiniområde).
Enkelt-/dobbeltimpuls: hold samtidigt lysglimtknappen
og tænd-knappen inde i 2 sekunder:
- Slukket tilstandsindikator: enkeltimpuls (1 lysglimt pr. tryk/kontakt). - Tændt indikator: dobbeltimpuls med effektiv overlapning af 2 lysglimt pr. behandlingscyklus, som påvirker hårsækken dybere.
Køling (Sapphire ice care): i manuel lystilstand (standard ved start) lægges safirglasset tæt mod huden uden at trykke på lysknappen. Det bruges som et selvstændigt koldt kompres til hurtigt at berolige huden, lindre irritation eller forberede følsomme områder til hårfjerning.



Bemærk: ved køling uden lysglimt skal du trykke på intensitetsknappen mindst én gang hvert 5. minut for at holde apparatet aktivt. Ellers slukker det automatisk.
8. Hold sluk-knappen inde i 2 sekunder for at slukke. Blæseren fortsætter i 15 sekunder for sikker afkøling af de indvendige dele.
9. Afbryd adapteren fra elnettet, når blæseren er stoppet helt.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
Udfør en hudfølsomhedstest før første behandling. Vælg et lille hudområde dér, hvor du vil behandle. Vælg intensitetsniveau 3, og lav to lysglimt i dobbeltimpulstilstand. Vurdér området efter 30 minutter. Hvis huden ser normal ud, kan apparatet bruges. Ved kraftig rødme eller hævelse udskydes behandlingen; kontrollér igen efter 24 timer. UDFØRELSE AF HÅRFJERNING
1. Forberedelse: barber alt hår i området, rens huden, og tør den helt.
2. Tag brillerne på, tænd apparatet, og vælg passende effekt og tilstand.
3. Læg lysvinduet tæt mod huden i en vinkel på 90°. Der må ikke være mellemrum mellem hud og safirglas.
4. Vent på klarlyset i manuel tilstand, og tryk på lysglimtknappen. Flyt til næste område. I automatisk tilstand udløses lysglimtet selv ved tæt hudkontakt.
5. Behandl ikke samme punkt med mere end 2-3 lysglimt i én behandling for at undgå forbrændinger. Hvis apparatet holdes stille samme sted, blokeres kontinuerlig udsendelse efter 8 sekunder.
6. Anbefaling: køl det færdigbehandlede område med safirfladen i 1-2 minutter, før du går videre.
7. Efterpleje: påfør beroligende aloe vera-gel eller en mild fugtcreme. Brug ikke alkohol eller irriterende kosmetik. Ved let svien lægges et køligt kompres i 30-60 minutter.

**BRUGSHYPPIGHED OG -VARIGHED:**
**MÅNED 1:** brug apparatet 1 gang hver 3-5 dage. Hårets ydre struktur og hudens tilstand ændres ikke synligt. Måned 2: brug apparatet 1 gang om ugen. Håret bliver tydeligt tyndere og blødere, og sorte hårsække begynder at løsne sig under vask. Måned 3: brug apparatet 1 gang hver 15. dag. Ny hårvækst er næsten helt hæmmet, og enkelte resterende hår fjernes let. Måned 4: brug apparatet 1 gang hver 30. dag. Håret holder op med at vokse, og der opnås langvarigt helt glat hud.

Vedligeholdelse (senere behandlinger): hårfjerning med IPL til hjemmebrug er en længere proces. Efter det grundlæggende forløb på 4 måneder behøver nogle kropsområder måske ingen videre behandling. Andre områder kræver efter individuelle forhold sjældne vedligeholdelsesbehandlinger med 6, 9 eller 12 måneders mellemrum for at fastholde resultatet. Det intensive ugentlige forløb behøver ikke gentages.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Apparatet må ikke bruges på meget mørk, stærkt pigmenteret hud. Brugere med mørk eller brun hud skal altid starte på intensitetsniveau 1.
2. Rådfør dig gerne med en fagperson før brug ved graviditet, planlagt graviditet og amning.
3. Må ikke bruges ved lysfølsom hud eller indtagelse af lysfølsomhedsfremkaldende medicin.
4. Brug ikke apparatet ved hudbetændelse, allergi, eksem eller infektion i behandlingsområdet.
5. Behandl ikke områder, hvor der er injiceret fillere, andre injektioner eller toksiner (botox).
6. Brug ikke direkte på tatoveringer, permanent makeup, store fregner, modermærker, pigmentpletter eller vorter.
7. Brug ikke på slimhinder eller sarte områder: ører, hals, brystvorter, kønsorganer, anus og læber.
8. Brug ikke apparatet efter intensiv solbadning, solarium eller selvbruner.
9. Forsøg ikke selv at skille IPL-apparatet ad, reparere eller ændre det.
10. Stop straks og kontakt den autoriserede organisation ved beskadiget ledning eller stik, gnister eller rødglødende dele.

**ADVARSLER:**
1. Hold apparatet væk fra pacemakere, defibrillatorer, bankkort og lagringsenheder.
2. Undgå vand på apparat og adapter. Brug ikke på badeværelset eller nær håndvaske. Rør det ikke med våde hænder.
3. Apparatet er udelukkende til personer over 18 år. Opbevar det utilgængeligt for børn.
4. Dæk ikke ventilationsåbninger under brug; det giver overophedning.
5. Varmebeskyttelse: en indbygget temperatursensor aktiverer beskyttelsen ved for høj indvendig temperatur, så apparatet automatisk stopper. Afbryd strømmen, og lad det køle i 10 minutter; derefter er det igen klar til sikker brug.
6. Brug ikke apparatet i omgivelser med brandfarlige gasser, aerosoler eller ren ilt.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) IPL-apparat, (2) strømadapter, (3) beskyttelsesbriller, 4. engangsskraber, 5) brugsanvisning, 6) opbevaringspose.



**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MÅL (H X B X D):** 172×65×40 mm

**EFFEKT:** 64,8 W

**DRIFTSSPÆNDING:** 100-240 V ~ 50/60 Hz

Lyskilde: intenst pulseret lys (IPL)

**BØLGELÆNGDE:** 550-1200 nm (afvigelse ±20 nm)

Impulstilstand: enkeltimpuls/dobbeltimpuls

**ANTAL LYSGLIMT:** >999000 impulser

**MAKSIMAL ENERGITÆTHED:** 5.1 J/cm2

**BEHANDLINGSVINDUETS AREAL:** 3.3 cm2



# YUTO+ - HÅRTØRRER MED DIFFUSER

Hurtig tørring

Effektiv styling

Modvirker krus

Antistatisk virkning

Bevarer hårets sunde glans

**PROBLEMOMRÅDER:** vådt hår, formløs frisure efter lufttørring samt meget kruset og elektrisk hår.

**MATERIALER:** ABS-plast, PC-plast.

**VÆGT:** 360 g.

**FUNKTIONER:**
3 luftstrømshastigheder og 3 temperaturniveauer giver en behagelig tørring. Kold luft hjælper med at fiksere frisuren.

Ioniseringsfunktionen tilfører luften negative ioner, som fjerner statisk elektricitet.

Automatisk rensning fjerner snavs fra filteret uden ekstra besvær.

**EGENSKABER:**
1. Sammenklappeligt design.
2. Ultralet - 360g.
3. Dysediameter 42.4 mm.
4. Lang ledning på 2 m.
5. Lavt støjniveau - op til 64 dB.
6. 3 temperaturer: lav: 50 °C, middel: 70 °C, høj: 110 °C.
7. 3 hoveder medfølger: en bred tørredyse giver større luftmængde til hurtig tørring, en smal stylingdyse giver koncentreret luft til styling, og en diffuser tørrer krøllet hår. Hovederne fastgøres med magneter i én position.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**
1. Hårtørreren ligger sammenfoldet i æsken. Hold den ved basen i højre hånd, og drej håndtaget væk fra dig for at åbne den.
2. Sæt stikket helt i stikkontakten, og montér det ønskede hoved. YUTO's hoveder er magnetiske og trækkes automatisk på plads i luftudløbet. Træk i hovedet for at fjerne det.

3. Tryk på tænd/sluk-knappen. Ved første tænding starter den automatisk ved laveste temperatur og hastighed. 1 temperaturindikator og 1 hastighedsindikator lyser.
4. Justér luftstrømshastigheden. YUTO har 3 niveauer: lav, middel og høj. Ét tryk på hastighedsknappen skifter niveau, og de tilsvarende indikatorer lyser.
5. Justér lufttemperaturen. YUTO har 3 niveauer: lav, middel og høj. Ét tryk på temperaturknappen skifter niveau. De tilsvarende indikatorer lyser.
6. YUTO har hukommelsesfunktion. Første gang starter hastighed og temperatur på minimum, men senere starter den i den senest anvendte tilstand.
7. Tryk på koldluftsknappen for at aktivere kold luft. Tryk igen for at vende tilbage til den tidligere temperatur. Kold luft kan også slås fra med temperaturknappen.
8. Hårtørreren har automatisk rensning af indvendige dele. Tryk samtidigt på temperatur- og hastighedsknapperne, mens apparatet arbejder. Motoren kører baglæns og blæser luft ud gennem indtaget for at rense det. Tryk på en vilkårlig knap for normal drift. Selvrensningen slutter efter 15 sekunder.
9. Flyt knappen til OFF for at slukke. YUTO har forsinket stop. Et øjeblikkeligt stop kan beskadige motoren og forkorte levetiden. Det forsinkede stop beskytter motoren og forlænger både dens og hårtørrerens levetid.
10. Fold hårtørreren sammen, og tag stikket ud. Læg den på en isoleret overflade, lad den køle, og opbevar den tørt og rent.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Montér tørredysen, tænd hårtørreren, og justér temperatur og luftstrøm.
2. Start ved rødderne, og ret luften mod hårrødderne, ikke hovedbunden. Skab volumen ved at rette hårtørreren mod hårets naturlige vækstretning.
3. Tør derefter længderne opdelt i områder, med luftstrømmen oppefra og ned.
4. Skift til stylingdysen. Vælg en lok, læg en rundbørste eller kam under den, og før langsomt hårtørreren henover med dysen skråt mod håret.
5. Gennemgå lokkerne med kold luft for at fiksere.
6. Sluk hårtørreren, og tag stikket ud.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Denne hårtørrer er til hovedhår. Brug den ikke til andre formål end hårtørring.
2. Brug ikke apparatet på øjne, hud eller andre varmefølsomme overflader.



**ADVARSLER:**
Hovederne indeholder magneter. Hold dem væk fra pacemakere, defibrillatorer, bankkort og lagringsenheder.
1. Brug ikke hårtørreren nær badekar, håndvask eller andre vandbeholdere.
2. Brug ikke apparatet, mens du bader.
3. Læg eller tab ikke apparatet i vand eller andre væsker.
4. Tag straks stikket ud, hvis apparatet falder i vand. Rør ikke vandet.
5. Rør ingen dele af apparatet med våde hænder.
For at mindske risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand og skader:
1. Afbryd strømmen, når hårtørreren ikke bruges. Lad den køle, og opbevar den sikkert og tørt.
2. Hårtørreren bliver varm under brug. Lad ikke de varme overflader røre øjne eller ubeskyttet hud.
3. Læg ikke en varm hårtørrer direkte på andre overflader end en varmemåtte eller anden egnet overflade.
4. Efterlad ikke apparatet tilsluttet uden opsyn. Omhyggeligt opsyn kræves, når børn bruger det, eller det bruges nær børn eller personer med handicap.
5. Brug kun apparatet til det tilsigtede formål og som beskrevet her.
6. Brug ikke apparatet med beskadiget ledning eller stik.
7. Træk, ryk, stræk, sno eller bøj ikke ledningen skarpt, især ved stikket. Det kan beskadige eller knække ledningen. Håndtér den forsigtigt, hold den væk fra varme overflader, og vikl den ikke om apparatet.
8. Tab ikke apparatet, og stik ikke fremmedlegemer i åbningerne.
9. En ikke-selvnulstillende termosikring beskytter mod overophedning. Hvis apparatet slukker, og den anden LED (temperatur) blinker, skal du tage stikket ud og lade det køle.
10. Opbevaring ved høj luftfugtighed er forbudt.
11. Lad ikke hår eller fnug blive i ventilationsåbningerne.
12. Læg ikke apparatet fra dig på en overflade, mens det arbejder.
13. Stop straks, og tag stikket ud, hvis apparatet er defekt eller bliver for varmt.

**PAKKENS INDHOLD:** (1) hårtørrer, (2) tørredyse, (3) stylingdyse, (4) diffuser,
5. vejledning, (6) opbevaringspose.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER:**

**MOTORHASTIGHED:** 110000 omdr./min

Luftmængde: 32 liter pr. sekund

**LUFTSTRØMSHASTIGHED:**
- Lav hastighed - 80000 omdrejninger pr. minut
- Middelhastighed: 95000 omdrejninger pr. minut
- Høj hastighed - 110000 omdrejninger pr. minut

**TEMPERATURTILSTANDE:** • lav temperatur - 50 °C • mellemtemperatur - 70 °C • høj temperatur - 110 °C




# TILBEHØR



# RENGA GOLD - TOILETTASKE

Organiserer hudpleje og kosmetik

Opbevaring derhjemme og på farten

**PROBLEMOMRÅDER:** uorganiseret opbevaring.

**MATERIALER:** polyurethan (yderside), polyester (inderside).

**EGENSKABER:**
1. Elegant udenpå og ergonomisk indeni: designet og indretningen gør toilettasken både praktisk og flot.
2. Praktisk: polyesterforet er let og stærkt, holder formen og modstår krøller og snavs. Spildt kosmetik kan tørres af med en fugtig klud.
3. Forstærket konstruktion: tynde indvendige plader gør tasken mere stiv og hjælper den med at holde formen.
4. Rummelig: indvendige og udvendige lommer giver plads til alle dine nødvendigheder.
5. Indvendige håndtag: 2 stærke håndtag gør, at tasken kan bæres åben eller hænges på en krog.
6. 3 farver - kunderne kan nu vælge den farve, der passer dem bedst.

**PLEJEANBEFALINGER:**
Der kan opstå folder i toilettasken under levering, som gradvist retter sig ud. Dybe folder kan fjernes med en steamer gennem et hvidt bomuldshåndklæde.




# WAU HUDPLEJE




# AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

REGENERERENDE ANSIGTSCREME

Genopretter hudbarrieren

Forbedrer elasticiteten

Nærer intensivt

Beroliger

Fugter og blødgør i dybden

**PROBLEMOMRÅDER:** dehydreret, tør og trist hud samt irritation.

**FORDELE:** beroliger, øger hudens fasthed og elasticitet, nærer og fugter intensivt og aktiverer genopbygning.

**INGREDIENSER:** Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Allantoin (Allantoin) - en kraftigt beroligende ingrediens, som lindrer irritation og fremmer regenerering.
2. Arginin (Arginine) - en aminosyre, som forbedrer mikrocirkulationen og hudens beskyttelsesfunktioner.
3. Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract - kendt for antiseptiske og antiinflammatoriske egenskaber.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (probiotika) - hjælper med at genoprette hudens mikrobiom og forbedrer dens beskyttelsesfunktioner.
5. Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water - mindsker porerne og regulerer talgproduktionen.
6. Lavandula Angustifolia (lavendel) + Chamomilla Recutita (kamille) - beroliger huden og reducerer rødme.
7. Nelumbo Nucifera (lotus) + Camellia Sinensis (grøn te) - antioxidanter, som beskytter mod tidlig aldring og miljøpåvirkninger.

**EGENSKABER:** cremens aktive ingredienser gør huden blød, fløjlsagtig og velplejet allerede efter første påføring og beskytter skånsomt mod vind og kulde. Ekstrakter af grøn te, kamille, lavendel og tea tree tilfører vitaminer og antioxidanter og bevarer hudens spændstighed og naturlige glød. Den lette, behagelige konsistens optages hurtigt uden at klistre.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens ansigtshuden.
2. Påfør den nødvendige mængde creme, og massér med fingerspidserne, til den er helt optaget.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 100 ml.




# BODY MOISTURE MASSAGE GEL

FUGTGIVENDE MASSAGEGEL TIL KROPPEN

Genopbygger | Fugter | Ledende

**PROBLEMOMRÅDER:** tør hud og behov for mikrostrømsmassage.

**FORDELE:** fugt, genopbygning og effektiv mikrostrømsmassage.

**INGREDIENSER:** Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

AKTIVE INGREDIENSER:

1. Trehalose (1%) - binder effektivt fugt, holder huden fugtet, beskytter mod ydre irritanter og reducerer oxidativt stress. Styrker hudbarrieren og er egnet til følsom hud.
2. Betaine (1%) er en naturlig ingrediens til aktiv fugtpleje. Lindrer irritation, beroliger huden og gør den glat og elastisk.
3. Niacinamide (3%) hæmmer melaninproduktionen og forbedrer og lysner hudtonen. Regulerer overskydende talg og forebygger betændelse. Fremmer ceramidsyntesen og styrker hudens beskyttelse. Udjævner hudstrukturen og mindsker fine rynker.
4. Adenosine (0.04%) - stimulerer kollagenproduktionen for elastisk, ungdommelig hud. Beroliger irriteret hud, reducerer betændelse og fremmer genopbygning.
5. Kompleks med 7 peptider (0.1%) - øger kollagen- og elastinproduktionen og dermed hudens elasticitet. Forebygger aldringstegn, mindsker fine rynker og fremmer hudcellernes fornyelse og genopbygning.
6. Hydrolyseret kollagen (0.1%) - tilfører fugt dybt i huden og giver dyb, langvarig fugt. Øger fasthed og elasticitet. Hjælper med at genopbygge beskadiget hud.

7. Madecassoside (0.1%) - beroliger følsom hud og reducerer betændelse. Beskytter og bevarer en sund hudbarriere og fremskynder hudreparation og sårheling.
8. Kompleks med 22 aminosyrer (0.1%) - tilfører essentielle aminosyrer til sund hud. Binder fugt og gør huden blød og elastisk. Forbedrer hudstrukturen og fremmer cellefornyelse.
9. Hyaluronsyre (0.1%) - hjælper med at fastholde tilført fugt og forebygger tørhed. Holder huden fast og glat. Beroliger følsom hud og bevarer fugtbalancen.
10. PDRN (polynukleotider, 0.01%) - fremmer cellestofskiftet og reparerer beskadiget hud. Styrker huden og mindsker rynker. Reducerer rødme og heler huden.

**EGENSKABER:** den fugtgivende kropsmassagegel er udviklet til strømledning ved mikrostrømsterapi, elektromyostimulation og RF-løft. Gelkonsistensen passer perfekt til massageapparater, fugter, tørrer langsomt ind og efterlader ingen klistret eller stram fornemmelse. De aktive ingredienser bevarer hudens glathed, elasticitet og ungdommelige udseende.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør på tør, renset kropshud.
2. Udfør behandlingen med et WAU-kropsmassageapparat, og lad gelen blive helt optaget.
3. Påfør eventuelt fugtcreme eller serum efter behandlingen.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 300 ml.




# CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

TONENDE CREME TIL HUDEN OMKRING ØJNENE

Fugter og blødgør i dybden

Reducerer træthedstegn

Opfrisker

Reducerer hævelser

**PROBLEMOMRÅDER:** mørke rande, hævelser, spor efter stress og søvnmangel samt aldersforandringer.

**FORDELE:** synligt mere ensartet hudtone, færre hævelser, tættere og mere elastisk hud samt udglatning af smilerynker.

**INGREDIENSER:** Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Dexpanthenol (høj koncentration) - heler intensivt, beroliger og genopbygger beskadiget epidermis.
2. Tranexamsyre + glutathion - en kraftig kombination til blokering af melaninsyntese; fjerner pigmentpletter og lysner mørke rande.
3. Koffein - stimulerer lymfedrænage, fjerner overskydende væske og reducerer hurtigt morgenhævelser.
4. Glucosylrutin (P-vitamin) - styrker kapillærvæggene, mindsker deres blålige synlighed og forebygger skrøbelige blodkar.
5. Vækstfaktorkompleks (6 typer sh-Polypeptide / Oligopeptide) - sætter cellefornyelsen i gang, stimulerer hudens egen kollagenproduktion og virker løftende.

6. Vitaminkompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - nærer, forbedrer cellestofskiftet og giver sund glød.
7. Niacinamide - styrker barrierefunktionen og forbedrer hudstrukturen.

**EGENSKABER:** cremen giver omfattende pleje af den sarte hud omkring øjnene. Høje koncentrationer af koffein, niacinamid og tranexamsyre hjælper med at mindske mørke rande, hævelser og fine rynker. De aktive ingredienser stimulerer fornyelse, fugter og nærer dybt og giver elastisk hud med en ensartet, strålende tone.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør lidt produkt på tør, renset hud fra den indre øjenkrog mod tindingerne, først langs den nedre og derefter den øvre øjenhuleknogle.
2. Fordel cremen, og massér med fingerspidserne.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 25 g.**




# CLEANSING BALM

HYDROFIL RENSEBALM

Renser skånsomt

Nærer i dybden

Fugter intensivt

Styrker hudbarrieren

**PROBLEMOMRÅDER:** holdbar makeup, rester af SPF-filtre, tilstoppede porer, tør og stram hud efter rensning samt beskadiget lipidbarriere.

**FORDELE:** ren og fugtet hud uden stram fornemmelse.

**INGREDIENSER:** Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Rigt kompleks af naturlige olier (ricinus, jojoba, solsikke, hasselnød, argan, shea) - opløser fedtopløselige urenheder (talg, holdbar makeup, SPF) og nærer og blødgør huden dybt.
2. Syv former for hyaluronsyre (bl.a. Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid) giver intensiv fugt i flere lag og forebygger udtørring under vask.
3. Ceramidkompleks (NS, AP, AS, NP, EOP) - genopretter og styrker effektivt epidermis' beskyttende lipidbarriere.
4. E-vitamin (Tocopherol) og Niacinamide er kraftige antioxidanter, som beskytter, beroliger og udjævner hudtonen.
5. Vitaminkompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - giver ekstra næring, forbedrer cellestofskiftet og understøtter sund glød.

**EGENSKABER:** balmen renser effektivt og skånsomt og opløser let makeup, SPF og snavs. Det rige oliekompleks nærer og blødgør dybt. Syv former for hyaluronsyre og ceramider fugter intensivt og styrker barrieren. E-vitamin og niacinamid beskytter og beroliger. Huden bliver ren og fugtet uden at føles stram.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør lidt hydrofil balm med tørre hænder på tørt ansigt, og fordel jævnt med massagebevægelser.
2. Fugt hænderne, og skyl med varmt vand; ved kontakt med vand bliver balmen mælkeagtig.
3. Fortsæt med andet rensetrin (renseskum eller rensegel).

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 50 g.**




# COLD & TONED BODY MILK

BODYLOTION MED KØLENDE EFFEKT

Reducerer hævelser

Fugter og fornyer huden

Anticellulitepleje

Genopretter spændstighed og fasthed

**PROBLEMOMRÅDER:** tab af elasticitet og slap hud, tendens til hævelser og tunge ben, trist tone og ujævn overfladestruktur, dehydrering og stram hud samt behov for restitution efter fysisk aktivitet.

**FORDELE:** kølende effekt, lethedsfornemmelse og dyb fugt, mere tonet silhuet, øget hudturgor, mindre synlig cellulite og glat, fløjlsblød hud.

**INGREDIENSER:** Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
Køling og toning
1. Menthyl Lactate + Menthol - rent mentol og dets milde derivat giver behagelig kølighed, som varer længere end almindeligt mentol uden at irritere huden. Det lindrer følelsen af tunge ben.
2. Koffein (Caffeine) - giver lymfedrænage, stimulerer mikrocirkulationen og hjælper med at fjerne overskydende væske.

Kompleks mod hævelser og til toning
1. Aesculus Hippocastanum (hestekastanje) er blandt de bedste ingredienser til at styrke karvæggene og bekæmpe hævelser.
2. Hedera Helix (vedbend) + Laminaria (tang) - øger hudens elasticitet. Vedbend bruges ofte i anticelluliteprodukter til fedtnedbrydning og udskillelse af toksiner.
3. Citrus Medica Limonum (citron) - opfrisker og hjælper med at styrke kapillærerne.

Genopbygning og fugt
1. Aloe Barbadensis (aloe vera) er en basis i formlen (anden ingrediens) og virker kraftigt beroligende og fugtgivende.
2. Sodium Hyaluronate (hyaluronsyre) - binder fugt i de øvre hudlag.
3. Niacinamide (B3-vitamin) - forbedrer hudbarrieren, udjævner tonen og hjælper ved mikroskader.

Nærende base (olier)
1. Sheasmør, jojobaolie, sød mandelolie og vindruekerneolie - effektive nærende olier, som gør huden blød og fløjlsagtig.

**EGENSKABER:** den lette, kølende bodylotion toner straks huden og giver dyb fugt. Koffein, tangekstrakt og Centella asiatica giver kraftig lymfedrænage. Naturlige ekstrakter og olier genopretter lipidbarrieren og gør huden blød og glat. Regelmæssig brug strammer synligt huden op og mindsker ujævnheder.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør lidt lotion på ren, tør kropshud.
2. Massér let, til den er helt optaget. Vær særlig opmærksom på problemområder.

**FORHOLDSREGLER:** kun til udvortes brug. Indeholder kølende ingredienser. Undgå øjne og slimhinder. Brug ikke på beskadiget eller irriteret hud. Stop ved tegn på individuel intolerance.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 250 ml.




# COLD & TONED BODY SCRUB

KROPSSCRUB MED KØLENDE EFFEKT

Reducerer hævelser

Dybderensning og hudfornyelse

Anticellulitepleje

Genopretter spændstighed og fasthed

**PROBLEMOMRÅDER:** tab af elasticitet og slap hud, tendens til hævelser og tunge ben samt ujævn hudstruktur.

**FORDELE:** mere ensartet overflade og glat hud, færre synlige hævelser og fastere kropskonturer.

**INGREDIENSER:** Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

Rensning og køling

1. Maris Sal (havsalt) - virker slibende og fjerner forhornede hudceller.
2. Menthyl Lactate + Menthol - rent mentol og dets milde derivat giver behagelig kølighed, som varer længere end almindeligt mentol uden at irritere huden. Det lindrer følelsen af tunge ben.

Kompleks mod hævelser og til toning

1. Caffeine + L-Carnitine - koffein fjerner væske og toner, mens L-carnitin hjælper med at reducere omfanget.
2. Aesculus Hippocastanum (hestekastanje) + Hedera Helix (vedbend) - styrker kapillær- og venevægge og forebygger lymfestagnation.
3. Hamamelis Virginiana (troldnød) - virker sammentrækkende og beroligende, mindsker porerne og styrker karnettet.

Nærende base (olier og panthenol)

1. Jojoba- og abrikosolie - mildner saltets påvirkning, forebygger udtørring og genopretter lipidbarrieren efter eksfoliering.
2. Panthenol - beroliger huden og lindrer mulig irritation fra aktiv massage og salt.

**EGENSKABER:** den kølende scrub med havsalt og koffein renser og eksfolierer dybt, udjævner overfladen og reducerer hævelser. Planteekstrakter og L-carnitin giver kraftig lymfedrænage, styrker karvæggene og øger elasticiteten. Regelmæssig brug øger hudens elasticitet mærkbart og gør den mere tonet og glat.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør på fugtig kropshud, massér i cirkler i 2-3 minutter, og skyl med varmt vand.
2. Brug 1-2 gange om ugen.

**FORHOLDSREGLER:** kun til udvortes brug. Indeholder kølende ingredienser. Undgå øjne og slimhinder. Brug ikke på beskadiget eller irriteret hud. Stop ved tegn på individuel intolerance.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 300 g.**




# DEEP MOISTURE BODY CREAM

FUGTGIVENDE KROPSCREME

Beroliger | Fugter | Blødgør

**PROBLEMOMRÅDER:** tørhed, dehydrering og irritation.

**FORDELE:** beroliger, øger hudens fasthed og elasticitet, nærer og fugter intensivt og aktiverer genopbygning.

**INGREDIENSER:** Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Beta-glucan - giver dyb fugt, styrker hudens lokale immunitet, har tydelig anti-age-effekt, „genopliver" huden og giver fasthed og elasticitet.
2. Timianbladekstrakt - modvirker fordampning, så huden forbliver fugtet længe, ser sund ud og bliver elastisk. Har også lysnende og antioxidativ effekt.
3. Æblemyntebladekstrakt - virker antibakterielt og beroligende, opfrisker og bekæmper irritation.
4. Tebladekstrakt (Camellia Sinensis) - normaliserer huden ved at fremskynde stofskiftet. Tebladenes stoffer forebygger hævelser og renser porerne. Polyfenolernes antioxidative egenskaber kan forebygge tidlig hudaldring

**EGENSKABER:** cremen bruger PTD-teknologi (Protein Transduction Domain), der anses for den mest effektive metode til at føre aktive ingredienser ind i hudcellerne og sikre maksimal næringsoptagelse. Den silkebløde konsistens optages hurtigt uden at klistre. Naturlige olier og ekstrakter nærer og beroliger dybt og hindrer fugttab, så huden holder sig glat og fugtet længe.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens huden før påføring.
2. Påfør den nødvendige mængde, og massér med fingerspidserne, til produktet er helt optaget.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 300 ml.




# IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

KONCENTRERET MUNDSKYL OG SKYLLEVÆSKE TIL MUNDSKYLLER MED CETYLPYRIDINIUM-CHLORID OG SALVIE

Effektiv rensning af mundhulen

Giver frisk ånde

Understøtter mundslimhindens og tandkødets sundhed

Forbedrer mundskyllerens virkning

**PROBLEMOMRÅDER:** Tandbelægninger, tandkødssygdomme, dårlig ånde, forebyggelse af caries.

**FORDELE:** Bekæmper skadelig mikroflora i mundhulen, virker beroligende og betændelseshæmmende og kombinerer rensning med mundskyllerens masserende og forebyggende virkning.

**INGREDIENSER:** Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Cetylpyridiniumchlorid er en effektiv antibakteriel ingrediens. Bekæmper bakterier, som forårsager plak, caries, tandkødsbetændelse og dårlig ånde, og giver langvarig friskhed.
2. Salvieekstrakt og det bioantioxidante ginsengkompleks "Neovitin®" beroliger og genopbygger slimhinden. De virker betændelseshæmmende, fremmer vævsheling og styrker tandkødets sundhed.
3. Xylitol reducerer risikoen for caries og hæmmer væksten af sygdomsfremkaldende bakterier i mundhulen, fremmer tandemaljens remineralisering og opretholder en sund pH-balance.
4. Æterisk mynteolie giver frisk ånde og har en kølende og let smertestillende virkning. Den virker antibakterielt, renser munden og giver en følelse af renhed.

**EGENSKABER:** Mundskyl og væske til mundskyller 2 i 1 normaliserer mundhulens mikroflora, forbedrer slimhindens tilstand og forebygger caries. Som almindeligt mundskyl renser den mundhulen for skadelig mikroflora, forebygger plak og dårlig lugt, forbedrer slimhindens og tandkødets tilstand og giver en frisk fornemmelse. Som væske til mundskyller kombinerer den rensning med en masserende og forebyggende virkning.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Som mundskyl: Tilbered den nødvendige mængde opløsning ved at fortynde koncentratet med varmt vand i forholdet 1:2, og skyl mundhulen i 30 sekunder. Brug dagligt efter hvert måltid.
2. I en mundskyller: Tilbered den nødvendige mængde opløsning ved at fortynde koncentratet med varmt vand i forholdet 1:10 (ved alvorlige tandkødsproblemer kan forholdet ændres til 1:3), og skyl mundhulen i henhold til apparatets vejledning.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Omryst før brug. Bundfald og farveændringer kan forekomme på grund af naturlige ingredienser. Stop brugen ved ubehag.
2. Må ikke synkes.
3. Til voksne og børn over 14 år.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 430 ml.




# MILKY ESSENCE TONER

ANSIGTSTONER MED PROBIOTIKA

Nærer og beroliger

Udjævner hudtonen

Styrker hudbarrieren

Fugter intensivt

**PROBLEMOMRÅDER:** Svækket lipidbarriere, fugtmangel, tørhed og stramhed efter vask, mat hudtone, følsomhed og ubalance i hudens mikrobiom.

**FORDELE:** Huden fugtes i dybden, beroliges og forberedes til videre pleje; den beskyttende barriere genoprettes, og hudtonen bliver jævn og strålende.

**INGREDIENSER:** Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Lysatkompleks (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - probiotika, som genopretter et sundt hudmikrobiom, reducerer følsomhed og styrker det lokale immunforsvar.
2. Ceramidkompleks (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - fysiologiske lipider, som indlejres i beskadigede områder af hornlaget og effektivt genopbygger den beskyttende barriere og forebygger fugttab.
3. Ekstrakt af asiatisk centellas blade er en effektiv naturlig ingrediens, som beroliger huden og lindrer rødme og irritation.
4. Niacinamide - styrker barrierefunktionen og forbedrer hudstrukturen.
5. Kompleks af vækstfaktorer (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - sætter gang i cellefornyelsen og stimulerer hudens egen kollagenproduktion med en løftende virkning.

6. Vitaminkomplekset (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) og dexpanthenol nærer, forbedrer cellernes stofskifte og giver huden en sund glød samt heler og genopbygger overhuden intensivt.
7. Kompleks af naturlige olier (raps, solsikke, engkarse og argan) - nærer intensivt, blødgør huden og afhjælper tørhed.

**EGENSKABER:** Toneren giver intensiv fugt og genopbygning og forbereder huden til videre pleje. Komplekset af lactobacilluslysater og ceramider styrker effektivt hudens beskyttende barriere og opretholder mikrobiomets naturlige balance. Asiatisk centella, niacinamid, peptider og planteekstrakter beroliger, nærer og udjævner hudtonen og giver huden et sundt, strålende udseende.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Spray en passende mængde toner på ansigtet efter vask.
2. Vent, til den er tør, og afslut plejen med serum eller creme.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 150 ml.




# MOISTURE MASSAGE GEL

FUGTGIVENDE GEL TIL ELEKTROSTIMULATIONSBEHANDLINGER

Fugter intensivt

Genopbygger

Ledende

Lysner pigmentering

**PROBLEMOMRÅDER:** tør hud og behov for mikrostrømsmassage.

**FORDELE:** fugt, genopbygning og effektiv mikrostrømsmassage.

**INGREDIENSER:** Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (ekstrakt af unshiu-mandarin) er gelens fugtgivende base (i stedet for vand). En kraftig naturlig antioxidant, som lysner pigmentering.
2. Niacinamide (niacinamid) - vitamin B3. Forbedrer barrierefunktionen, mindsker porerne og udjævner hudtonen.
3. Tranexamic Acid (tranexamsyre) er en af de mest effektive moderne ingredienser mod pigmentering og rødme.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) er det velkendte muskelafslappende peptid. Afslapper ansigtsmusklerne og reducerer dybden af mimiske rynker.
5. Copper Tripeptide-1 (kobberpeptid) - sætter gang i regenereringsprocesser, stimulerer syntesen af kollagen og elastin og heler skader.
6. Gruppen af sh-peptider (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide osv.) er signalmolekyler, som får huden til at forny sig hurtigere og styrker dens struktur.

7. Adenosine (adenosin) - en gennemprøvet ingrediens mod hudens aldring, som øger hudens egen kollagenproduktion.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (idebenon), den kraftigste antioxidant i kosmetikkens verden (beslægtet med coenzym Q10), beskytter cellerne mod oxidativt stress.
9. Hydrolyzed Collagen (hydrolyseret kollagen) - giver en øjeblikkelig løftende virkning og dyb fugt.
10. Centella Asiatica (asiatisk centella) + Madecassoside (madecassosid) - beroliger huden skånsomt, styrker blodkarrene og lindrer inflammation.
11. Panthenol (panthenol) - heler og binder fugt.
12. Et kompleks af aminosyrer (glutamin, arginin, lysin, valin osv. - mere end 20 i alt) er byggestenene i hudens proteiner. I kombination med mikrostrøm hjælper de med at bevare hudens elasticitet og evne til at hele sig selv.

**EGENSKABER:** Fugtgivende gel til mikrostrøms- og EMS-behandlinger med en let, behagelig konsistens og et aktivt kompleks baseret på mandarinekstrakt med niacinamid, kollagen, panthenol og planteekstrakter. Den fugter i dybden, blødgør og beroliger huden og giver apparaterne et perfekt glid uden en klistret eller stram fornemmelse.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør produktet på tør, renset ansigtshud.
2. Udfør behandlingen med et elektrisk stimulerende massageapparat. Lad gelen blive siddende, indtil den er helt absorberet.
3. Afslut plejen med et fugtgivende produkt (creme eller serum).

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå kontakt med øjnene. Skyl grundigt med vand, hvis produktet kommer i kontakt med øjets slimhinde.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 150 ml.




# PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

PEPTIDSERUM TIL ANSIGTET MED LØFTENDE VIRKNING

Reducerer rynker

Udglatter hudens struktur

Løftende effekt

Fugter i dybden

**PROBLEMOMRÅDER:** Mindre tydelige ansigtskonturer, tab af hudelasticitet, mimiske rynker og folder samt "træt" hud.

**FORDELE:** Synligt glattere og fastere hud, en jævn hudtone, mindre porer og en glød, som kommer indefra.

**INGREDIENSER:** Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Guld forbedrer mikrocirkulationen og giver huden en sund glød.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) - et muskelafslappende peptid, som afslapper ansigtsmusklerne skånsomt og reducerer dybden af mimiske rynker.
3. Kompleks af vækstfaktorer (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - stimulerer celledeling og kollagensyntese og sætter gang i regenereringsprocesser.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 trænger dybt ind i huden og stimulerer produktionen af kollagen type I og III, hvilket styrker læderhudens struktur.
5. Fytoøstrogener (soja, kudzu, kløver og sølvlys) er et meget effektivt kompleks til at korrigere aldersforandringer. De kompenserer for manglen på hudens egne ressourcer og genskaber elasticiteten.

6. Copper Tripeptide-1 (kobbertripeptid) - har en kraftig helende og antioxidant virkning og gør huden fastere.
7. Niacinamid og adenosin er en klassisk koreansk "duo" til at lysne pigmentering og reducere rynker.

**EGENSKABER:** Ansigtsserummet med peptider og en høj koncentration af aktive ingredienser forbedrer hudens spændstighed og udglatter rynker synligt. Mikropartikler af guld stimulerer celleaktiviteten og får huden til at se glattere, fastere og sundere ud.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør en lille mængde serum på ansigt, hals og dekolletage.
2. Lad serummet sidde på huden, indtil det er helt absorberet.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte kontakt med øjet. Skyl grundigt med vand, hvis produktet kommer i kontakt med øjets slimhinde.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 30 ml.**




# PORE CLEANSING GEL

GEL TIL DESINKRUSTATION (RENSNING)

Eksfolierer døde hudceller

Åbner porerne

Beroliger

Fugter

**PROBLEMOMRÅDER:** Udvidede porer, åbne og lukkede komedoner samt akne.

**FORDELE:** Eksfolierer døde hudceller, åbner porerne og fugter.

**INGREDIENSER:** Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Polyvinylpyrrolidon absorberer urenheder og har antiseptiske egenskaber.
2. Aloe vera-saft har en betændelseshæmmende virkning.

**EGENSKABER:** Gelen bruges til kold opblødning før ultralydsrensning og manuel ansigtsrensning. Gelen er egnet til alle hudtyper, også følsom hud.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

Første metode, desinkrustation med galvanisk strøm: Påfør gelen på huden, og behandl med den negative pol i 7-10 minutter. Fjern alle gelrester. Behandl derefter med den positive pol på rent vand i 1-2 minutter. Gelforbrug: 5-7 ml pr. behandling.

Anden metode, ultralydspeeling: Påfør gelen på renset hud, og behandl med spatlen i henhold til behandlingsprotokollen. Fjern alle gelrester. Gelforbrug: 7-10 ml pr. behandling.

Tredje metode, kold opblødning: Efter fjernelse af makeup påføres gelen i et tykt lag på huden i 15 minutter og dækkes med film. Vask gelresterne af.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Undgå direkte sollys efter påføring for at undgå forbrændinger, kløe, rødme og hævelse.
2. Må ikke påføres beskadiget hud.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 100 ml.




# THERMAL PROTECTION

VARMEBESKYTTENDE CREMEFLUID TIL HÅRET

Beskytter mod varme ved styling

Nærer og genopbygger håret

Giver sundt og velplejet hår

**PROBLEMOMRÅDER:** Udsættelse for høje temperaturer samt mat, skrøbeligt og livløst hår.

**FORDELE:** Beskytter mod høje temperaturer, styrker og nærer håret.

**INGREDIENSER:** Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. D-panthenol (provitamin B5) fugter hår og hovedbund intensivt og trænger dybt ind i hårets struktur. Genopbygger beskadigede områder og gør håret glattere, mere elastisk og blankt. Beskytter mod udtørring og varmepåvirkning.
2. Hvedekimolie er rig på vitaminer (E, A, D) og fedtsyrer. Nærer og genopbygger tørt og beskadiget hår i dybden og giver det silkeblødhed og et sundt udseende. Danner en beskyttende barriere mod skadelige ydre påvirkninger.
3. Kompleks af planteekstrakter (granatæble, birk, kamille, agerpadderok, brændenælde, aloe vera, burre rod, grøn te, humle, henna, hirse og salvie:
Granatæbleekstrakt er en kraftig antioxidant, som beskytter håret mod miljøets negative påvirkninger og frie radikaler. Det hjælper med at bevare farvet hårs farve og giver glans og vitalitet. Ekstrakter af padderok, brændenælde, burre rod, hirse og humle styrker hårsækkene, reducerer hårtab og stimulerer hårvækst. Aloe vera, kamille og birk fugter og blødgør håret i dybden, gør det medgørligt og glat, beroliger hovedbunden og reducerer irritation. Grøn te, henna og salvie har antioxidante egenskaber, beskytter mod skader og giver håret naturlig glans og et sundt udseende.
4. Biotin (vitamin H / B7) styrker hårsækkene, fremmer væksten af sundt og stærkt hår og forebygger skrøbelighed og hårtab. Giver håret fylde og vitalitet.

5. Niacin (vitamin B3 / PP) forbedrer mikrocirkulationen i hovedbunden, så hårsækkene får flere næringsstoffer. Aktiverer hårvækst, styrker hårets struktur og giver en sund glans.
6. Lecithin (naturlig emulgator) hjælper med at genopbygge beskadiget hår og giver blødhed og glathed. Forbedrer optagelsen af andre aktive ingredienser.

**EGENSKABER:** Cremefluiden beskytter effektivt håret mod høje temperaturer ved styling (hårtørrer, styler, glattejern) og giver samtidig omfattende pleje: Den fugter intensivt, nærer, genopbygger beskadigede områder, styrker hårsækkene, stimulerer hårvækst og giver glans, silkeblødhed og et sundt, velplejet udseende.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør i rent, håndklædetørt hår.
2. Må ikke påføres hårrødderne. Skal ikke skylles ud.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Stop brugen ved ubehag.
2. Skyl grundigt med vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 100 ml.




# TRICHO SOLUTION HAIR MASK

KONCENTRERET MASKE TIL HÅRVÆKST

Nærer hovedbund og hår

Beskytter og genopbygger hovedbunden

Stimulerer hårvækst

Gør håret let at rede ud

**PROBLEMOMRÅDER:** Hårtab, udtynding samt tyndt og skrøbeligt hår.

**FORDELE:** Bekæmper hårtab, fremmer væksten af nyt hår, styrker håret og gør det tykkere, stærkere og mere elastisk samt beroliger hovedbunden.

**INGREDIENSER:** Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

**AKTIVE INGREDIENSER:**
Stimulering af vækst og bekæmpelse af hårtab
1. Caffeine (koffein) forbedrer blodets mikrocirkulation og sikrer tilførsel af næringsstoffer til rødderne samt hjælper med at blokere hormonernes negative indvirkning på hårtab.
2. Procapil er et peptidkompleks bestående af 3 aktive molekyler:
Biotinoyl Tripeptide-1 (biotinoyltripeptid-1) er et specialiseret peptid, som styrker hårsækkens forankring i læderhudens dybe lag og fremskynder celledeling, hvilket fremmer væksten af nyt hår.
Oleanolic Acid (oleanolsyre) er en syre udvundet af olivenblade, som blokerer enzymet 5-alfa-reduktase og forebygger hårtab.
Apigenin (apigenin) er et flavonoid fra citrusfrugter, som udvider blodkarrene og stimulerer blodcirkulationen omkring hårsækkene, så de får næring.

Genopbygning af hårets struktur
1. Hydrolyzed Keratin (hydrolyseret keratin) trænger ind i hårets hulrum, genopbygger det indefra og reducerer porøsitet.
2. Hydrolyzed Wheat Protein (hvedeproteiner) danner en tynd film på hårets overflade, som binder vand og fremmer dyb fugttilførsel.
3. Hydrolyzed Collagen (hydrolyseret kollagen) øger hårets elasticitet og gør det mere medgørligt og blankt.

Pleje af hovedbunden
1. Ceramidkompleks (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 typer ceramider kompenserer for manglen på hudens egne lipider og styrker hudens og hårets beskyttende barriere.
2. Hydrogenated Lecithin (hydrogeneret lecithin) forstærker ceramidernes virkning, gør huden blød og beskytter mod skadelige miljøpåvirkninger.
3. Panthenol (panthenol) beroliger hovedbunden øjeblikkeligt og fremmer heling af mikroskader.

Næring og glans
1. Cocos Nucifera Oil er den eneste olie, som kan trænge ind i hårets dybe lag (marven), nære håret indefra og genopbygge dets lipidlag. Reducerer proteintab fra håret betydeligt under vask og varmestyling og hjælper dermed med at holde hårets struktur stærk og holdbar.
2. Laminaria Digitata Extract tilfører hud og hår mineraler og sporstoffer og bidrager til ekstra fugt.

**EGENSKABER:** Masken er baseret på peptidkomplekset Procapil og virker direkte på hårsækkene, hvilket styrker rødderne og fremmer hårvækst. Ceramidkomplekset genopbygger beskadiget hår, fugter hovedbunden i dybden, afhjælper tørhed og danner en beskyttende barriere mod negative miljøpåvirkninger. Koffein toner, stimulerer blodcirkulationen i hovedbunden og forebygger hårtab. Kokosolie nærer og giver håret glans og styrke. Keratin og hvedeproteiner genopbygger beskadiget hårs skællag, reducerer skrøbelighed og forebygger spaltede spidser. Brug af masken styrker hårsækkene, stopper hårtab og aktiverer væksten af nyt hår.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør i hovedbunden med masserende bevægelser, og fordel i hårets længder.
2. Lad virke i 5-10 minutter, og skyl derefter ud med varmt vand.

**FORHOLDSREGLER:** Kun til udvortes brug. Skyl med rigeligt vand ved kontakt med øjnene. Individuel intolerance over for enkelte ingredienser kan forekomme.

**OPBEVARING:** Tørt og beskyttet mod lys ved en temperatur fra +5 ° til +25 ° C og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 300 ml.




# TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

SERUM TIL HÅRVÆKST

Hjælper med at forebygge inflammation, kløe og tørhed i hoved-bunden

Stimulerer hårvækst

Forbedrer hårets tæthed

Modvirker hårtab

**PROBLEMOMRÅDER:** Alopeci, hårtab, udtynding samt tyndt og skrøbeligt hår.

**FORDELE:** Bekæmper hårtab, fremmer væksten af nyt hår, styrker håret og gør det tykkere.

**INGREDIENSER:** Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxa-mer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
Stimulering af vækst og bekæmpelse af hårtab
1. Capixyl (3%) er en kombination af Acetyl Tetrapeptide-3 og Trifolium Pratense-ekstrakt. Dette kompleks virker på hårroden, øger dens størrelse og styrker dens forankring i huden samt lindrer mikroinflammation.
2. Procapil er et peptidkompleks bestående af 3 aktive molekyler:
Biotinoyl Tripeptide-1 (biotinoyltripeptid-1) er et specialiseret peptid, som styrker hårsækkens for-ankring i læderhudens dybe lag og fremskynder celledeling, hvilket fremmer væksten af nyt hår.
Oleanolic Acid (oleanolsyre) er en syre udvundet af olivenblade, som blokerer enzymet 5-alfa-reduktase og forebygger hårtab.
Apigenin (apigenin) er et flavonoid fra citrusfrugter, som udvider blodkarrene og stimulerer blodcirkulationen omkring hårsækkene, så de får næring.
Copper Tripeptide-1 (kobberpeptid) "forynger" hovedbunden, forlænger hårets vækstfase (ana-gen) og stimulerer kollagenproduktionen omkring hårsækken.

Cellulær energi og stofskifte
1. Adenosine (adenosin) aktiverer produktionen af vækstfaktorer på celleniveau og hjælper håret med at vokse tykkere og stærkere.
2. Succinic Acid (ravsyre) stimulerer stofskifteprocesserne i hudcellerne og hjælper hårsækkene med at komme sig hurtigere efter stress.

Forbedring af mikrocirkulation og udrensning
1. Menthol giver øjeblikkelig blodtilførsel til hårsækkene gennem en mild kølende virkning, som forstærker peptidernes effekt.
2. Rosmarinus Officinalis Extract (rosmarinekstrakt) virker antiseptisk og stimulerer naturligt blodcirkulationen kraftigt.
3. Hydrolyzed Wheat Protein styrker hårets struktur ved roden og forebygger skrøbelighed.

**EGENSKABER:** Serummet er baseret på peptidkomplekserne Capixyl og Procapil og virker direkte på hårsækkene, hvilket styrker rødderne og fremmer aktiv hårvækst. Kombinationen af kobberpeptid-1 og adenosin forynger hovedbunden på celleniveau, øger tætheden og forlænger hvert hårs livscyklusfase. Ravsyre og menthol toner, forbedrer celleåndingen og stimulerer blodcirkulationen, så næringsstoffer straks leveres til hårsækkene. Rosmarinekstrakt og hvedeproteiner plejer hovedbunden, genopbygger beskadiget hårs struktur ved roden og reducerer skrøbelighed. Regelmæssig brug af serummet styrker hårsækkene effektivt, stopper for tidligt hårtab og aktiverer væksten af nyt, sundt hår.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Spray serummet i hovedbunden.
2. Gnid ind i huden med lette massagebevægelser. Skal ikke skylles ud.

**FORHOLDSREGLER:** Kun til udvortes brug. Påføres hovedbund og skæg. Stop brugen ved irritation. Individuel intolerance over for enkelte ingredienser kan forekomme.

**OPBEVARING:** Tørt og beskyttet mod lys ved en temperatur fra +5 ° til +25 ° C og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 200 ml.




# TRICHO SOLUTION SCALP GEL

RENSENDE PEELINGGEL TIL HOVEDBUNDEN

Dybderensning af hovedbunden

Hjælper med at forebygge skæl

Stimulerer hårvækst

Fornyer overhuden

**PROBLEMOMRÅDER:** Fedtet hovedbund, urenheder, kløe, tør hud og tendens til skæl samt utilstrækkelig næring til hårsækkene.

**FORDELE:** Håret holder sig rent og løst ved rødderne længere, får fylde ved rødderne, og hårvæksten fremskyndes.

**INGREDIENSER:** Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

Rensning

1. Lactic Acid (mælkesyre) er en mild AHA-syre, som eksfolierer døde hudceller og giver skånsom fornyelse og glans ved hårrødderne.
2. Glycolic Acid (glykolsyre) har det mindste molekyle blandt AHA-syrerne og trænger derfor dybere og hurtigere ind. Nedbryder effektivt proteinbindingerne mellem døde hudskæl og forebygger hyperkeratose.
3. Salicylic Acid (salicylsyre) er den eneste BHA-syre i sammensætningen. Den er fedtopløselig og kan derfor trænge ind i hårsækken og opløse talgpropper (sebum). Den er en vigtig ingrediens til at modvirke fedtet hud og forebygge inflammation.
4. Citric Acid virker som supplerende eksfoliant og pH-regulator.

Fugt og beskyttelse

1. Hydroxyethyl Urea (hydroxyethylurinstof) er en af de bedste fugtgivende ingredienser i kosmetik. Binder fugt i overhudens dybe lag, mildner syrernes virkning og forebygger en stram fornemmelse efter behandlingen.
2. Calendula Officinalis Flower Extract er en velkendt beroligende ingrediens. Lindrer irritation, virker antiseptisk og fremskynder regenereringen af mikroskader i huden.

Styrkelse af håret og stimulering af vækst
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (menthol og mynteolie) giver en tydelig kølende virkning. Det er både behageligt og gavnligt: Menthol stimulerer blodtilførslen til hårsækkene, hvilket kan bidrage til at styrke håret og fremme hårvækst.

**EGENSKABER:** Den rensende hovedbundsgel med et kompleks af AHA- og BHA-syrer fjerner døde hudceller, overskydende talg og rester af stylingprodukter i dybden, normaliserer hydrolipidbalancen og forbereder huden til intensiv pleje. Regelmæssig brug forbedrer hovedbundens tilstand og forebygger tørhed og afskalning, så håret får mere fylde og bliver sundere.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør en lille mængde gel jævnt i skilningerne på tør eller let fugtig hovedbund.
2. Massér forsigtigt med fingerspidserne i 1-2 minutter for at fordele produktet jævnt.
3. Lad virke i 5-10 minutter (ved første brug anbefales det at starte med 5 minutter).
4. Skyl grundigt med varmt vand og shampoo. Anbefalet brug: 1-2 gange om ugen.

**FORHOLDSREGLER:** Kun til udvortes brug. Skyl med rigeligt vand ved kontakt med øjnene. Individuel intolerance over for enkelte ingredienser kan forekomme.

**OPBEVARING:** Tørt og beskyttet mod lys ved en temperatur fra +5 ° til +25 ° C og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 150 ml.




# UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SOLCREME MED SPF50+

UV-beskyttelse

Fugter uden fedtet glans

Hjælper med at forebygge aldersrelaterede forandringer

Korrigerer hudtonen

**PROBLEMOMRÅDER:** UV-påvirkning, lysbetinget hudaldring, pigmentering, ujævn hudtone, tørhed og hudirritation fra solen.

**FORDELE:** Huden beskyttes pålideligt mod sollys, fugtes i dybden, får en jævn tone og beskyttes mod lysbetinget aldring.

**INGREDIENSER:** Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Kemiske solfiltre (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) absorberer effektivt ultraviolet lys og giver pålidelig beskyttelse mod UVA- og UVB-stråler (de vigtigste årsager til lysbetinget hudaldring).
2. Niacinamid styrker barrierefunktionen, udjævner hudtonen og forbedrer hudens struktur.
3. Kompleks af planteekstrakter (asiatisk centella, kamille, grøn te, troldnød og portulak) plejer huden skånsomt, beroliger intensivt, lindrer rødme og fremkalder ikke irritation.
4. Adenosin modvirker hudens aldring og hjælper med at udglatte rynker og forbedre hudens elasticitet.
5. Vitamin E (Tocopheryl Acetate) er en kraftig antioxidant, som yderligere beskytter cellerne mod frie radikaler og negative miljøpåvirkninger.

**EGENSKABER:** Solserummet plejer huden skånsomt, beroliger den og giver pålidelig beskyttelse mod UVA- og UVB-stråler, som er de vigtigste årsager til lysbetinget hudaldring. Formlen med planteekstrakter og niacinamid fugter huden intensivt og udjævner hudtonen uden at irritere.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør cremeserummet på tør hud, og fordel jævnt på ansigt og hals.
2. Lad produktet blive absorberet i 15 minutter.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte kontakt med øjet. Skyl grundigt med vand, hvis produktet kommer i kontakt med øjets slimhinde.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 50 ml.**




# VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM TIL EN JÆVN HUDTONE OG GLØD

Udjævner hudtonen

Giver mere glød

Fugter

Styrker hudbarrieren

**PROBLEMOMRÅDER:** Mat hudtone, pigmentering, ujævn tone, fugtmangel, svækket beskyttende barriere og tab af elasticitet.

**FORDELE:** Huden bliver glat, elastisk, strålende og fugtet og får en jævn tone.

**INGREDIENSER:** Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Vitamin C (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) og glutathion er en kraftig kombination, som lysner pigmentering, bidrager til en jævn hudtone og giver huden en sund glød.
2. Niacinamide - styrker barrierefunktionen og forbedrer hudstrukturen.
3. Syv former for hyaluronsyre giver dyb fugt på flere niveauer ved at trænge ind i forskellige lag af overhuden.
4. Ceramidkomplekset (NP, NS, AP, AS, EOP) og tremellaekstrakt nærer huden og genopbygger og styrker effektivt den beskyttende lipidbarriere.
5. Asiatisk centella (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) beroliger intensivt, heler og lindrer rødme.

6. Kompleks af vækstfaktorer (sh-Polypeptide / Oligopeptide) sætter gang i cellefornyelsen og stimulerer hudens egen kollagenproduktion med en løftende virkning.
7. Vitaminkompleks (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - nærer, forbedrer cellestofskiftet og giver sund glød.
8. Dexpanthenol heler intensivt, beroliger og genopbygger beskadiget overhud.

**EGENSKABER:** Et kompleks af aktive ingredienser med glutathion, vitamin C, niacinamid og asiatisk centella hjælper serummet med at udjævne hudtonen og give glød. Syv former for hyaluronsyre giver dyb fugt på flere niveauer. Ceramider og tremellaekstrakt styrker den beskyttende barriere og nærer huden, så den bliver glat, elastisk og strålende.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør en lille mængde serum på ansigtet.
2. Lad serummet sidde på huden, indtil det er helt absorberet.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Det anbefales at udføre en allergitest før brug.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 30 ml.**




# PETIT RA HUDPLEJE




# ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PLEJE MOD HUDENS ALDRING FRA PETIT RA

Bremser aldring

Nærer og fugter intensivt

Understøtter regenerering

Forbedrer fastheden

**PROBLEMOMRÅDER:** Tegn på aldring af ansigtshuden, tør hud samt tab af fugt og elasticitet.

**FORDELE:** Bremser aldring, nærer og fugter intensivt, fremmer regenerering og øger hudens fasthed og elasticitet.

**INGREDIENSER:** Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Hydrolyseret kollagen øger hudens fasthed og elasticitet ved at tilføre fugt.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) anerkendes som en effektiv erstatning for Botox (Botoxin) og virker effektivt mod rynker. Reducerer desuden spor af rynker ved at svække muskelsammentrækninger.
3. Palmitoyltripeptid-5 sætter gang i kollagensyntesen og hjælper med at genopbygge hudens struktur.
4. Hexapeptid-10 er en uundværlig ingrediens til at genoprette hudens pH-balance og øger hudens elasticitet, tæthed og spændstighed.
5. Adenosin virker betændelseshæmmende og mod rynker, stimulerer kollagensyntesen og øger hudens elasticitet og gennemtrængelighed.
6. Asiatisk centella er kendt for sin regenererende virkning. Bladene og stilken indeholder madecassosid, som hjælper med at fjerne irritation, rødme og hudskader.

**EGENSKABER:** Serummet har en unik sammensætning med meget effektive ingredienser mod tegn på hudens aldring. Et unikt kompleks af peptider, kollagen og hyaluronsyre modvirker hudens ufuldkommenheder. Det reducerer også rynker, giver en synlig løftende virkning, forbedrer hudtonen og genopbygger skader, hvilket forbedrer hudens samlede tilstand.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

Første metode: Rens ansigtshuden grundigt, og påfør en lille mængde serum med lette klappende bevægelser. Lad serummet sidde på huden, indtil det er helt absorberet.

**ANDEN METODE:** Rens ansigtshuden grundigt, påfør en passende mængde produkt på tør hud, og udfør behandlingen med et ansigtsmassageapparat fra WAU. Lad serummet sidde på huden, indtil det er helt absorberet.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN: 50 ml.**




# ANTI-AGING CARE STEM CELL

CREME MOD HUDENS ALDRING MED STAMCELLER FRA PETIT RA

Bremser aldring

Nærer og fugter intensivt

Understøtter regenerering

Forbedrer fastheden

**PROBLEMOMRÅDER:** Tegn på hudens aldring og tab af hudelasticitet.

**FORDELE:** Bremser aldring, nærer og fugter intensivt, fremmer regenerering og øger hudens fasthed og elasticitet.

**INGREDIENSER:** Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Stamcellekulturmedium 2% - udglatning af rynker.
2. Niacinamid genopretter hudens beskyttende funktion.
3. Caprylsyre har bakteriostatiske egenskaber.
4. Hyaluronsyre binder fugt og forhindrer fordampning.
5. Misteltenekstrakt har antiseptiske egenskaber.
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) eksfolierer og fugter effektivt og forbedrer ved længere tids brug hudens struktur og øger

dens elasticitet og spændstighed.
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptid-8) er et lavmolekylært peptid, som let trænger ind i huden og kontrollerer udskillelsen af adrenalin og noradrenalin, hvilket hjælper med at udglatte rynker og øge hudens elasticitet.

**EGENSKABER:** Den multifunktionelle serumcreme består af stamceller og 56 andre aktive ingredienser, som udglatter rynker, opstrammer huden og gør den glat og strålende. Cremen bruger et IRB-godkendt, 100% ufortyndet humant stamcellekulturmedium, som spiller en vigtig rolle i regenereringen af beskadiget væv og i at give huden elasticitet.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens ansigtshuden grundigt før påføring af serumcremen.
2. Påfør den nødvendige mængde produkt, og massér huden med fingerspidserne, indtil det er helt absorberet.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 40 g.




# LIPO JEUNE

CREME MOD MØRKE RANDER UNDER ØJNENE FRA PETIT RA

Stimulerer stamcellernes stofskifte

Udglatter rynker

Forbedrer øjenkonturens tilstand og spændstighed

**PROBLEMOMRÅDER:** Mørke rander under øjnene, de første aldringstegn og rynker.

**FORDELE:** Forbedrer hudtonen omkring øjnene, stimulerer stamcellernes stofskifte og hjælper dermed med at udglatte rynker samt beskytter huden mod skader.

**INGREDIENSER:** Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Niacinamid - denne form for vitamin B3 har en fremragende lysnende virkning, hjælper med at forbedre hudtonen, forebygger inflammation og genopbygger hudbarrieren.
2. Bisabolol blokerer processen, hvor melanin samles, og hæmmer produktionen i de tidlige stadier.
3. WhiteTenTM (niacinamid, acetylglucosamin, madecassosid, ekstrakt af hvid morbærbark, Malus pumila-frugtekstrakt, matsutakesvampeekstrakt, Oxalis triangularis-ekstrakt, tebladekstrakt (Camellia sinensis), Broussonetia kazinoki-rodekstrakt, Camellia japonica-blomsterekstrakt) er et unikt lysnende kompleks baseret på ekstrakter af 10 planter. Giver effektiv lysning af huden ved at blokere overgangen af melanocytter til keratinocytter.
4. Edelweiss-fytostamceller - edelweiss-stamcellekulturen er rig på antioxidanter, som hæmmer oxidativt stress,

og kulturen er effektiv til at reducere irritation og regenerere hudvæv.
5. LotuStem™ (butylenglycol, vand, Andrographis paniculata-ekstrakt) aktiverer celledeling.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) anerkendes som en effektiv erstatning for Botox (Botoxin) og virker effektivt mod rynker. Reducerer desuden spor af rynker ved at svække muskelsammentrækninger.
7. Hydrolyseret kollagen øger hudens elasticitet og tæthed ved at tilføre fugt.
8. Eosidin® (propandiol, vand, ekstrakt af unshiu-mandarinskal) er et unikt kompleks med en betændelseshæmmende virkning takket være citrusfrugternes indhold af antioxidanter og flavonoider.
9. Adenosin virker betændelseshæmmende og mod hudens aldring, fremmer kollagensyntesen og forbedrer hudens elasticitet.

**EGENSKABER:** Cremen har en unik sammensætning, som lysner og toner huden omkring øjnene og udglatter rynker. Edelweiss-kulturekstrakt og det patenterede LotuStemTM stimulerer stamcellernes stofskifte og hjælper med at udglatte rynker omkring øjnene. Den FDA-godkendte White Ten-formel med 10 planteekstrakter forbedrer hudtonen omkring øjnene.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Rens ansigtshuden grundigt før påføring af cremen.
2. Påfør den nødvendige mængde produkt, og massér huden med fingerspidserne, indtil det er helt absorberet.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 50 ml.




# O2 DETOX CLEANSING GEL

ILTRENSEGEL TIL ANSIGTET FRA PETIT RA

Renser | Mindsker porerne | Beroliger | Forbedrer fastheden

**PROBLEMOMRÅDER:** Udvidede porer og øget talgproduktion.

**FORDELE:** Renser, mindsker porerne, øger elasticiteten og beroliger.

**INGREDIENSER:** Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

**AKTIVE INGREDIENSER:**
1. Acrylatcopolymer danner et tyndt lag på huden, som øger næringsstoffernes vedhæftning/gennemtrængelighed og har en langvarig virkning. Fugter og omslutter huden skånsomt efter vask.
2. Cocamidopropylbetain danner et blødt skum og virker rensende.
3. Disodium Cocoamphodiacetate er en skånsom, ikke-irriterende rensende ingrediens, som er egnet til følsom hud.
4. Citronfrugtekstrakt hæmmer fugtfordampning og bidrager dermed til at fugte huden. Virker beroligende, forebygger mathed og forbedrer hudtonen.
5. Ekstrakt af almindeligt æbles frugt beskytter huden mod oxidation og gør hudtonen klarere.
6. Ekstrakt af sød appelsin hjælper med at beskytte huden mod oxidation fra frie radikaler, som er den vigtigste årsag til hudens aldring.

**EGENSKABER:** Ved kontakt med ilt danner gelen skum og virker skånsomt på huden. Produktet bekæmper effektivt urenheder, hjælper med at fjerne makeup og overskydende talg og mindsker porerne. Produktet er egnet til alle hudtyper og anbefales til kvinder i alle aldre.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Påfør en lille mængde produkt på tør ansigtshud med særlig opmærksomhed på T-zonen.
2. Iltbobler viser sig efter få sekunder og når deres maksimale antal efter 1 minut. Massér huden med fingerspidserne eller en rensebørste for at danne et tættere skum.

3. Skyl grundigt med vand. Fortsæt med din sædvanlige dag- eller natpleje.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 120 ml.




# PAD CYPRESS TONIC

BEROLIGENDE ANSIGTSPADS FRA PETIT RA

Renser | Opfrisker | Mindsker porerne | Beroliger | Fugter

**PROBLEMOMRÅDER:** Udvidede porer, øget talgindhold i huden samt en følelse af tørhed og stramhed.

**FORDELE:** Renser, toner, mindsker porerne, beroliger og fugter huden.

**INGREDIENSER:** Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Aloe vera-bladekstrakt blødgør og fugter læderhuden og genopbygger dens struktur. Hjælper med at afhjælpe afskalning og tørhed og genopbygger hud beskadiget af sollys eller andre irritanter.
2. Ekstrakt af japansk yamsrod modvirker skadelige elementer i huden og mindsker skader på problemhud.
3. Ulmus davidiana-rodekstrakt beroliger følsom hud og udjævner hudtonen.
4. Vild yamsrodsekstrakt har antioxidante og betændelseshæmmende egenskaber, hjælper mod akne og alle typer inflammation, forynger huden og øger dens spændstighed.
5. Vioblomstekstrakt beskytter mod stress og skadelige miljøpåvirkninger, beskytter og beroliger huden og giver glød og elasticitet. Egnet til pleje af inflammeret, uren og skællende hud.
6. Lakridsrodsekstrakt lysner huden og bekæmper frie radikaler, som forårsager tidlig hudaldring. Har betændelseshæmmende og antiseptiske egenskaber. Særligt egnet til fedtet hud.
7. Kamilleblomstekstrakt beroliger og blødgør effektivt følsom hud med tendens til rødme. Hæmmer aktiveringen af proteinet NF-KB og regulerer dermed inflammatoriske processer.
8. Asiatisk centellaekstrakt - planten er kendt for sin regenererende virkning og indeholder madecassosid i blade og stilk, som hjælper med at fjerne

irritation, rødme og hudskader.
9. HerbExTM Rosemary Extract (rosmarinbladekstrakt, vand, 1.3-butylenglycol) beskytter huden mod frie radikaler, som er den vigtigste årsag til hudens aldring.

**EGENSKABER:** Kosmetiske ansigtspads gennemvædet med en nærende toner baseret på cypres renser, beroliger og fugter huden samt fjerner skånsomt rester af kosmetik og urenheder. Padsene består af 100% bomuld, som giver fremragende kontakt med huden. Det bløde materiale ligger tæt mod huden og øger tonerens virkning. Aloe og asiatisk centella i sammensætningen fremskynder hudcellernes genopbygning, afhjælper irritation effektivt og beroliger huden efter UV-påvirkning samt ved kulde og vindpåvirkning af ansigtet. Produktet er egnet til alle hudtyper og anbefales til kvinder i alle aldre.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

Første metode: Tag en pad ud af krukken, og tør ansigtshuden for at rense den.

**ANDEN METODE:** Tag en pad ud af krukken, og brug den med et ansigtsmassageapparat fra WAU med Sonic-teknologi for en mere effektiv indtrængning af næringsstoffer.

Tredje metode: Brug som maske 1-2 gange om ugen. Anbring padsene på det ønskede ansigtsområde i 5-10 minutter, fjern dem derefter, og fordel produktresterne på hudens overflade.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 200 ml (70 stk.).




# PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

LØFTENDE ANSIGTSPADS FRA PETIT RA

Beroliger

Forbedrer hudens fasthed

Løftende effekt

**PROBLEMOMRÅDER:** Tør hud og de første aldringstegn.

**FORDELE:** Beroliger og øger hudens elasticitet.

**INGREDIENSER:** Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Ekstrakt af unshiu-mandarinfrugt og grapefrugt beroliger huden, øger dens elasticitet, virker betændelseshæmmende, bekæmper pigmentering og lysner huden.
2. Sparassis crispa-ekstrakt modvirker UV-strålingens negative virkninger, fugter intensivt, styrker beskyttelsesfunktionerne, reducerer vævsfølsomhed og hjælper med at bevare hudens fugt.
3. Sophora flavescens-rodekstrakt, fermenteret ekstraktfiltrat af Suaeda japonica-blade/rødder/stilke, Camellia sinensis-bladekstrakt og citronfrugtekstrakt beroliger huden og styrker dens naturlige barriere.
4. Andrographis paniculata-ekstrakt understøtter hudens elasticitet og kollagensyntese.
5. Ekstrakt af hvid mistelten fjerner aktivt ilt, som dannes på huden, forebygger og bremser hudens aldring og styrker hudbarrieren.
6. 2 typer peptider (tripeptid-10-citrullin, tripeptid-1) gør huden mere elastisk.
7. Adenosin virker betændelseshæmmende og mod rynker, stimulerer kollagensyntesen og øger hudens elasticitet og gennemtrængelighed.

8. Niacinamid - denne form for vitamin B3 har en fremragende lysnende virkning, hjælper med at forbedre hudtonen, forebygger inflammation og genopbygger hudbarrieren.

**EGENSKABER:** Kosmetiske ansigtspads gennemvædet med en toner med løftende virkning baseret på et peptidkompleks bekæmper pigmentering og aldersrelaterede hudforandringer. Padsene består af 100% bomuld, som giver fremragende kontakt med huden. Det bløde materiale ligger tæt mod huden og øger tonerens virkning. Ginsengrodekstrakt i sammensætningen bidrager til at udglatte rynker, modvirker UV-strålernes negative virkning og virker betændelseshæmmende. Produktet er egnet til alle hudtyper og anbefales til kvinder i alle aldre.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

Første metode: Tag en pad ud af krukken, og tør ansigtshuden for at rense den.

**ANDEN METODE:** Tag en pad ud af krukken, og brug den med et ansigtsmassageapparat fra WAU med Sonic-teknologi for en mere effektiv indtrængning af næringsstoffer.

Tredje metode: Brug som maske 1-2 gange om ugen. Anbring padsene på det ønskede ansigtsområde i 10-20 minutter, fjern dem derefter, og fordel produktresterne på hudens overflade.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 200 ml (70 stk.).




# SOS BODY FIT

ANTICELLULITECREME FRA PETIT RA

Modvirker cellulite

Øger stofskifteprocesserne

Genopretter fastheden

Forbedrer elasticiteten

**PROBLEMOMRÅDER:** Cellulite, tab af kropshudens fasthed og elasticitet samt en følelse af tørhed og stramhed.

**FORDELE:** Fjerner cellulite, fremskynder stofskifteprocesserne, genopretter spændstigheden og øger hudens elasticitet.

**INGREDIENSER:** Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Lactobaciller/fermenteret sojaekstrakt giver fremragende fugt.
2. Risekstrakt indeholder anthocyanin, vitamin C og β-caroten, som giver kraftige antioxidante funktioner. Olien fra risskaller fugter huden og bekæmper bakterier.
3. Ekstrakt af vilde sojabønnefrø fremmer hudcellernes regenerering, virker som antioxidant og hjælper med at forbedre cellernes stofskifte.
4. Ekstrakt af indiske sesamfrø har et højere indhold af selen, tocopherol og andre antioxidanter end almindelig sesam, hvilket gør det i stand til at bekæmpe rynker og styrke hudens elasticitet.
5. Solsikkefrøolie beroliger inflammation og irritation i huden.
6. Olivenolie bremser hudens aldring og beskytter mod UV-stråler. Virker som antioxidant, blødgør og fugter huden og styrker dens immunfunktion.
7. HerbExTM Green tea Extract (butylenglycol, vand, tebladekstrakt (Camellia sinensis)) har en antioxidant og betændelseshæmmende virkning og bekæmper rynker.

8. HerbExTM Lavender Extract (vand, butylenglycol, ekstrakt af ægte lavendel) beroliger huden ved at aktivere hudcellernes livscyklus, så de hurtigere kan flytte til et nyt hudlag. Bekæmper inflammatoriske processer og reducerer antallet af betændelsestilstande.

**EGENSKABER:** Den formende anticellulitecreme med unikke naturlige ingredienser aktiverer stofskifteprocesser, bidrager til at øge hudens fasthed og elasticitet, forbedrer lymfestrømmen og fugter i dybden.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**

Første metode: Tag et bad med en scrub på de kropsområder, som skal masseres. Påfør cremen på problemområderne, og massér med et EMS/RF-kropsmassageapparat. Afslut behandlingen med massage med LED-terapi. Fordel cremeresterne med hænderne, og lad dem sidde på huden, indtil de er helt absorberet.

Anden metode: Påfør produktet på kroppen, og fordel med cirkelbevægelser. Efter påføring mærkes en tydelig varme i huden. Klap hen over problemområderne (f.eks. lår, mave og ryg). Stimulér blodcirkulationen ved at klemme huden med hænderne og bevæge dig mod de områder, der kræver korrektion. Lad cremeresterne sidde på huden, indtil de er helt absorberet. Vask omhyggeligt cremeresterne af hænderne med vand.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Cremen må ikke bruges under graviditet eller ved allergi over for soja.
3. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
4. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
5. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 200 ml.




# SPICULE EYE CREAM

ØJENCREME FRA PETIT RA

Bremser aldring

Forbedrer mikrocirkulationen

Antioxidantvirkning

Udglatter rynker

**PROBLEMOMRÅDER:** Aldringstegn, mørke rander under øjnene og rynker.

**FORDELE:** Bremser aldring, forbedrer mikrocirkulationen, virker som antioxidant, fremmer hudens regenerering samt lysner og udglatter rynker.

**INGREDIENSER:** Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

**AKTIVE INGREDIENSER:**

1. Niacinamid - denne form for vitamin B3 har en fremragende lysnende virkning, reducerer også synligheden af udvidede porer, fugter huden og forebygger pigmentpletter.
2. STeMiNTM, et medium konditioneret af humane stamceller, forbedrer hudforyngelsen gennem stamcellernes fedtstoffer, som indeholder mere end 50 forskellige vækstfaktorer.
3. PDRN (polydeoxyribonukleotider) er byggesten til reparation af beskadiget DNA i aldrende hudceller. Ved påføring på huden hjælper det med at mindske porer, udglatte rynker og regenerere huden.
4. Hydrolyseret kollagen øger hudens elasticitet og tæthed ved at tilføre fugt.
5. HerbExTM Hyaluron (butylenglycol, vand, sodium hyaluronate crosspolymer) - hyaluronsyre kan binde en mængde vandmolekyler, som er 1000 gange større end sig selv, og spiller derfor en meget vigtig rolle i at beskytte, fugte, smøre og styrke huden.

6. Eosidin® (propandiol, vand, ekstrakt af unshiu-mandarinskal) er et unikt kompleks med en betændelseshæmmende virkning takket være citrusfrugternes indhold af antioxidanter og flavonoider.
7. LotuStem™ (butylenglycol, vand, Andrographis paniculata-ekstrakt) aktiverer celledeling.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) fremmer hurtig celleformering og kollagensyntese i beskadigede områder. Er meget effektiv mod irritation og inflammation og fremmer regenerering af aldrende hud.
9. SUPER EGF (EGF - epidermal vækstfaktor, sh-oligopeptide-1) - peptider med epidermal vækstfaktor fremmer formeringen af kollagenholdige fibroblaster og nærer huden.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptid-8) anerkendes som en effektiv erstatning for Botox (Botoxin) og virker effektivt mod rynker. Reducerer desuden spor af rynker ved at svække muskelsammentrækninger.
11. Adenosin virker betændelseshæmmende og mod rynker, stimulerer kollagensyntesen og øger hudens elasticitet og gennemtrængelighed.

**EGENSKABER:** Den foryngende øjencreme indeholder naturlige mikronåle fra ferskvandssvampe (spikler), som åbner tusindvis af mikrokanaler i huden. Det gør det muligt for cremens aktive ingredienser at trænge ind i hudens dybeste lag og give en synlig løftende virkning. Micro Needling Treatment (foryngelse med mikronåle) hjælper med at aktivere hudens genopbyggende funktioner gennem mild irritation.

**SÅDAN BRUGES APPARATET:**
1. Produktet anbefales brugt i forløb på 3 til 10 dage med et interval på 1 til 2 uger.
2. Påfør lidt produkt på tør, renset hud fra den indre øjenkrog mod tindingerne, først langs den nedre og derefter den øvre øjenhuleknogle.
3. Fordel cremen, og massér med fingerspidserne.

**FORHOLDSREGLER:**
1. Test før brug på indersiden af albuebøjningen for at undgå allergiske reaktioner. Stop ved irritation eller udslæt.
2. Påfør ikke produktet på beskadiget hud.
3. Undgå direkte øjenkontakt. Skyl med varmt vand ved kontakt med øjnene.
4. Påfør gerne SPF-creme efter brug for at beskytte mod sollys.

**OPBEVARING:** i lukket emballage ved +5 °C til +25 °C, væk fra direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**VOLUMEN:** 2 pakker a 10 g.




# KOSTTILSKUD




# A + E COMPLEX

VITAMIN A & E KOMPLEKS (SOFTGELS, 700 mg)

Understøtter knoglers, musklers og nervesystemets funktion

Understøtter normalt stofskifte

Understøtter immunforsvaret

Sundt hår, sund hud og sunde negle

**PROBLEMOMRÅDER:** Tørhed og afskalning af huden, skrøbelige negle og tab af neglepladernes naturlige glans, svaghed og svækket immunforsvar.

**INGREDIENSER:** DL-alfa-tocopherylacetat (vitamin E), Raffineret vegetabilsk olie (solsikke), Kapselskal (gelatine, glycerol (fortykningsmiddel), vand), Vitamin A.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Vitamin A - 2.6 mg
- Vitamin E - 100 mg

**INDTAGELSE:** Under måltidet med vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt. Den anbefalede dosis må ikke overskrides for at undgå hypervitaminose A og E.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Vitamin A - 325%**
**Vitamin E - 1000%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 2-3 uger. Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Overfølsomhed, hypervitaminose A og E, børn og unge (under 18 år), graviditet og amning.
2. Udvis særlig forsigtighed ved tyreotoksikose, kolecystitis, tilstande med øget karpermeabilitet (kronisk hjertesvigt, kronisk glomerulonefritis osv.) samt ved levercirrose, viral hepatitis, nyresvigt, alkoholisme, høj alder og hypoprotrombinæmi.

**STOFTYPE:** Fedtopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Coenzym Q10, jern, zink og vitamin C.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia. Hold et interval på 2-3 timer ved kombination med vandopløselige vitaminer.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# ALPHA LIPOIC ACID

ALFA-LIPOSYRE (CELLULOSEKAPSLER, 450 mg)

Understøtter hjerte-kar-systemets og leverens sundhed

Vægtkontrol og støtte til stofskiftet

Bremser aldring

Blodsukkerkontrol

**PROBLEMOMRÅDER:** Forstyrrelser i kulhydrat- og lipidstofskiftet, oxidativt stress, træthed og energitab samt langsomt stofskifte.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Maltodextrin (bærestof), Alfa-liponsyre, Gelatinekapsel, Siliciumdioxid (antiklumpningsmiddel).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**Alfa-liponsyre - 100 mg**

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt sammen med et måltid.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Alfa-liponsyre - 333%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og amning.

**STOFTYPE:** Fedtsyre.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Coenzym Q10, jern, zink og vitamin C.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Blodsukkersænkende lægemidler og jern.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# ARTHRO ACTIVE

LEDSSTØTTEKOMPLEKS (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 450 mg)

Genopbygning af sener og ledbånd efter skade eller operation

Forbedrer leddenes bevægelighed

Understøtter genopbygning af brusk

Styrker knoglevævet

**PROBLEMOMRÅDER:** Ubehag og smerter i leddene, stive bevægelser og nedbrydning af bruskvæv.

**INGREDIENSER:** Methylsulfonylmethan, Hydrolyseret fiskekollagen, Kapselskal (gelatine), L-a-scorbinsyre (vitamin C), Astaxanthin.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Methylsulfonylmethan - 250 mg
- Kollagen - 167.5 mg
- Vitamin C - 22.5 mg
- Astaxanthin - 0.5 mg

**INDTAGELSE:** 2 kapsler 2 gange dagligt under måltider med vand.

**ANBEFALET DOSIS: 4 kapsler dagligt.**

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(4 KAPSLER):**
- Methylsulfonylmethan - ikke fastlagt.
- Kollagen - ikke fastlagt.
- Vitamin C - 90%
- Astaxanthin - 100%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Indtagelsen kan om nødvendigt gentages efter 3-4 uger.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 80.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og amning.

**STOFTYPE:**
- Methylsulfonylmethan er et naturligt svovlholdigt organisk stof.
- Kollagen er vandopløseligt.
- Vitamin C er vandopløseligt.
- Astaxanthin er fedtopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Omega-3, vitamin D og calcium.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia. Tilskuddet optages dårligere ved samtidig indtagelse af NSAID.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# B-COMPLEX

B-VITAMINKOMPLEKS (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 360 mg)

Understøtter energiomsætningen

Støtte til nervesystemet

Sundt hår, sund hud og sunde negle

Understøtter hjerte og blodkar

**PROBLEMOMRÅDER:** Træthed, svaghed, følelsesløshed i arme og ben, angst samt problemer med hud, hår og slimhinder.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Kapselskal (gelatine), Vitamin B8 (inositol), Vitamin B3 (nikotinamid), Vitamin B5 (calcium-D-pantothenat), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (thiaminhydrochlorid), Vitamin B12 (cyanocobalamin), Vitamin B9 (folinsyre), Vitamin B7 (biotin).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Vitamin B8 - 50 mg
- Vitamin B3 - 30 mg
- Vitamin B5 - 8 mg
- Vitamin B2 - 4 mg
- Vitamin B6 - 4 mg
- Vitamin B1 - 3 mg
- Vitamin B9 - 0.4 mg

Vitamin B7 - 0.15 mg
- Vitamin B12 - 0.002 mg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt sammen med et måltid.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(1 KAPSEL):**
Vitamin B8 - 10%
Vitamin B3 - 166.7%
Vitamin B5 - 133.3%
Vitamin B2 - 250%
Vitamin B6 - 200%
Vitamin B1 - 214%
Vitamin B9 - 200%
Vitamin B7 - 300%
Vitamin B12 - 200%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og amning.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Magnesium, vitamin C, zink, jern, calcium og probiotika.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT: Koffein.**

**HOLDBARHED: 2 år.**




# BIOTIN

BIOTIN (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 385 mg)

Stimulerer hårvækst

Styrker hud, hår og negle

Hjælper med at holde blodsukkeret stabilt

**PROBLEMOMRÅDER:** Udtynding og hårtab, skrøbelige og spaltende negle samt tørhed og afskalning af huden.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Gelatinekapsel (gelatine, zinkoxid - farvestof), Biotin (vitamin B7), Calciumstearat (antiklumpningsmiddel).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**Biotin (vitamin B7) - 5000 mcg**

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt sammen med et måltid.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Biotin (vitamin B7) - 10000%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Nyresvigt.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** B-vitaminer, zink, selen og magnesium.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Høje doser vitamin C.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# CHLOROPHYLL

KLOROPHYLL (FLYDENDE KONCENTRAT, 500 ml)

Antibakteriel virkning

Understøtter immunforsvaret

Understøtter fordøjelsen

Foryngelse og udrensning

**PROBLEMOMRÅDER:** Forstyrrelser i mave-tarm-kanalen og svækket immunforsvar.

**INGREDIENSER:** Purified Water, Vegetabilsk glycerol (fortykningsmiddel), Tween 60 (emulgator), Kobberkomplekser af klorofylliner (naturligt fødevarefarvestof), Kaliumsorbat (konserveringsmiddel), Naturlig pebermynteolie.

**INDHOLDET AF DET AKTIVE STOF I 1 PORTION (15 ml):**
- **Klorofyl - 50 mg**
- **Kobber - 2 mg**

**INDTAGELSE:** En spiseskefuld (15 ml), fortyndet i 100 ml vand eller juice, 1 gang dagligt 30 minutter før et måltid. Ryst flasken før brug.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 portion (15 ml) 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (15 ml):**
- **Klorofyl - 50%**
- **Kobber - 200%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**VOLUMEN:** 500 ml.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Sygdomme forbundet med overskud af kobber i kroppen.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** B-vitaminer, vitamin C og probiotika.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Calcium og høje doser jern.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# CHROMIUM PICOLINATE

KROMPIKOLINAT (CELLULOSEKAPSLER, 410 mg)

Reducerer sukkertrang

Støtte til vægt og stofskifte

Vitamin C for optimal optagelse

**PROBLEMOMRÅDER:** Forstyrrelser i kulhydrat- og lipidstofskiftet, langsomt stofskifte, leverforstyrrelser og forhøjet kolesterol.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Cellulosekapsel (hydroxypropylmethylcellulose), L-ascorbinsyre (vitamin C), Chrompicolinat.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Vitamin C - 60 mg
- Chrom (III) - 250 µg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt om morgenen sammen med mad og vand.

**ANBEFALET DOSIS: 1 kapsel dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
- **Vitamin C - 100%**
- **Chrom (III) - 500%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Produktet er ikke beregnet til personer under 18 år.

**STOFTYPE:**
Chrom er et mineral.
- Vitamin C er vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Alfa-liponsyre, coenzym Q10, B-vitaminer, omega-3 og magnesium.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Blodsukkersænkende lægemidler, antikoagulantia og blodtrykssænkende lægemidler.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# COENZYME Q10 — 100 MG

COENZYME Q10, 100 mg (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 450 mg)

Bremser aldring

Styrker kroppen

Understøtter regenerering og heling

**PROBLEMOMRÅDER:** Aldersrelaterede forandringer, nedsat belastningstolerance, muskelsvaghed, øget træthed og nedsat ydeevne.

**INGREDIENSER:** Carboxymethylcellulose (bærestof), Ubiquinon (coenzym Q10), Kapsel (gelatine, renset drikkevand).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**Coenzym Q10 - 100 mg**

**INDTAGELSE:** Helst om morgenen under et måltid. Indtagelse af coenzym Q10 sammen med fedtholdige fødevarer kan øge optagelsen.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Coenzym Q10 - 333%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Mavesår og gastritis med forhøjet syreindhold.
4. Coenzym Q10 kan sænke blodtrykket og anbefales anvendt med forsigtighed hos personer med lavt blodtryk. Stoffet kan sænke et allerede lavt blodtryk yderligere.

**STOFTYPE:** Fedtopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Vitamin C og E, omega-3, alfa-liponsyre og carnitin.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia, blodtrykssænkende lægemidler og visse lægemidler mod diabetes og forhøjet kolesterol kan sammen med coenzym Q10 give kraftige muskelsmerter.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLETTER, 750 mg)

Understøtter immunforsvaret

Understøtter mænds sundhed

Understøtter hjernefunktion og ydeevne

Stimulerer produktionen af antioxidante enzymer

**PROBLEMOMRÅDER:** Aldersrelaterede forandringer, øget træthed, nedsat ydeevne, forebyggelse af lavt blodtryk og svækket immunforsvar.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (fyldstof), Ginsengekstrakt, Vegetabilsk calciumstearat (antiklumpningsmiddel), Rutin (vitamin P), Nikotinamid (vitamin PP), Ginsengbiomasse.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 TABLET:**
- **Panaxosid - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nicotinamid - 2 mg**

**INDTAGELSE:** 1 tablet 3 gange dagligt under måltider. Må ikke tages om aftenen.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 tablet 3 gange dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (3 TABLETTER):**
**Panaxosid - ikke fastlagt.**
- **Rutin - 23%**
- **Nicotinamid - 30%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 2-3 uger. Gentag efter 1 måned, hvis nødvendigt.

**TABLETTER PR. BEHOLDER: 90 stk.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Indtagelse om aftenen.
4. Øget nervøs opstemthed og søvnløshed.
5. Forhøjet blodtryk og forstyrrelser i hjertets funktion.
6. Svær åreforkalkning.
7. Nyresvigt.

**STOFTYPE:** Ginsengcellekultur.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Vitamin C og E.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia og blodtrykssænkende lægemidler.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# GLUCOSAMINE

GLUCOSAMIN MED CHONDROITIN (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 1100 mg)

Reducerer betændelse i leddene

Forbedrer leddenes smidighed og bevægelighed

**PROBLEMOMRÅDER:** Ubehag og smerter i leddene samt stive bevægelser.

**INGREDIENSER:** Glucosaminhydrochlorid, Chondroitinsulfat, Kapselskal (gelatine, titandioxid (farvestof)), Magnesiumstearat (antiklumpningsmiddel).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- **Glucosamin - 465 mg**
- **Chondroitin - 360 mg**

**INDTAGELSE:** Under måltidet med vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 3 gange dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (3 KAPSLER):**
- **Glucosamin - 199%**
- **Chondroitin - 180%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Forløbet kan gentages efter en pause på 2 uger.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Overfølsomhed over for produktets hoved- og hjælpestoffer.
2. Produktet bør ikke ordineres til patienter med allergi over for skaldyr, da det aktive stof (glucosamin) udvindes af bløddyr og krebsdyr.
3. Børnealder.
4. Graviditet og ammeperiode.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Omega-3, vitamin D og calcium.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia. Glucosamin optages dårligere ved samtidig indtagelse af NSAID.

**HOLDBARHED: 3 år**




# IRON CHELATE

JERNKELAT (20 BRUSETABLETTER PR. RØR, 3.8 G)

Reducerer træthed og øger ydeevnen

Understøtter immunsystemets aktivitet

Opretholder normale niveauer af jern, ferritin og hæmoglobin

**PROBLEMOMRÅDER:** Svaghed, døsighed, øget træthed og nedsat appetit.

**INGREDIENSER:** Glukose, Vandfri citronsyre (surhedsregulerende middel), Natriumhydrogencarbonat (surhedsregulerende middel), Jernbisglycinat, Naturlig æblearoma, Polyethylenglycol (stabilisator), Aspartam (sødestof). Indeholder en phenylalaninkilde.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 TABLET:**
**Jern - 14 mg**

**INDTAGELSE:** Om morgenen på tom mave eller til frokost med vand, æblejuice eller appelsinjuice.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 tablet 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 TABLET):**
**Jern - 100%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**TABLETTER PR. BEHOLDER: 20 stk.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Blodmangel, som ikke skyldes jernmangel.
2. Tegn på jernophobning (hæmosiderose, hæmokromatose).
3. Forstyrrelser i udnyttelsen af jern.
4. Graviditetens I trimester.
5. Øget følsomhed over for det aktive stof.

**STOFTYPE: Mineral.**

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Vitamin A, B3 og C, kobber og folinsyre.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Zink, magnesium, chrom, calcium og vitamin E.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# IRON CHELATE BISGLYCINATE

KELAT JERN (CELLULOSEKAPSLER, 450 mg)

Reducerer træthed og øger ydeevnen

Understøtter immunsystemets aktivitet

Opretholder normale niveauer af jern, ferritin og hæmoglobin

**PROBLEMOMRÅDER:** Svaghed, døsighed, øget træthed og nedsat appetit.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Jernbisglycinat, Gelatine, Ascorbinsyre (vitamin C), Kobbergluconat, Siliciumdioxid (antiklumpningsmiddel), Cyanocobalamin (vitamin B12).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Jern - 14 mg
- Kobber - 1.5 mg
- Vitamin C - 60 mg

Vitamin B12 - 4.5 mcg

**INDTAGELSE:** Om morgenen.

**ANBEFALET DOSIS:** Mænd: 1 kapsel dagligt, kvinder: 2 kapsler dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(1 KAPSEL):**
1 kapsel
- Jern - 143%
- Kobber - 150%
- Vitamin C - 100%

Vitamin B12 - 450% 2 kapsler
- Jern - 286%
- Kobber - 300%

Vitamin C - 200%
Vitamin B12 - 900%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Blodmangel, som ikke skyldes jernmangel.
2. Tegn på jernophobning (hæmosiderose, hæmokromatose).
3. Forstyrrelser i udnyttelsen af jern.
4. Graviditetens I trimester.
5. Øget følsomhed over for det aktive stof.

**STOFTYPE:** Vitaminer og mineraler.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# KELP SEA IODINE

JOD FRA TARE (TABLETTER, 700 mg)

Regulerer talgproduktionen

Antioxidantvirkning

Understøtter vævsregenerering

Understøtter produktionen af kønshormoner

**PROBLEMOMRÅDER:** Aldersrelaterede forandringer, svækket immunforsvar og hormonforstyrrelser.

**INGREDIENSER:** L-tyrosin, Tørret kelp (pulver), Mikrokrystallinsk cellulose (E460i, bærestof), Selenomethionin.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 TABLET:**
- **Jod - 400 µg**
- **Tyrosin - 330-380 mg**
- **Selen - 65 µg**

**INDTAGELSE:** 1 tablet 2 gange dagligt under måltider.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 tablet 2 gange dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(2 TABLETTER):**
- Jod - 533%
- Tyrosin - 15.7-17.3%

Selen - 173% for mænd, 236% for kvinder

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan fortsættes efter behov.

**TABLETTER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Tilstande, hvor jodpræparater er kontraindiceret.
4. For højt stofskifte.
5. Subakut thyroiditis.
6. Nyre- og leversvigt.

**STOFTYPE:** Mikronæringsstof.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** B-vitaminer, magnesium og zink.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT: Antioxidanter.**

**HOLDBARHED: 2 år.**




# KRILL OIL

KRILL OIL (SOFTGELS, 700 mg)

Sund hud, sunde negle og sundt hår

Understøtter hjernefunktionen

Hjertets og blodkarrenes sundhed

Understøtter immunforsvaret

**PROBLEMOMRÅDER:** Skrøbelige negle og skrøbeligt hår, mat hud, træthed, svækket immunforsvar samt forringet opmærksomhed og hukommelse.

**INGREDIENSER:** Atlantisk krillolie, kapselskal (oksegelatine, fugtighedsbevarende middel glycerin, renset vand).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- Krillolie - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Astaxanthin - 150 µg
- Fosfolipider - 100 mg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 3 gange dagligt under måltider.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 3 gange dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(3 KAPSLER):**
Krillolie - ikke fastlagt.
- EPA - 30%
- DHA - 12.9%
- Astaxanthin - 22.5%
- Fosfolipider - 4.3%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 90 stk.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Allergiske reaktioner over for fisk og skaldyr.
2. Børn under 3 år.
3. Individuel intolerance over for stofferne i produktet.
4. Blødning eller forstyrrelse i blodets størkning.
5. Astma.

6. Leversygdom.
7. Forskellige sygdomme i mave-tarm-kanalen i akut eller kronisk fase.
8. Tiden efter en operation.
9. Personer, som er i genoptræning efter en operation eller har skader af forskellig årsag, anbefales at rådføre sig med en læge, før de begynder eller genoptager indtagelse af krillolie.

**STOFTYPE: Flerumættede fedtsyrer.**

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Kollagen, calcium, magnesium, coenzym Q10, lecithin og vitamin A, E, B, C og D.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Reducerer biotilgængeligheden af jern, kobber og zink; indtag med 2-3 timers mellemrum.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# L-CARNITINE

L-CARNITIN (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 840 mg)

Reducerer træthed

Forbedrer stofskiftet

**PROBLEMOMRÅDER:** Hurtig udtrætning, nedsat ydeevne, overvægt og langsom restitution efter fysisk anstrengelse.

**INGREDIENSER:** L-carnitintartrat, Kapselskal (gelatine, fødevarefarvestof (titandioxid)), Magnesiumstearat (antiklumpningsmiddel).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**L-carnitin - 540 mg**

**INDTAGELSE:** Om morgenen på tom mave med varmt eller koldt vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**L-carnitin - 180%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 4-6 uger. Forløbet kan gentages efter en pause på 2-8 uger.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. For lavt stofskifte.

**STOFTYPE:** Aminosyre.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Omega-3.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Antikoagulantia og høje doser calcium og jern.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMAL C-VITAMIN (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 700 mg)

Understøtter immunforsvaret

Antioxidantvirkning

Understøtter normale oxidationsprocesser

**PROBLEMOMRÅDER:** Nedsat ydeevne, sløvhed, svaghed, døsighed, nedsat modstandskraft mod infektioner og langsom bedring ved forskellige sygdomme.

**INGREDIENSER:** Natriumascorbat (E301), Mikrokrystallinsk cellulose (E460i, bærestof), Rutin (ekstrakt af japansk pagodetræ (latin Sophorae Japonica), calciumstearat (E470a, stabilisator), liposomalt vitamin C-pulver, kapsel (hydroxypropylmethylcellulose (E464, fortykningsmiddel) eller gelatine).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- **Vitamin C - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt under et måltid.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
- **Vitamin C - 833 procent**
- **Rutin - 83%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan fortsættes efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Nyresten.
3. Hæmokromatose (overskud af jern).
4. Store doser bør ikke ordineres til patienter med øget blodstørkning, tromboflebitis og tendens til blodpropper samt ved diabetes mellitus og tilstande med højt blodsukker.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Vitamin A, E, B5 og B9.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Vitamin B1 og B12 samt kobber.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# MAGNESIUM CHELATE + B6

CHELAT MAGNESIUM + B6 (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 870 mg)

Reducerer nervesystemets ophidselighed

Hjælper med at forebygge muskelkramper

Understøtter normal hjerte-kar-funktion

Øger udholdenhed og ydeevne

**PROBLEMOMRÅDER:** Øget irritabilitet, nedsat hukommelse, søvnforstyrrelser, kramper, muskelsvaghed, hjerterytmeforstyrrelser og svimmelhed.

**INGREDIENSER:** Magnesiumbisglycinat (kelat), Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Gelatinekapsel, Pyridoxinhydrochlorid (vitamin B6).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- **Magnesium - 104 mg**
- **B6 - 1.5 mg**

**INDTAGELSE:** 2 kapsler 2 gange dagligt under måltider.

**ANBEFALET DOSIS: 4 kapsler dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (4 KAPSLER):**
**Magnesium - 104%**
- **B6 - 300%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 80.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Overfølsomhed over for de aktive stoffer.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Svært nyresvigt (kreatininclearance under 30 ml / min).
4. Børn under 6 år (effekt og sikkerhed er ikke fastlagt).
5. Arvelig galaktosæmi, glukose-galaktosemalabsorptionssyndrom eller laktasemangel (da produktet indeholder laktose).
6. Samtidig indtagelse af levodopa.

**STOFTYPE:**
Magnesium er et mineral.
• B6 er et vandopløseligt vitamin.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Vitamin B2-B12 og D.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Vitamin B1 og E, jern, fosfor, høje doser calcium og visse antibiotika (tetracyklin).

**HOLDBARHED: 2 år.**




# MAGNESIUM 4.0

MAGNESIUMKOMPLEKS (CELLULOSEKAPSLER, 876 mg)

Dyb afslapning og støtte ved stress

Energi og muskelfunktion

Understøtter hjerte og blodkar

Sund fordøjelse og skånsom rensning

**PROBLEMOMRÅDER:** Øget irritabilitet, nedsat hukommelse, søvnforstyrrelser, kramper, muskelsvaghed, hjerterytmeforstyrrelser og svimmelhed.

**INGREDIENSER:** Magnesiumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Vegetabilsk kapsel (hydroxypropylmethylcellulose som bærestof), Magnesiummalat, Magnesiumtaurat, Tomatfrugtpulver, Stearinsyrens magnesiumsalt (antiklumpningsmiddel), Pyridoxal-5-fosfat.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
- **Magnesium - 100 mg**
- **B6 - 0.25 mg**

| INDHOLD AF INGREDIENSER | (mg) PR. 1 KAPSEL |
|---|---|
| Magnesiumcitrat 365 | |
| Magnesiumbisglycinat 146 | |
| Magnesiummalat 110 | |
| Magnesiumtaurat 110 | |

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 2 gange dagligt under måltider.

**ANBEFALET DOSIS: 2 kapsler dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (2 KAPSLER):**
- **Magnesium - 50%**
- **B6 - 30%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Gravide og ammende kvinder bør indtage produktet efter lægens anbefaling og under lægeligt tilsyn.

**STOFTYPE:**
Magnesium er et mineral.
• B6 er et vandopløseligt vitamin.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Vitamin B2-B12 og D.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Vitamin B1 og E, jern, fosfor, høje doser calcium og visse antibiotika (tetracyklin).

**HOLDBARHED: 3 år.**




# MEN'S FORMULA

MÆND MULTIVITAMINKOMPLEKS (CELLULOSEKAPSLER, 580 mg)

Tilfører vitaminer og mineraler

Understøtter vitalitet og energi

Understøtter nervesystemet og kognitive funktioner

Understøtter mænds sundhed

Antioxidantbeskyttelse og støtte til immunforsvaret

Styrker knogler og tænder

**PROBLEMOMRÅDER:** Svækket immunforsvar, generel svaghed, øget irritabilitet, nedsat hukommelse og søvnforstyrrelser.

**INGREDIENSER:** Magnesiumcitrat, L-ascorbinsyre (vitamin C), Hydroxypropylmethylcellulose (kapsel), Calciumcarbonat, Inositol, Citrusbioflavonoider, Kaliumcitrat, Ginsengekstrakt, Sojaisoflavoner, Siliciumdioxid (antiklumpningsmiddel), Zinkcitrat, Nikotinamid (niacin), Magnesiumstearat (antiklumpningsmiddel), DL-alfa-tocopherol (vitamin E), Riboflavin (vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (vitamin B1), Pyridoxinhydrochlorid (vitamin B6), D-calciumpantothenat (pantothensyre), Mangangluconat, Kobbergluconat, Lycopen, Calcium-L-methylfolat (folinsyre), Chrompicolinat, D-biotin (vitamin B7), Retinol (vitamin A), Kaliumiodid, Molybdænglycinat, L-selenomethionin, Methylcobalamin (vitamin B12), Cholecalciferol (vitamin D3).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**

- Vitamin A - 0.055 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Vitamin D3 - 0.0035 mg
- Vitamin E - 3.33 mg
- Vitamin B1 - 2.5 mg
- Vitamin B2 - 3.0 mg

Vitamin B3 - 6.67 mg

- Vitamin B6 - 2.0 mg
- Folinsyre - 0.3 mg
- Vitamin B12 - 0.0045 mg
- Biotin - 0.075 mg
- Pantothensyre - 2.0 mg
- Calcium - 100 mg
- Magnesium - 133.3 mg
- Zink - 6.67 mg
- Selen - 0.02 mg
- Kobber - 0.5 mg
- Mangan - 0.67 mg
- Chrom - 0.125 mg

• Molybdæn - 0.02 mg
• Inositol - 33.3 mg
• Sojaisoflavoner - 8.35 mg
• Lycopen - 0.33 mg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 2 gange dagligt i dagens første halvdel.

**ANBEFALET DOSIS: 2 kapsler dagligt.**

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS
**(2 KAPSLER):**
• Vitamin A - 14%
Vitamin C - 33%
Vitamin D3 - 140%
Vitamin E - 66%
Vitamin B1 - 357%
Vitamin B2 - 375%
Vitamin B3 - 74%
Vitamin B6 - 200%
Folinsyre - 300%
Vitamin B12 - 900%
• Biotin - 300%
• Pantothensyre - 67%
• Calcium - 20%
• Magnesium - 67%
• Zink - 89%
• Selen - 57%
• Kobber - 100%
• Mangan - 67%
• Chrom - 500%
• Molybdæn - 57%
• Inositol - 13%
• Sojaisoflavoner - 33%
• Lycopen - 13%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for kosttilskuddets ingredienser.
2. Øget nervøs opstemthed og søvnløshed.
3. Forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser og svær åreforkalkning.
4. Indtagelse om aftenen.

**STOFTYPE:** Vitaminer og mineraler.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# NMN

NMN (CELLULOSEKAPSLER, 550 mg)

Pleje mod aldring

Understøtter cellernes reparation

Stimulerer energiproduktionen

Øger stofskiftet

**PROBLEMOMRÅDER:** Aldersrelaterede forandringer, mangel på energi og ydeevne samt langsomt stofskifte.

**INGREDIENSER:** Nikotinamidmononukleotid (NMN), Hydroxypropylmethylcellulose (kapselskal), Mikrokrystallinsk cellulose (bærestof), Quercetin, Resveratrol, Magnesiumstearat (antiklumpningsmiddel), Vitamin B12 (methylcobalamin).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
NMN (nikotinamidmononukleotid) - 250 mg
- Quercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- Vitamin B12 (methylcobalamin) - 8 µg

**INDTAGELSE:** Helst om morgenen på tom mave (det hjælper med at undgå søvnproblemer, da tilskuddet stimulerer centralnervesystemet og energiproduktionen).

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(1 KAPSEL):**
NMN (nikotinamidmononukleotid) - ikke fastlagt.
- Quercetin - 167%
- Resveratrol - 167%

Vitamin B12 (methylcobalamin) - 800%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Indtagelse om aftenen.

**ALDERSANBEFALINGER:** Tilskuddet kan tages fra 18-årsalderen, men bliver særlig vigtigt for kroppen ved 35-40-årsalderen.

**KAPSELTYPE:** HPMC-kapsler.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Kombineres med resveratrol, quercetin, B-vitaminer og coenzym Q10.

**HOLDBARHED:** 3 år.




# OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (SOFTGELS, 700 mg)

Understøtter bevægeapparatets sundhed

Understøtter immunforsvaret

Forbedrer ydeevnen

Understøtter normale kolesterolniveau-er

Understøtter normal hjerte-kar-funktion

**PROBLEMOMRÅDER:** Tør hud og tørre øjne, regelmæssig træthed, nedsat ydeevne, problemer med immunforsvaret, skrøbelige knogler og svaghed.

**INGREDIENSER:** Havfiskeolie, Kapselskal (gelatine, glycerol som fortykningsmiddel, vand), Vitamin D3 (cholecalciferol), Blandede tocopheroler (antioxidant).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
• Flerumættede omega 3-fedtsyrer - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (summen af EPA og DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Vitamin D3 - 0.025 mg

**INDTAGELSE:** I dagens første halvdel, på tom mave eller en halv time efter et måltid, med varmt eller koldt vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1-2 gange dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(1 KAPSEL):**
• Flerumættede omega-3-fedtsyrer - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
Vitamin D3 - 250%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Allergiske reaktioner over for fisk og skaldyr.
2. Børn under 3 år.
3. Individuel intolerance over for stofferne i produktet.

4. Blødning eller forstyrrelse i blodets størkning.
5. Astma.
6. Leversygdom.
7. Forskellige sygdomme i mave-tarm-kanalen i akut eller kronisk fase.
8. Tiden efter en operation.
9. Personer, som er i genoptræning efter en operation eller har skader af forskellig årsag, anbefales at rådføre sig med en læge, før de begynder eller genoptager indtagelsen.
10. Hypervitaminose D.
11. Hyperkalciuri.
12. Urinvejssten.
13. Sarkoidose.
14. Akutte kroniske lever- og nyresygdomme samt nyresvigt.
15. Aktiv lungetuberkulose.

**STOFTYPE:** Flerumættede fedtsyrer + fedtopløseligt vitamin.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Kollagen, calcium, magnesium, fosfor, coenzym Q10, lecithin og vitamin B, C og K2.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Omega-3 reducerer biotilgængeligheden af jern, kobber og zink; indtag med 2-3 timers mellemrum. Vitamin D3 påvirker vitamin A og E negativt.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90 % (SOFTGELS, 700 mg)

Understøtter normale kolesterolniveauer

Forbedrer ydeevnen

Understøtter normal hjerte-kar-funktion

**PROBLEMOMRÅDER:** Tør hud og tørre øjne, regelmæssig træthed, nedsat ydeevne, problemer med immunforsvaret og svaghed.

**INGREDIENSER:** Fiskeolie, Kapselskal (gelatine, glycerol som fortykningsmiddel, vand), Antioxidantblanding af tocopheroler (antioxidant).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
• Flerumættede omega 3-fedtsyrer - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (summen af EPA og DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

**INDTAGELSE:** I dagens første halvdel, på tom mave eller en halv time efter et måltid, med varmt eller koldt vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1-3 gange dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (3 KAPSLER):**
**• Flerumættede omega-3-fedtsyrer - 1350%**
**• EPA - 750%**
**DHA - 300%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Allergiske reaktioner over for fisk og skaldyr.
2. Børn under 3 år.
3. Individuel intolerance over for stofferne i produktet.
4. Blødning eller forstyrrelse i blodets størkning.
5. Astma.
6. Leversygdom.

7. Forskellige sygdomme i mave-tarm-kanalen i akut eller kronisk fase.
8. Tiden efter en operation.
9. Personer, som er i genoptræning efter en operation eller har skader af forskellig årsag, anbefales at rådføre sig med en læge, før de begynder eller genoptager indtagelse af omega-3.

**STOFTYPE: Flerumættede fedtsyrer.**

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Kollagen, calcium, magnesium, coenzym Q10, lecithin og vitamin A, E, B, C og D.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Reducerer biotilgængeligheden af jern, kobber og zink; indtag med 2-3 timers mellemrum.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60 % (SOFTGELS, 300 mg)

Hæmmer stresshormoner

Understøtter normale kolesterolni-veauer

Understøtter normal hjertefunktion

**PROBLEMOMRÅDER:** Tør hud og tørre øjne, regelmæssig træthed og svaghed, nedsat ydeevne og problemer med immunforsvaret.

**INGREDIENSER:** Fiskeolie, Kapselskal (gelatine, glycerol som fortykningsmiddel, vand), Blandede tocopheroler (antioxidant).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
• Flerumættede omega 3-fedtsyrer - 300 mg
Omega 3 - 275 mg (summen af EPA og DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

**INDTAGELSE:** I dagens første halvdel, på tom mave eller en halv time efter et måltid, med varmt eller koldt vand.

**ANBEFALET DOSIS:** 2 kapsler 1-3 gange dagligt.

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (2 KAPSLER):**
**• Flerumættede omega-3-fedtsyrer - 30%**
**• EPA - 55%**
**DHA - 31%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Allergiske reaktioner over for fisk og skaldyr.
2. Børn under 3 år.
3. Individuel intolerance over for stofferne i produktet.
4. Blødning eller forstyrrelse i blodets størkning.
5. Astma.
6. Leversygdom.

7. Forskellige sygdomme i mave-tarm-kanalen i akut eller kronisk fase.
8. Tiden efter en operation.
9. Personer, som er i genoptræning efter en operation eller har skader af forskellig årsag, anbefales at rådføre sig med en læge, før de begynder eller genoptager indtagelse af omega-3.

**STOFTYPE: Flerumættede fedtsyrer.**

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Kollagen, calcium, magnesium, coenzym Q10, lecithin og vitamin A, E, B, C og D.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Reducerer biotilgængeligheden af jern, kobber og zink; indtag med 2-3 timers mellemrum.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# PROBIOTIC COMPLEX

PROBIOTISK KOMPLEKS MED VITAMINER (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 788 mg)

Understøtter stofskifte og energiproduktion

Understøtter immunsystemet

Antioxidantbeskyttelse

Understøtter og genopretter en sund tarmflora

**PROBLEMOMRÅDER:** Fordøjelsesforstyrrelser, svækket immunforsvar, stress og øget belastning samt ubalanceret ernæring.

**INGREDIENSER:** Maltodextrin, Gelatinekapsel (gelatine), L-ascorbinsyre, Zinkbisglycinat, Tørt tocopherylacetat 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Nikotinamid, Stearinsyrens magnesiumsalt (antiklumpningsmiddel), Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, riboflavin.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- Vitamin C - 45 mg
- Zink - 12.3 mg
- Vitamin E - 10 mg
- Vitamin B3 - 18 mg
- Vitamin B5 - 5 mg
- Vitamin B6 - 2 mg
- Vitamin B2 - 1.6 mg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 1 gang dagligt sammen med et måltid.

**ANBEFALET DOSIS:** 1 kapsel 1 gang dagligt.

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(1 KAPSEL):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
- Vitamin C - 75%
- Zink - 82%
- Vitamin E - 100%

Vitamin B3 - 100%
Vitamin B5 - 83%
Vitamin B6 - 100%
Vitamin B2 - 100%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og amning.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# VITAMIN C

VITAMIN C (20 BRUSETABLETTER PR. RØR, 3.8 G)

Understøtter immunforsvaret

Antioxidantvirkning

Understøtter normale oxidationsprocesser

**PROBLEMOMRÅDER:** Nedsat ydeevne, sløvhed, svaghed, døsighed, nedsat modstandskraft mod infektioner og langsom bedring ved forskellige sygdomme.

**INGREDIENSER:** Glukose, Vitamin C (L-ascorbinsyre), Surhedsregulerende midler: Natriumhydrogencarbonat, Vandfri citronsyre, Polyethylenglycol som stabilisator, Naturlig appelsinaroma, Aspartam som sødestof, Naturligt farvestof: Riboflavin. Indeholder sukker og sødestof. Indeholder en phenylalaninkilde.

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 TABLET:**
**Vitamin C - 900 mg**

**INDTAGELSE:** Om morgenen 30 minutter før morgenmaden med vand.

**ANBEFALET DOSIS: 1 tablet 1 gang dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 TABLET):**
**Vitamin C - 1500%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag 3-4 gange årligt med 1-2 måneders mellemrum.

**TABLETTER PR. BEHOLDER: 20 stk.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Nyresten.
3. Hæmokromatose (overskud af jern).
4. Store doser bør ikke ordineres til patienter med øget blodstørkning, tromboflebitis og tendens til blodpropper samt ved diabetes mellitus og tilstande med højt blodsukker.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN: Vitamin A, E, B5 og B9.**

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Vitamin B1 og B12 samt kobber.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# VITAMIN D3

D3-VITAMIN 2000 IE (SOFTGELS, 700 mg)

Understøtter immunforsvaret

Understøtter bevægeapparatets sundhed

**PROBLEMOMRÅDER:** Skrøbelige knogler, osteoporose og svækket immunforsvar.

**INGREDIENSER:** Vegetabilsk olie (oliven), Kapselskal (gelatine, glycerin (fortykningsmiddel), vand), Vitamin D3 (cholecalciferol), Blanding af tocopheroler (antioxidant).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**Vitamin D3 - 50 mcg**

**INDTAGELSE:** Helst om morgenen under et måltid med varmt eller koldt vand.

**ANBEFALET DOSIS: 1 kapsel dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Vitamin D3 - 500%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 2-3 måneder (8-12 uger). Gentag med 6-12 måneders mellemrum.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 90 stk.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Hypervitaminose D.
3. Hyperkalciuri.
4. Urinvejssten.
5. Sarkoidose.
6. Akutte kroniske lever- og nyresygdomme samt nyresvigt.
7. Aktiv lungetuberkulose.

**STOFTYPE:** Fedtopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Calcium (indtages sammen med D3 med et interval på mindst 2 timer), fosfor, magnesium, omega-3 og vitamin K2.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Jern samt vitamin A og E.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# VITAMIN D3 SPRAY

D3-VITAMIN 2000 IE (SPRAY, 30 ml)

Understøtter immunforsvaret

Understøtter bevægeapparatets sundhed

**PROBLEMOMRÅDER:** Skrøbelige knogler, osteoporose og svækket immunforsvar.

**INGREDIENSER:** Raffineret vegetabilsk olie, Naturlig aroma, Cholecalciferol (vitamin D3).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 TRYK:**
**Vitamin D3 - 50 mcg**

**INDTAGELSE:** Ryst flasken før brug. 1 dosis (dosis = 1 tryk på dispenserens hætte) dagligt under et måltid, under tungen. Helst om morgenen.

**ANBEFALET DOSIS: 1 tryk dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 TRYK PÅ DISPENSEREN):**
**Vitamin D3 - 1000%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1-2 måneder (4-8 uger). Indtagelsen kan gentages efter behov.

**VOLUMEN:** 30 ml.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Øget følsomhed over for produktets ingredienser.
2. Hypervitaminose D.
3. Hyperkalciuri.
4. Urinvejssten.
5. Sarkoidose.
6. Akutte kroniske lever- og nyresygdomme samt nyresvigt.
7. Aktiv lungetuberkulose.
8. Individuel intolerance over for ingredienserne.

**STOFTYPE:** Fedtopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Calcium (indtages sammen med D3 med et interval på mindst 2 timer), fosfor, magnesium, omega-3 og vitamin K2.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Jern samt vitamin A og E.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# WOMEN'S FORMULA

KVINDERS MULTIVITAMINKOMPLEKS (CELLULOSEKAPSLER, 580 mg)

Tilfører vitaminer og mineraler

Forbedrer stofskiftet

Understøtter hormonbalancen og kvinders sundhed

Styrker knogler og tænder

Bevarer sund hud, sundt hår og sunde negle

Understøtter nervesystemet og reducerer stress

**PROBLEMOMRÅDER:** Svækket immunforsvar, generel svaghed, øget irritabilitet, nedsat hukommelse og søvnforstyrrelser.

**INGREDIENSER:** Calciumcarbonat, Kapslens sammensætning: Hydroxypropylmethylcellulose (skal), Magnesiumcitrat, L-ascorbinsyre (vitamin C), Kaliumcitrat, Inositol, Citrusbioflavonoider, Cholinbitartrat (cholin), Amerikansk ginsengekstrakt, Marietidselekstrakt, Kvanrodsekstrakt, Melbærekstrakt, Siliciumdioxid (antiklumpningsmiddel), Nikotinamid (niacin), Jernbisglycinat, Zinkcitrat, Magnesiumstearat (antiklumpningsmiddel), DL-alfa-tocopherol (vitamin E), D-calciumpantothenat (pantothensyre), Thiaminhydrochlorid (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Pyridoxinhydrochlorid (vitamin B6), Mangangluconat, Kobbergluconat, Retinol (vitamin A), Chrompicolinat, Calcium-L-methylfolat (folinsyre), Kaliumiodid, L-selenomethionin, D-biotin (biotin), Molybdænglycinat, Menaquinon (vitamin K2), Cholecalciferol (vitamin D3), Methylcobalamin (vitamin B12).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**

- Vitamin A - 0.1 mg
- Vitamin C - 80 mg
- Vitamin D3 - 0.003 mg
- Vitamin E - 3.33 mg

Vitamin B1 - 1.0 mg
Vitamin B2 - 1.0 mg

- Vitamin B3 - 6.5 mg
- Vitamin B6 - 1.0 mg
- Folinsyre - 0.05 mg
- Vitamin B12 - 0.003 mg
- Biotin - 0.015 mg
- Pantothensyre - 2.0 mg
- Cholin - 30.0 mg
- Calcium - 100.0 mg
- Jern - 6.0 mg
- Jod - 0.05 mg
- Magnesium - 100.0 mg

• Zink - 5.0 mg
• Selen - 0.02 mg
• Kobber - 0.5 mg
• Mangan - 0.65 mg
• Chrom - 0.05 mg
• Molybdæn - 0.015 mg
• Inositol - 30.0 mg

**INDTAGELSE:** 1 kapsel 2 gange dagligt i dagens første halvdel.

**ANBEFALET DOSIS: 2 kapsler dagligt.**

PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS **(2 KAPSLER):**
• Vitamin A - 25%
Vitamin C - 267%
Vitamin D3 - 120%
Vitamin E - 67%
Vitamin B1 - 143%
Vitamin B2 - 125%
Vitamin B3 - 72%
Vitamin B6 - 100%
• Folinsyre - 50%
Vitamin B12 - 600%
• Biotin - 60%
• Pantothensyre - 67%
• Cholin - 12%
• Calcium - 20%
• Jern - 86%
• Jod - 67%
• Magnesium - 50%
• Zink - 67%
• Selen - 57%
• Kobber - 100%
• Mangan - 65%
• Chrom - 200%
• Molybdæn - 43%
• Inositol - 12%

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for kosttilskuddets ingredienser.
2. Øget nervøs opstemthed og søvnløshed.
3. Forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser og svær åreforkalkning.
4. Indtagelse om aftenen.
5. Gravide og ammende kvinder bør indtage produktet efter lægens anbefaling og under lægeligt tilsyn.



**STOFTYPE:** Vitaminer og mineraler.

**HOLDBARHED: 3 år.**




# ZINC PICOLINATE

ZINK PICOLINAT (HÅRDE GELATINEKAPSLER, 350 mg)

Regulerer talgproduktionen

Understøtter produktionen af kønshormoner

Styrker hjerte-kar-systemet

Understøtter vævsregenerering

**PROBLEMOMRÅDER:** Svækket immunforsvar, fedtet glans og inflammation i huden samt forringet mandlig sundhed.

**INGREDIENSER:** Mikrokrystallinsk cellulose (E460i, bærestof), Zinkpicolinat, Kapsel (hydroxypropylmethylcellulose (E464, fortykningsmiddel) eller gelatine).

**INDHOLD AF AKTIVT STOF I 1 KAPSEL:**
**Zink - 21.9 mg**

**INDTAGELSE:** 1 kapsel dagligt på tom mave.

**ANBEFALET DOSIS: 1 kapsel dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (1 KAPSEL):**
**Zink - 146%**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Kan gentages efter behov.

**KAPSLER PR. BEHOLDER: 60.**

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Individuel intolerance over for ingredienserne.
2. Graviditet og ammeperiode.
3. Nyresvigt.

**STOFTYPE: Mineral.**

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** B-vitaminer, vitamin C og magnesium.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT:** Høje doser jern og calcium.

**HOLDBARHED: 2 år.**




# COLLAGEN

KOLLAGENGELÉ MED GRANATÆBLESMAG (30 STICKS A 20 G)

Styrker bindevævet

Sund hud, sundt hår og sunde negle

Bremser aldring

Forbedrer hudens spændstighed og fasthed

**PROBLEMOMRÅDER:** Tørhed og fugtmangel i huden, skrøbeligt og tørt hår med tendens til hårtab og spaltning, smerter i muskler og led samt rynker.

**INGREDIENSER:** Granatæblejuicekoncentrat, Water, Fiskekollagen, Fødevaregel (johannesbrødkernemel, xanthangummi, glukose, agar-agar, tamarindgummi), Ascorbic acid, Kunstig granatæblearoma, Hyaluronic Acid.

**INDHOLDET AF DET AKTIVE STOF I 1 STIK:**
- Fiskekollagen - 2000 mg
- Vitamin C - 100 mg
- Hyaluronsyre - 15.2 mg

**INDTAGELSE:** Uafhængigt af måltider og tidspunkt på dagen.

**ANBEFALET DOSIS: 1-2 sticks dagligt.**

**PROCENTDEL AF DET DAGLIGE REFERENCEINDTAG I DEN ANBEFALEDE DAGLIGE DOSIS (2 STICKS):**
**Kollagen - ikke fastlagt**

**ANBEFALET BEHANDLINGSFORLØB:** 1 måned (4 uger). Gentag med 1 måneds mellemrum.

**KONTRAINDIKATIONER:**
1. Allergi eller overfølsomhed over for produktets ingredienser.
2. Graviditet og ammeperiode.

**STOFTYPE:** Vandopløseligt.

**STOFFER, DER SUPPLERER HINANDEN:** Vitamin C, coenzym Q10 og omega-3.

**STOFFER, DER PÅVIRKER HINANDEN NEGATIVT: Ingen anbefalinger.**

**HOLDBARHED: 2 år.**